	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E	CÓDIGO:
	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA INGRESO DE PERSONA JURÍDICA	CJ-C-F-010
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL Y SOPORTE JURÍDICO	VERSIÓN:
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	V01-2025

NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	HEISER SAS
CARGO	C.C 900913246-8
FECHA	CEL.:

FORMATO DE VERIFICACION

No.	DOCUMENTOS SOLICITADOS	VERIFICACIÓN
1	Certificado de existencia y representacion legal	✓
2	Oferta y/o propuesta economica	
3	Cedula de ciudadania del Representante Legal	✓
4	Copia Libreta militar o certificado de definición de situación militar (Aplica para personal masculino menor de 50 años)	NA
5	Certificado de Antecedentes Fiscales Representante Legal - Contraloria	✓
6	Certificado de antecedentes disciplinarios Representante Legal - Procuradura	✓
7	Constancia de consulta de antecedentes penales Representante Legal- Policía Nacional	✓
8	Constancia de consulta de antecedentes del Registro Nacional de Medidas Correctivas Representante Legal	✓
9	Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM	✓
10	Certificado de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de 18 años	✓
11	Certificado de antecedentes disciplinarios Empresa - Procuradura	✓
12	Certificado de Antecedentes Fiscales Empresa - Contraloria	✓
13	Formato Declaración de bienes y rentas (SIGEP)- Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades (Contratistas-Funcionarios)	✓
14	Certificados de experiencia	✓
15	Certificado de la cuenta bancaria	✓
16	Planilla y/o certificado de Seguridad Social	✓
17	Registro Único Tributario RUT	✓
18	Formato SARLAFT (FIRMA Y HUELLA)	✓
19	Pantallazo de Registro en el SECOP II como Proveedores	✓
20	Hoja de Vida de los Especialistas	NA
21	Hoja de Vida de los Equipos	NA

Verificó Contratación

Nombre: Cindy Cárdenas
Cargo: Apoyo Contratación
Fecha: 09/02/2026.
Firma: Cindy Cárdenas

Cámara de Comercio de Tunja

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 22/06/2026 - 09:27:36
Recibo No. S001154470, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 71PSZzmEwb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES S.A.S.
Sigla : HEISER S.A.S.
Nit : 900913246-8
Domicilio: Tunja, Boyacá

MATRÍCULA

Matrícula No: 138195
Fecha de matrícula: 27 de noviembre de 2015
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 06 de abril de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : AV UNIVERSITARIA 75 A 00 B L O Q U E L L O C A L 3 B
Barrio : V. PIRGUA
Municipio : Tunja, Boyacá
Correo electrónico : heisermedical@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3107353148
Teléfono comercial 2 : 3176572582
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : AV UNIVERSITARIA 75 A 00 B L O Q U E L L O C A L 3 B
Barrio : V. PIRGUA
Municipio : Tunja, Boyacá
Correo electrónico de notificación : heisermedical@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 12 de noviembre de 2015 de la Asamblea Constitutiva de Tunja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 2015, con el No. 25784 del

Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES S.A.S., Sigla HEISER S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Ley 1727 inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2023, con el No. 40162 del Libro IX, se decretó la disolución por depuración de acuerdo con lo indicado en la Ley 1727 de 2014.

Por Acta No. 1 del 31 de julio de 2023 de la Asamblea General De Accionistas de Tunja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de agosto de 2023, con el No. 40978 del Libro IX, se decretó REACTIVACION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL S.A.S. DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY 1429 DE 2010.

Por Acta No. 2 del 15 de agosto de 2023 de la Asamblea General De Accionistas de Tunja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de agosto de 2023, con el No. 41104 del Libro IX, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, ARTICULO 6. OBJETO SOCIAL ARTICULO 7.CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO ARTICULO 8 CLASES Y SERIES DE ACCIONES ARTICULO 11. EMISION DE ACCIONES ARTICULO 15. RESERVAS ARTICULO 16. UTILIDADES Y SE ADICIONAN, ARTICULO 21. QUORUM DECISORIO; ARTICULO 22. ENAJENACION GLOBAL DE ACTIVOS; ARTICULO 23. ENAJENACION Y VENTAS DE ACCIONES.

Por Acta No. 2 del 23 de agosto de 2023 de la Contador Publico de Tunja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de agosto de 2023, con el No. 41105 del Libro IX, se decretó CERTIFICACIÓN AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

Por Ley 1727 , inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2023, con el No. 40162 del Libro IX, se decretó la disolución por depuración de acuerdo con lo indicado en la Ley 1727 de 2014, y Por Acta No. 1 del 31 de julio de 2023 de la Asamblea General De Accionistas de Tunja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de agosto de 2023, con el No. 40978 del Libro IX, se decretó REACTIVACION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL S.A.S. DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY 1429 DE 2010.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal: Importación, exportación, fabricación, comercialización, distribución y venta de equipos médicos, reactivos y elementos diagnósticos, insumos y materiales médicos quirúrgicos así como material de osteosíntesis y equipos biomédicos, en general toda clase de productos, bienes y servicios necesarios para el desarrollo del objeto de la sociedad Podrá ser

representante de firmas Nacionales o Extranjeras, formar consorcios con estas, hacer parte de Asociaciones, Fundaciones u organismos Nacionales o Internacionales, relacionados con el objeto social, podrá adquirir a cualquier título en el país o en el exterior, los bienes de capital o de consumo que sean requeridos para el desenvolvimiento de su objeto social. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 2.000.000.000,00
No. Acciones	100.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 20.000,00

	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	50.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 20.000,00

	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 660.000.000,00
No. Acciones	33.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 20.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. Gerencia: La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente, quien tendrá suplente. El suplente del gerente lo reemplazara en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendrá las mismas atribuciones que el gerente cuando entre a reemplazarlo. Facultades del gerente: El gerente esta facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) certificar conjuntamente con el contador de la compañía los

estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijara las remuneraciones correspondientes, dentro de los limites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 005 del 22 de enero de 2024 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 25 de enero de 2024 con el No. 41847 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	CLAUDIA SIERRA PINILLA	C.C. No. 40.041.569

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 01 de 2025 del 14 de enero de 2025 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2025 con el No. 44917 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	NELSON ALBERTO NEIRA CAMARGO	C.C. No. 1.049.604.109	169283-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Ley 1727 del 21 de abril de 2023 de la Camara De Comercio	40162 del 21 de abril de 2023 del libro IX
*) Acta No. 1 del 31 de julio de 2023 de la Asamblea General De Accionistas	40978 del 04 de agosto de 2023 del libro IX
*) Acta No. 2 del 15 de agosto de 2023 de la Asamblea General De Accionistas	41104 del 30 de agosto de 2023 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por documento privado del 07 de marzo de 2024 de la Controlante-representante Legal , inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2025, con el No. 44972 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Situacion de control subordinada sobre la sociedad,siendo controlada por, Ana Maria Santoyo Gutierrez, identificada con c.c. 1049621242, por tener el 100% de las acciones que conforman el capital de la sociedad.
** **EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : ANA MARIA SANTOYO GUTIERREZ
SOCIO ACCIONISTA
Identificación: 1049621242
Nacionalidad: COLOMBIANO/A
Domicilio: 15001 - Tunja
Dirección : Calle 22 12 37
País: Colombia
CIIU : G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
CIIU : G4645 - Comercio al por mayor de productos farmaceuticos, medicinales, cosmeticos y de tocador
CIIU : Q8621 - Actividades de la practica medica, sin internacion
Fecha de configuración de la situación: 07/03/2024
Presupuesto que da lugar a la situación de control y/o al grupo empresarial: "Artículo 2.2.2.41.6.1 Decreto 1074 de 2015 adicionado por el artículo 1 Decreto 667 de 2018" Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio. Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

** **EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES S.A.S.
Domicilio: Tunja, Boyacá
País: Colombia

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4659
Actividad secundaria Código CIIU: G4645
Otras actividades Código CIIU: Q8621

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES S.A.S
Matrícula No.: 236491
Fecha de Matrícula: 22 de septiembre de 2025
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CARRERA 1A 45A 27
Barrio : LAS QUINTAS
Municipio: Tunja, Boyacá

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $9.425.903.230,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4659.

Cámara de Comercio de Tunja

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 22/06/2026 - 09:27:36
Recibo No. S001154470, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 71PSZzmEwb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

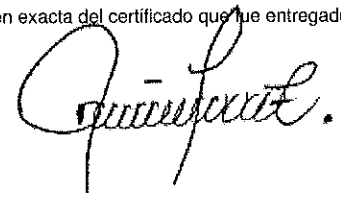

Yeny Alejandra Lòpez Rivera

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES S.A.S
NIT: 900.913.246-8

15 de Julio del 2026

Señores:
Ana Maritza Dávila Barón
Gerente Angela Reyes
Coordinadora laboratorio clínico Hospital
Regional de Moniquirá


Estimados Señores,

Reciban un cordial saludo del equipo HEISER S.A.S a continuación, juntos con nuestros aliados comerciales ponemos en su conocimiento la propuesta técnica y económica de tecnología en el área de quimica clínica, inmunología, hematología, coagulación, electrolitos, microbiología y gases arteriales para el laboratorio clínico de su institución:
Para seguir construyendo un laboratorio de calidad necesario contar con tecnología de punta y un portafolio diversificado que lleven a un constante crecimiento y permitan la:

- Optimización del espacio y recursos como el talento humano de su laboratorio.
- Productividad ininterrumpida.
- Mejoramiento de la eficiencia.
- Consolidación
- Flujos de trabajo limpios.
- Menos desperdicios y gastos administrativos.

1.Propuestas técnica inmunoquímica clínica

Vitros 5600
1 unidad

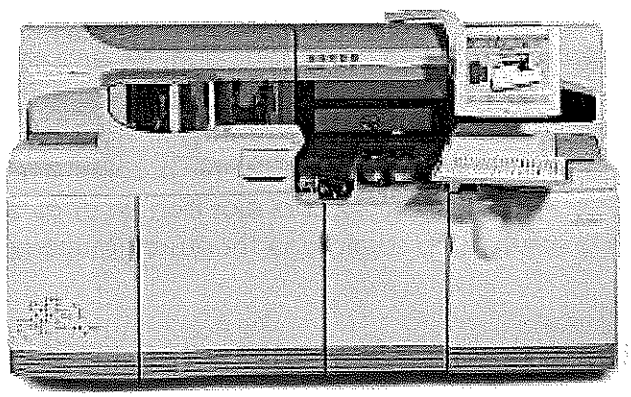


Dirección: AV UNIVERSITARIA #75 A- 00 BLOQUE C L3 CENTRO EMPRESARIAL GREEN HILLS
Tunja Boyacá Teléfono celular: 3107353148
Correo electrónico: contabilidad@heiser.com.co

El Sistema VITROS® 5600 combina menús completos de química clínica e inmunoensayo de más de 160 ensayos, todo en una sola plataforma integrada, lo que proporciona alta calidad, productividad y valor a su laboratorio. y está diseñado para ayudarlo a consolidar de manera eficiente las pruebas críticas para brindar resultados precisos y oportunos a los médicos y pacientes que dependen de usted. También puede confiar en que el Sistema VITROS esté en funcionamiento cuando lo necesite, con su tiempo de actividad del analizador líder en la industria del 98 %.*

Valor aportado a su eficiencia operativa:

- Cargue y retire muestras desde un único punto de entrada/salida
- Evite las interrupciones con la carga automática y equilibrio del menú
- Libere al personal para que se concentre en la entrega de resultados precisos con clasificación y destapado automatizados
- Acceda fácilmente a las muestras desde las gradillas donde se preparan y almacenan
- Minimice el tiempo del técnico con enrutamiento y recuperación automáticos de muestras

Vitros 250
1 unidad (Backup química clínica)

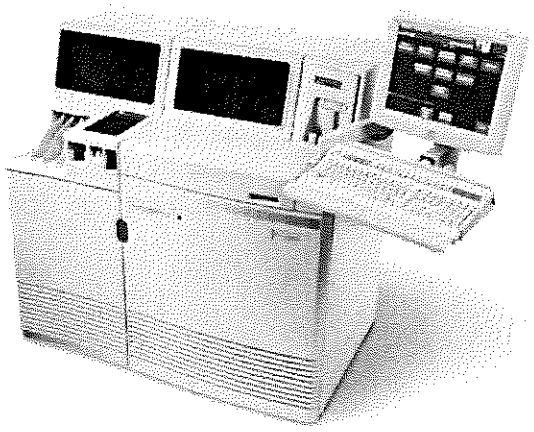

El sistema VITROS® 250, es un sistema automatizado de piso compacto, diseñado para ofrecer eficacia, fiabilidad y, sobre todo, sencillez de uso como sistema primario, de urgencias o de respaldo. **Optimización del trabajo** La eliminación de la preparación de reactivos y las calibraciones semestrales ofrecidas por la Tecnología MICROSLIDE significan que el personal de laboratorio puede ser reasignado a tareas más importantes. Entre sus características estan:

- Mínimo tiempo de mantenimiento del instrumento.
- Capacidad de interfasar bidireccionalmente.
- No requiere agua desionizada, cañerías ni desagües
- Operación de acceso continuo y aleatorio de muestras.
- Calibraciones semestrales o cada cambio de lote.
- Los slides estan empacados en cartuchos, mismos que son identificados con código de barras sin importar el numero de lote permitiendo su carga en el equipo en un solo paso.
- Los cartuchos conteniendo slides, de cualquier lote, al ser identificados con códigos de barras pueden ser cargados en el instrumento en un sencillo paso.
- El equipo realiza la dilución automática de las orinas y de los sueros lo cual se traduce a menor cantidad de tiempo en el proceso.
- Una nueva pantalla plana, anti-reflejo y sensible al tacto con un diseño ergonómico.

Menú de pruebas Vitros 250:

MicroSlide™ (Química Seca)

QUIMICA
Ácido Úrico (S/U)
ALC
Albúmina
ALT
Amilasa
Amonio
AST
Bilirrubina Total
Buba
BUN (S/U)
Calcio (S/U)
CK-MB
Cloro
Colinesterasa
Colesterol
CRP
dHDL
ECO2
Fosfatasa Ácida
Fosfatasa Alcalina
Fósforo
GGT
Glucosa

TDM
Acetaminofén
Carbamazepina
Digoxina
Fenobarbital
Fenitoina
Litio
Salicilato
Teofilina

S: Suero U: Orina LCR: Líquido Cefalorraquídeo

Hierro
Lactato
LDH
Lipasa
Magnesio (S/U)
Potasio(S/U)
Proteína (LCR)
Proteína Total
Sodio (S/U)
Triglicéridos
UPRO

Oferta de Entrenamiento

Los entrenamientos se coordinarán de mutuo acuerdo entre las dos partes se sugiere realizar bajo el siguiente esquema tanto en tiempo como en el personal:

Fase 1:

- Se designará dentro de las profesionales del laboratorio aquellas que requieran tener conocimiento completo de los equipos ya que lo manejarán de rutina, el entrenamiento será de 4 días – durante 7 horas y en un grupo conformado por máximo 4 participantes por entrenamiento, tiempo en el cual obtendrán conocimiento de toda la plataforma: características, ventajas, beneficios, infraestructura, programación, mantenimientos diario mensual y de acuerdo con necesidad, piezas entre otros temas.
- Para personal eventual de turnos, que su conocimiento no requiera el detalle por su rotación, esta capacitación es de 7 horas durante 3 días, en grupos con un máximo de 3 participantes.

Fase 2:

Posterior al entrenamiento inicial, se coordinará una segunda visita para reforzar temas fundamentales de desempeño de los equipos lo mismo que para profundizar áreas como la de Control de Calidad teniendo en cuenta que ya se ha tenido desempeño del sistema en la institución y bajo las condiciones propias del personal lo cual permitirá la finalización del periodo de puesta en marcha de los sistemas.

Estos tiempos pueden estar sujetos a cambios según la institución y al personal a entrenar.

Acompañamientos y servicio de soporte

Dentro de los acompañamientos y servicios de soporte ofrecido por el grupo de especialistas se encuentran:

- Capacitación y entrenamiento en las plataformas y uso de los productos
- Asesoría en control de calidad Interno y externo
- Acompañamiento con el área de Ingeniería en la resolución de situaciones que así lo requieran
- Tramite de garantías por pérdida de producto y reposiciones por daño de máquina y/o fallas en el desempeño de los reactivos.
- Coordinación de planes de contingencia para remisión de muestras a otras plataformas VITROS.

2. Propuesta comercial

- 1 equipo Vitros 5600 integrado usado (química e inmunología) que disminuye costos en tubos pues solo se necesita 1 tubo para química e inmunología, simplifica y consolida el proceso.
- 1 equipo Vitros 250 para química clínica como backup
- Equipos de computo
- Integración al LIS

2.1 Lista de precios química clínica e inmunología:

REFERECIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACION	PRECIO PRUEBA SIN IVA	PRECIO KIT SIN IVA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON INVA
8004707	COLINESTERASA	90	$1.396	$125.602	$ -	$125.602
6801728	LDL DIRECTO	600	$6.691	$ 4.014.644	$ -	$ 4.014.644
1726926	AMONIACO	90	$5.926	$ 533.374	$ -	$ 533.374
6844425	INSULINA	100	$20.718	$ 2.071.754	$ -	$ 2.071.754
1435205	TESTOSTERONA	100	$15.867	$ 1.586.740	$ -	$ 1.586.740
8552630	ESTRADIOL	100	$15.557	$1.555.741	$ -	$1.555.741
6800040	CA19-9	100	$26.114	$2.611.431	$ -	$2.611.431
1074053	CORTISOL	100	$14.529	$1.452.919	$ -	$1.452.919
6800120	PROTEINAS TOTALES EN ORINA	90	$2.485	$223.672	$ -	$223.672
1926740	PCR CUANTITATIVA	250	$7.265	$ 1.816.190	$ -	$ 1.816.190
6801735	COMPLEMENTO C3	300	$8.603	$ 2.580.843	$ -	$ 2.580.843
6801736	COMPLEMENT C4	300	$8.603	$ 2.580.843	$ -	$ 2.580.842
6802001	TIBC	300	$11.151	$ 3.345.346	$ -	$ 3.345.346
6801740	MICROALBUMINA	300	$6.118	$ 1.835.266	$ -	$ 1.835.266
6801767	TRANSFERRINA	300	$6.691	$ 2.007.322	$ -	$ 2.007.322
1924547	HIERRO	90	$1.735	$156.135	$ -	$156.135
6842844	PSA TOTAL	100	$19.932	$ 1.993.168	$ -	$ 1.993.168
1318450	Anti-HCV	100	$ 29.400	$ 2.940.000	$-	$2.940.000
6800039	CA15-3	100	$31.500	$3.150.000	$ -	$3.150.000


8478034	CREATIN QUINASA	90	$2.122	$190.982	$ -	$190.982
1931922	FSH	100	$16.823	$ 1.682.326	$ -	$ 1.682.326
1315589	FT3	100	$12.426	$ 1.242.627	$ -	$ 1.242.627
8669335	TOXOPLASMA GONDII IgM	100	$22.520	$ 2.252.023	$ -	$ 2.252.023
8091399	TOXOPLASMA GONDII IgG	100	$21.985	$ 2.198.494	$ -	$ 2.198.494
1921204	MAGNESIO	90	$1.644	$147.967	$ -	$147.967
1513209	FOSFORO	300	$2.015	$604.365	$ -	$604.365
1849793	PROLACTINA	100	$13.000	$ 1.300.000	$ -	$ 1.300.000
1350198	LH	100	$12.426	$ 1.242.627	$ -	$ 1.242.627
1925551	AFP	100	$16.249	$ 1.624.974	$ -	$ 1.624.974
6844436	HS-TROPONINA I	100	$24.853	$ 2.485.255	$ -	$ 2.485.255
6844466	TSH	100	$12.426	$ 1.242.627	$ -	$ 1.242.627
1387000	FT4	100	$12.426	$ 1.242.627	$ -	$ 1.242.627
6808888	T3 TOTAL	100	$12.426	$ 1.242.627	$ -	$ 1.242.627
6802220	HCG	100	$12.426	$ 1.242.627	$ -	$ 1.242.627
8356636	FERRITINA	100	$12.426	$ 1.242.627	$ -	$ 1.242.627
8744468	T4 TOTAL	100	$12.426	$ 1.242.627	$ -	$ 1.242.627
1920115	CEA	100	$16.250	$ 1.624.974	$ -	$ 1.624.974
8392292	PROTEINAS TOTALES	250	$1.529	$ 382.347	$ -	$382.347
6844452	NT-proBNP II	100	$31.862	$ 3.186.225	$ -	$ 3.186.225
1336544	TRIGLICERIDOS	300	$1.529	$458.816	$ -	$458.816
6844430	LDH	250	$1.529	$382.347	$ -	$382.347
8433815	GOT/AST	300	$1.524	$457.093	$ -	$457.093
6844288	GPT/ALT	250	$1.523	$380.911	$ -	$380.911
1484427	Rubeola Virus IgM	100	$17.576	$ 1.757.650	$ -	$ 1.757.650
8536195	Rubeola Virus IgG	100	$17.576	$ 1.757.650	$ -	$ 1.757.650
6800038	CA125	100	$23.954	$ 2.395.403	$ -	$ 2.395.403
1988211	ALBUMINA	90	$1.524	$137.159	$ -	$137.159

8001133	CK-MB	90	$3.823	$344.112	$ -	$344.112
6801830	CITOMEGALOVIRUS IgM	100	$17.577	$ 1.757.652	$ -	$ 1.757.652
6905558	Procalcitonina	100	$72.796	$7.279.637	$ -	$7.279.637
1053180	ALP	300	$1.608	$482.488	$ -	$482.488
8159931	BILIRRUBINA TOTAL	300	$1.478	$443,394	$ -	$443,394
8383051	BUBC	300	$1.478	$443,394	$ -	$443,394
8102204	BUN	300	$1.478	$443,394	$ -	$443,394
6801827	CITOMEGALOVIRUS IgG	100	$17.081	$1.708.138	$ -	$1.708.138
6842779	VIH COMBO	100	$20.073	$ 2.007.321	$ -	$ 2.007.321
1513266	FOLATO	100	$21.348	$ 2.134.824	$ -	$ 2.134.824
6802584	CREATININA	300	$1.478	$443,394	$ -	$443,394
8435307	HBsAg	100	$13.378	$ 1.337.771	$ -	$ 1.337.771
1669829	COLESTEROL TOTAL	300	$1.477	$443,394	$ -	$443,394
6801895	COLESTEROL HDL	300	$2.464	$739.311	$ -	$739.311
1943927	ACIDO URICO	300	$1.243	$372.788	$ -	$372.788
1707801	GLUCOSA	300	$1.478	$443,394	$ -	$443,394
1453489	VITAMINA B12	100	$21.348	$2.134.824	$ -	$2.134.824
6900052	PTH	100	$34.485	$ 3.448.513	$ -	$ 3.448.513
8112724	AMILASA	90	$4.105	$369.462	$ -	$369.462
6842894	VITAMINA D 25-OH	100	$32.567	$3.256.697	$ -	$3.256.697
1450261	CALCIO	300	$3.468	$1.040.369	$ -	$1.040.369
8297749	LIPASA	90	$11.830	$1.064.724	$ -	$1.064.724
6844480	aTCRU	100	$16.800	$1.680.000	$ -	$1.680.000
1787753	Anti-HBS	100	$25.451	$2.545.100	$ -	$2.545.100
8577412	ANTI HBC TOTAL	100	$25.451	$2.545.100	$ -	$2.545.100
8257289	GGT	250	$2.079	$519.700	$ -	$519.700
21015025	ETIQUETA TERMICA	Unidad	-	$86.670	19%	$103.137

6842803	Syphilis TPA	100	$19.950	$1.995.000	$-	$1.995.000
6801741	PREALBUMINA	300	$13.759	$4.127.700	$-	$4.127.700
8208431	PROTEINAS LCR	90	$3.570	$321.300	$-	$321.300
8157596	Potasio	250	$4.200	$1.050.000	$-	$1.050.000
8379034	Sodio	250	$3.193	$798.250	$-	$798.250
6844471	Cloruro	250	$2.386	$596.525	$-	$596.525

3. Propuestas técnica Hematología

DYMIND DH800
1 unidad

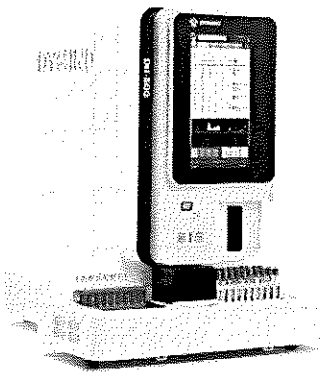

El modelo DH-800 se destaca por su tecnología de inteligencia artificial (AI), permitiendo un diagnóstico automatizado, preciso y eficiente en pruebas de WBC, RBC, PLT, NRBC, RET y fluidos corporales, convirtiéndolo en una solución integral para instituciones que buscan elevar la calidad de sus procesos en el área de hematología.

3.1 Principales ventajas y funciones destacadas:
Avanzada tecnología AI para WBC

- Mejora la precisión en el marcado de blastocitos e IG (granulocitos inmaduros).
- Optimiza el análisis y clasificación diferencial de leucocitos, incluso en muestras complejas

Solución optimizada para RBC

- Inteligente marcación de agregación de eritrocitos.
- Corrección automática de resultados mediante tecnología de baño térmico, reduciendo interferencias por agregación de RBC.

Innovación en análisis de PLT

- El nuevo método de impedancia con flujo de vaina reduce interferencias por microcitos y plaquetas grandes.
- Tecnología exclusiva para desaglomeración de plaquetas, minimizando los errores por agregación.
- Canal especializado PLT-F que elimina interferencias de restos celulares.

La propuesta incluye:

- Mantenimiento preventivo y correctivo
- 1 Kit controles de calidad mensual.
- PC, UPS e Instalación
- Entrenamiento
- Equipos nuevos

3.3. Propuestas económica Hematología DH800

Referencia	Prueba	Presentación	Valor kit
12.01.1907A	D-80 DIL	20L	$253.380
12.01.1936A	D-80LH	1L	$593.280
12.01.1916A	D-80LD	4L	$2.057.940
12.01.1922A	D-80FD	42mL	$1.050.340
12.01.1914A	D-80LN	4L	$1.342.000
12.01.1920A	D-80FN	22mL	$156.620
12.01.1909A	D-80DR	500mL	$170.980
12.01.1989A	D-80FR	12mL	$1.083.560

Precio cuadro hematico: 3.115

3.2 Garantía y soporte

• Todos los equipos y reactivos cumplen con los requerimientos nacionales de registros Sanitarios otorgados por el INVIMA.

• La garantía es de 2 años a partir de la fecha de facturación. No cubre daños producidos por mal manejo del analizador, no ejecución de mantenimiento por parte del usuario, intervención del analizador por personal no autorizado por Biometrika Laboratorio SAS o condiciones de preinstalación erróneas.

• **Capacitación e Instalación:** La capacitación e instalación se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido previamente por Biometrika Laboratorio S.A.S.

• **Servicio postventa y garantía**: Contamos con una línea de soporte técnico científico disponible. La disponibilidad 24/7 aplica sólo para urgencias vitales en clínicas y hospitales que trabajan 24 horas. Línea de Ateción: HELP DESK +57 317 4321900.

Bonificado			
DDC5DPT3H	D-Check 5 DIFF Plus H	3ml	1 MENSUAL
DDC5DPT3L	D-Check 5 DIFF Plus L	3ml	1 MENSUAL
DDC5DPT3N	D-Check 5 DIFF Plus N	3ml	1 MENSUAL
12.01.0046A	CLE-P Cleanser	50 mL	0,5 MENSUAL
DM-RET	DM-RET-LOW	3mLx1	1 MENSUAL
	DM-RET-Middle	3mLx1	1 MENSUAL1
	DM-RET-High	3mLx1	1 MENSUAL

3.2 Garantía y soporte

• Todos los equipos y reactivos cumplen con los requerimientos nacionales de registros Sanitarios otorgados por el INVIMA.


• La garantía es de 2 años a partir de la fecha de facturación. No cubre daños producidos por mal manejo del analizador, no ejecución de mantenimiento por parte del usuario, intervención del analizador por personal no autorizado por Biometrika Laboratorio SAS o condiciones de preinstalación erróneas.

• **Capacitación e Instalación:** La capacitación e instalación se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido previamente por Biometrika Laboratorio S.A.S.

• **Servicio postventa y garantía**: Contamos con una línea de soporte técnico científico disponible. La disponibilidad 24/7 aplica sólo para urgencias vitales en clínicas y hospitales que trabajan 24 horas. Línea de Ateción: HELP DESK +57 317 4321900.

4. Propuestas técnica Coagulación

DYMIND CA1200
1 unidad

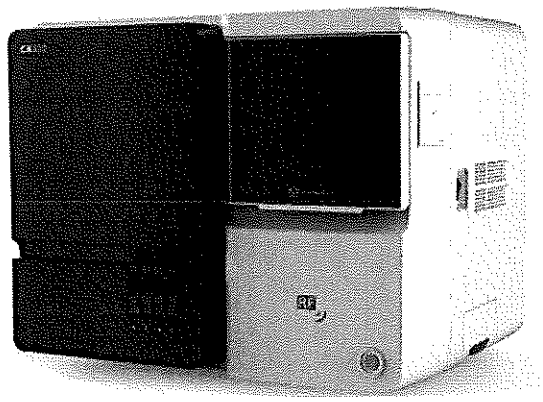


El CA1200 es un analizador automático compacto y robusto, ideal para laboratorios que desean automatizar sus pruebas de hemostasia manteniendo alta precisión, velocidad y eficiencia operativa.

- 4 canales de medición ópticos.
- Capacidad para hasta 30 muestras y 20 reactivos refrigerados.
- Procesamiento de hasta 120 pruebas por hora.
- Tecnología de detección foto-óptica turbidimétrica y cromogénica.
- Interfaz táctil e intuitiva con conectividad LIS/HIS.
- Detección automática de burbujas y control térmico a 37 ± 0.2 °C.
- Carga máxima de muestras: 40 tubos de muestras
- Reactivo a bordo: 23 posiciones de reactivo
- STAT: Apoyar a STAT en cualquier posición de las muestras
- Carga de reacción: 80 tubos de reacción a bordo; acceso continuo automático
- Lavado y limpieza: solución de lavado a bordo
- Estación de trabajo: PC Incorporado
- Pantalla: Pantalla táctil TFT de 10.4 pulgadas La pantalla táctil ajustable y la iluminación interior hacen que su operación sea la más cómoda posible.
- Almacenamiento: Hasta 100.000 registros
- Rendimiento: PT+APTT ≥ 100 Pruebas por hora

4.1 Servicios incluidos sin costo adicional

- Capacitación continua del personal.
- 100% de mantenimientos preventivos.
- Mano de obra de Mantenimientos correctivos y visitas técnicas.
- Soporte técnico remoto 24/7.
- Equipos nuevos
- Equipo back up COAG2D DIAGON Semiautomatizado.

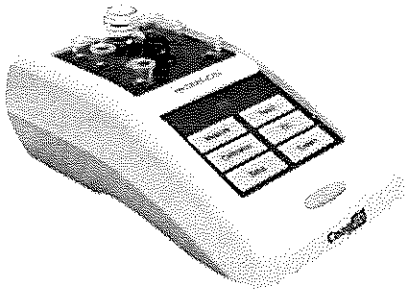

4.2 Beneficios para la institución

- Ahorro de inversión inicial (equipo sin costo de compra).
- Continuidad operativa garantizada (equipo sustituto + soporte inmediato).
- Reactivos de alta calidad con respaldo científico.
- Trazabilidad en resultados, asegurando cumplimiento normativo (CLSI, ISO, INVIMA).
- Alianza estratégica a largo plazo con condiciones flexibles y renovables.

4.3 Garantía y soporte

• Todos nuestros equipos y reactivos cumplen con los requerimientos nacionales de registros Sanitarios otorgados por el INVIMA.
• El analizador BCA1000 contara bajo la modalidad de apoyo tecnológico incluye todos los mantenimientos preventivos y la mano de obra de los mantenimientos correctivos necesarios para garantizar la operación del analizador (sin repuestos).
• **Capacitación e Instalación:** La capacitación e instalación se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido previamente por Biometrika Laboratorio S.A.S.
• **Servicio postventa y garantía:** Contamos con una línea de soporte técnico científico disponible. La disponibilidad 24/7 aplica sólo para urgencias vitales en clínicas y hospitales que trabajan 24 horas. Línea de Atención: HELP DESK +57 317 4321900


4.4. Propuestas económica Coagulación

REFERECIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACION	PRECIO KIT SIN IVA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON INVA
DYM—COA-PT-01	PROTHROMBIN TIME ASSAY	10 fsc x 2 mL	$1.300.840	$ -	$1.300.840
DYM—COA-PTT-01	ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME ASSAY KIT APTT REAGENT	10 fsc x 2 mL	$ 2.746.217	$ -	$ 2.746.217

Bonificado		
DYM—COA-SL-01	CLG-1 (10L)	2 MENSUAL
DYM—COA-SL-02	CLG-2 (30mL)	5 MENSUAL
DYM—COA-CU-01	Optic Cuvvettes	1,7 MENSUAL
DYM—COA-MBC-01	Magnetic Bead Cuvettes (100 pcs)	0,5 MENSUAL
DYM—COA-CTRL-01	CONTROL COAG LEVEL 1	1 Mensual
DYM—COA-CTRL-01	CONTROL COAG LEVEL 2	1 Mensual
DYM—COA-CAL-FIB-01	CAL FIB	1 Mensual
DYM—COA- FIB-01	FIBRINOGENO ASSAY KIT	Depende del uso

5. Propuestas técnica gases arteriales

PT-1000
2 Unidades

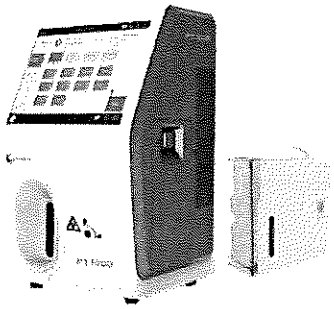

5.1 Características Destacadas del Producto
Cartucho Todo en Uno

- No requiere fluidos en el instrumento, libre de mantenimiento.
- Pack de calibración, solución de limpieza y recolección de residuos biológicos integrado.
- Diseño optimizado del cartucho que minimiza la formación de coágulos.

Alta Eficiencia
- Tecnología revolucionaria de microsensores, 33 parámetros en solo 60 segundos.
- Calibración automática y monitoreo continuo del rendimiento del sistema.
- Impresora incorporada, impresión automática de resultados después de la detección.

Fácil Operación
- Pantalla táctil con indicaciones intuitivas.
- Proceso simple de 4 pasos, fácil de usar.
- Compatible con el protocolo HL7 para integración con LIS/HIS.

Máxima Flexibilidad
- Tamaño compacto adecuado para diversas unidades (UCI, urgencias, quirófano, etc.).
- Asa conveniente para facilitar el transporte.
- Batería incorporada con autonomía de respaldo de 4 horas.

Rendimiento y tipos de muestras
- Tecnología de microsensores, 60 pruebas hora.
- Sangre arterial
- Sangre venosa
- Sangre capilar
- Volumen de muestra: 150 uL

Parámetros:

- Medidos: PH, PCO2, PO2, Na+, K+, Ca++, CL, Glu, Lac, Hct.
- Calculados: cH+, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), HCO3- act, HCO3-std, BB(B), BE(B), BE(ecf), CtCO2, Ca++(7.4), sO2(est), AnGap, tHb(est), pO2(A-a), pO2(A-a) (T), pO2(a/A), pO2(a/A) (T), RI, RI(T), pO2/FIO2, pO2(T)/FIO2.

Otras especificaciones tecnicas:

- Libre de mantenimiento.
- Calibración autónoma.
- Solución de limpieza y compartimento de residuos interno.
- El diseño optimizado del cartucho minimiza la formación de coágulos.
- Tiempo a bordo: Pack de 120 y 200 test 21 días.
- Pack de 300 test 14 días.
- Controles con código QR.
- No necesita filtro
- Temperatura: 10°C -31°C
- Equipos nuevos

5.2 Servicios incluidos sin costo adicional


- Capacitación continua del personal.
- 1 control de calidad interno mensual.
- Mano de obra de Mantenimientos correctivos y visitas técnicas.
- Soporte técnico remoto 24/7.
- UPS

5.1 Lista de reactivos

REFERENCIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACIÓN	PRECIO PRUEBA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON IVA
PT-10-600	REAGENT PACK	600 TEST/KIT	$11.340	$ -	$6.804.189
W-PT10-300	REAGENT PACK	300 TEST/KIT	$11.340	$ -	$3.402.000
BONIFICADOS					
PT-1000 CON	CONTROL DE CALIDAD INTERNO NIVEL 1-2-3	30 UND X 2.5 ML	1 Mensual		
IN 0090	ROLLO TERMICO	Unidad	Dependiendo el uso y la conexión al LIS		

6. Propuestas técnica electrolitos

DIESTRO 103 AP v4
1 Unidades

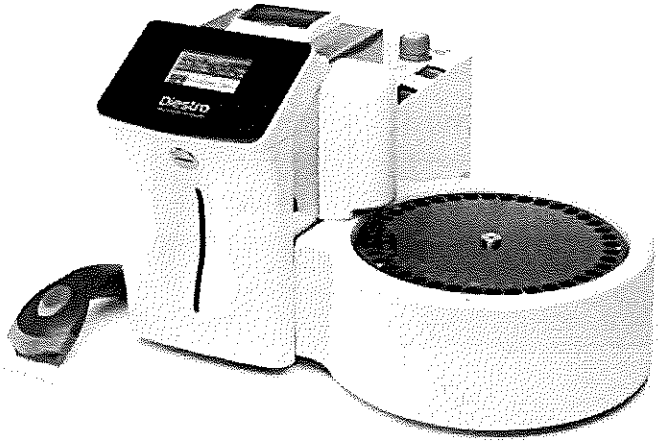

Los analizadores de electrolitos DIESTRO 103 AP v4 representan una solución compacta, robusta y altamente eficiente, diseñada para laboratorios clínicos y hospitales que requieren precisión, velocidad y versatilidad en el análisis de electrolitos. Su diseño modular permite seleccionar el modelo más adecuado en función del volumen de muestras procesadas diariamente, desde entornos con baja carga de trabajo hasta laboratorios de alta productividad.

La propuesta garantiza:

- Precisión clínica con electrodos ISE digitales.
- Escalabilidad desde configuraciones semiautomáticas hasta totalmente automáticas.
- Eficiencia operativa con tiempos de análisis menores de 60 segundos, incluyendo calibración y reporte.
- Optimización de recursos con consumibles de calibración y lavado automáticos.
- Conectividad y trazabilidad gracias a opciones de LIS, USB, código de barras y memoria interna.

6.1 Características destacadas

- Carga de muestra: Automática con detección de nivel.
- Volumen mínimo de muestra: Desde 40 µL.
- Tipos de muestra admitidos: sangre entera, suero, plasma, orina.
- Compatibilidad: jeringa, tubo o capilar con posicionamiento inteligente.
- Velocidad: <60 segundos por muestra (incluye medición, lavado, calibración e impresión).
- Rendimiento: hasta 60 muestras de suero por hora.

- Electrodos: ISE digitales, libres de mantenimiento, expandibles hasta 5 electrolitos (Na+, K+, Cl–, Ca++, Li+).
- Pantalla: gráfica táctil de alta resolución, con guía rápida en pantalla.
- Calibración y lavado: automáticos bajo demanda.
- Memoria: hasta 1000 resultados almacenados.
- Control de calidad: 3 niveles con reportes estadísticos integrados
- Multilenguaje: adaptable a entornos internacionales.

6.2 Especificaciones técnicas:
Reproducibilidad:

- Suero: SD ≤ 0,05 (20 corridas)
- Orina: SD ≤ 0,06 (20 corridas)
- Resolución: 0,01 mmol/L.

Rangos de medición:

- Calcio: 0,2 – 5 mmol/L (suero/sangre).
- Litio: 0,2 – 5 mmol/L (suero/sangre).
- Otros electrolitos: configurables bajo demanda.
- Tiempo real: Reloj integrado para trazabilidad de resultados.

6.3 Beneficios clave

- Ahorro de tiempo: resultados rápidos con mínima intervención del usuario.
- Confiabilidad: Electrodos digitales sin mantenimiento.
- Flexibilidad: desde entornos pequeños hasta hospitales de alta demanda.
- Escalabilidad tecnológica: actualización desde modelos semiautomáticos hasta automáticos.
- Coste eficiente: consumo optimizado de reactivos y estándares.

6.4 Incluye

- Equipo analizador DIESTRO 103 AP v4 nuevo.
- Lector de código de barras
- Mantenimiento correctivo y preventivo
- UPS
- Kit inicial de calibración y lavado.
- Guía rápida en pantalla + manual completo.
- Garantía y soporte técnico especializado.


6.5 Listado de reactivos

REFERECIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACION	PRECIO PRUEBA SIN IVA	PRECIO KIT SIN IVA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON INVA
IN0100	Pack Calibración ISE	800	$5.345	$ 4.276.071	$ -	$ 4.276.071

BONIFICADOS		
IN0750	Diestro Trilevel Control x15 ml	1 Mensual
IN0050	Fill port cleaner	1 Trimestral

7. Propuestas técnica uroanálisis

H500 DIRUI
1 Unidad

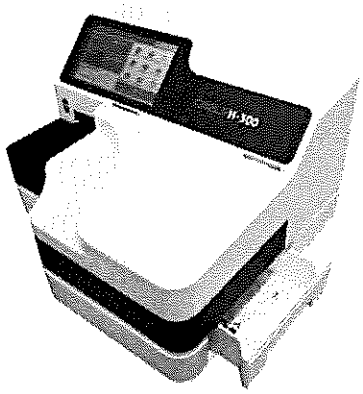

El DIRUI H-500 es un avanzado analizador automático de orina de alta velocidad, diseñado específicamente para laboratorios clínicos que manejan volúmenes medios y altos de muestras. Este equipo utiliza el principio de colorimetría fotoeléctrica para la detección precisa de cambios en las tiras reactivas de orina, lo que le permite realizar análisis rápidos y confiables. Su tecnología avanzada garantiza una excelente precisión en la medición de diversos parámetros, como glucosa, proteínas, pH y densidad, entre otros. Gracias a su diseño automatizado, el DIRUI H-500 no solo mejora la eficiencia operativa del laboratorio, sino que también minimiza el riesgo de errores humanos, permitiendo una gestión más eficiente de las muestras y obteniendo resultados en tiempo récord. Además, su interfaz amigable y sus opciones de personalización lo convierten en una herramienta indispensable para laboratorios clínicos de alta demanda.

7.1 Parámetros analizados

El DIRUI H-500 mide los siguientes parámetros, dependiendo de la tira utilizada:

- Glucosa (GLU)
- Proteína (PRO)
- Bilirrubina (BIL)
- Urobilinógeno (URO)
- Cetonas (KET)
- Sangre (BLO)
- Leucocitos (LEU)
- Nitrito (NIT)
- Densidad específica (SG)
- pH (pH)
- Microalbuminuria (MAU)

7.2 Garantía y soporte

- Todos nuestros equipos y reactivos cumplen con los requerimientos nacionales de registros Sanitarios otorgados por el INVIMA.
- El analizador H-500 es libre de mantenimientos preventivos, el apoyo tecnológico incluye todos los mantenimientos correctivos necesarios para garantizar la operación del analizador (sin repuestos).
- **Capacitación e Instalación:** La capacitación e instalación se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido previamente por Biometrika Laboratorio S.A.S.
- **Servicio postventa y garantía:** Contamos con una línea de soporte técnico científico disponible. La disponibilidad 24/7 aplica sólo para urgencias vitales en clínicas y hospitales que trabajan 24 horas. Línea de Atención: HELP DESK +57 317 4321900


7.3 Listado de reactivos

REFERECIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACION	PRECIO PRUEBA SIN IVA	PRECIO KIT SIN IVA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON INVA
3000185	Tiras de orina H11	100	$1.411	$141.079	$ -	$141.079

BONIFICADOS		
3913	Control negativo Dirui orina x 8mL	1 Mensual
3914	Control positivo Dirui orina x 8mL	1 Mensual

8. Propuesta técnica Hemoglobina Glicosilada

HB NEXT
1 Unidad

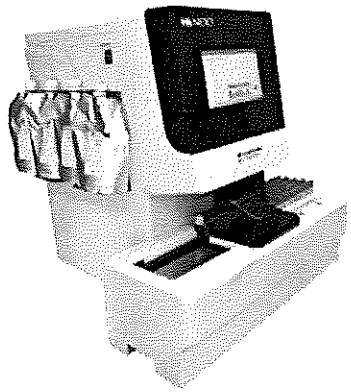

Hb NEXT es el nuevo analizador HPLC de intercambio catiónico en fase inversa diseñado para ofrecer una cuantificación precisa y exacta de HbA1c, HbA2, HbF y las principales variantes de hemoglobina. Basado en más de 35 años de contacto y asistencia diarios con los clientes, Hb NEXT es la respuesta a la necesidad de mayor flexibilidad, productividad y fiabilidad. En UN solo analizador, su laboratorio tiene la posibilidad de elegir libremente entre los DOS modos de análisis disponibles: El modo Variant para medir la HbA1c para la gestión de la Diabetes y el modo Thalassemia para el cribado de hemoglobinopatías. Utilizando la misma columna y todos los recipientes de reactivos instalados, el operador puede cambiar fácilmente de modo de análisis, lo que ofrece a su laboratorio la posibilidad de decidir entre TRES métodos de trabajo diferentes en función de las necesidades.

Reconocimiento automático del tipo de muestra con sólo 2 versiones de gradillas: sangre total/prehemolizada; muestras anémicas Identificación automática de las muestras mediante rotación del tubo y lectura del código de barras


Agitación de muestras por inversión del tubo de muestras Preparación semiautomática de calibradores, controles y muestras prehemolizadas Identificación y trazabilidad de reactivos mediante lectura de códigos QR Resultados trazables al método de referencia IFCC y notificados en unidades IFCC (mmol/mol) y NGSP (%)

8.3 Listado de reactivos y consumibles

REFERENCIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACIÓN	PRECIO PRUEBA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON IVA
55599	Eluyente A	195	$4.000	$ -	$780.000
55600	Eluyente B	1013	$1.260	$ -	$1.276.380
55601	Eluyente C	1162	$540	$ -	$627.480
55603	Solución Hemólisis	268	$6.800	$ -	$1.822.400
BONIFICADOS					
55604	COLUMNA	6000 TEST	Dependiendo del uso		
55605	Hb NEXT HbA1C Control	N/A	Dependiendo el uso		
55606	Hb NEXT HbA1C Calibrador	N/A	Al Cambio de Columna/Filtro		

9. Propuesta técnica ELISA

Analizador DS2
1 Unidad

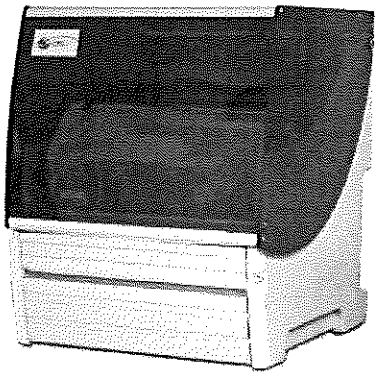

El analizador DS2 es un equipo automatizado de laboratorio clínico diseñado para realizar pruebas inmunoenzimáticas tipo ELISA con alta precisión y eficiencia. Este sistema compacto y completamente automatizado que permite procesar múltiples muestras simultáneamente, reduciendo el error humano y optimizando el tiempo de análisis. Es ideal para laboratorios de tamaño mediano que requieren confiabilidad en el diagnóstico de diversas condiciones médicas, como enfermedades infecciosas, hormonales y autoinmunes. El DS2 cuenta con funciones integradas de control de calidad, manejo de datos y seguimiento del proceso, lo que lo convierte en una herramienta esencial para garantizar resultados consistentes y reproducibles en entornos clínicos exigentes.

9.1 Listado de reactivos y consumibles


BONIFICADOS			
Referencia	**Reactivo/item**	**Presentacion**	**Cantidad al año**
62910	Deep Well Strips	Caja x250 tiras de 8 pozoz C/U	2
65950	Tubes reagent DSX	Pack de 24	2
62930	Regent Bottles 15 ml	Caja x10	2
157333SP	Sample Vials	50 Unidades	2
157333SP	Sample Caps	50 Unidades	2


65910	Sample Tips	Caja x432	25
65920	Racked Regent Tips	Caja x432 pruebas	10
50200410	L7394 Lamp 6V 20W 280 Lumens	Unidad	1
10495010	401 Cr ⅛ Pies Round Gem Punch	Unidad	1

REFERECIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACION	PRECIO PRUEBA SIN IVA	PRECIO KIT SIN IVA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON INVA
2525-300A	IgE AccuBind	96	$10.553	$ 1.013.131	$ -	$ 1.013.131
3425-300B	NTSH AccuBind	192	$11.717	$ 2.249.629	$ -	$ 2.249.629
BCH192	CHAGAS NATIVO IGG	192	$10.179	$ 1.954.379	$ -	$ 1.954.379
T1020	CHAGAS ELISA IGG+IGM	96	$13.189	$ 1.266.147	$ -	$ 1.266.147
ORG 538	ANAscreen	96	$18.290	$ 1.755.815	$ -	$ 1.755.815
M1018	DENGUE ELISA IGM CAPTURE	96	$18.759	$ 1.800.826	$ -	$ 1.800.826
M1003	Leptospira IgM ELISA	96	$27.705	$ 2.659.679	$ -	$ 2.659.679
ORG 601	Anti-CCP hs (high sensitive)	96	$29.212	$ 2.804.306	$ -	$ 2.804.306
S001	Sorbente Leptospira	92	$6.104	$ 561.600	$ -	$ 561.600

10. Propuesta técnica servicio microbiología

AutoSCAN-4 y MicroSCAN TubidityMeter
1 Unidad

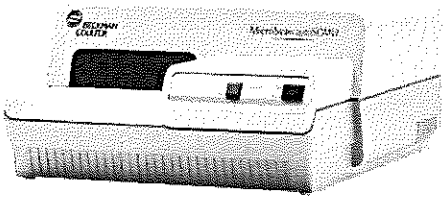



El AutoSCAN-4 es un sistema semiautomatizado utilizado en microbiología clínica para identificar microorganismos patógenos y realizar pruebas de sensibilidad a antimicrobianos, como antibióticos. Este equipo acelera el proceso de diagnóstico al automatizar la inoculación, la lectura de resultados y la interpretación de pruebas, lo que aumenta la precisión y reduce los errores humanos. Utiliza una base de datos extensa de microorganismos y patrones de resistencia, permitiendo una identificación rápida y precisa de infecciones, y ayudando a los médicos a elegir el tratamiento adecuado. Su interfaz amigable y resultados rápidos lo hacen ideal para laboratorios y hospitales.


10.1 Listado de reactivos y consumibles

Referencia	Poducto	Presentación	Precio kit sin IVA	IVA	Valor Total
B1016-171	Panel Urin Neg Combo Panel Type	20	$1.132.276	0%	$1.132.276
B1017-70	Microscan Rapid Yeast ID Panel	20	$1.229.585	0%	$1.229.585
C63726	Panel MicroScan Neg MIC 61	20	$1.132.276	0%	$1.132.276
B1016-174	PANEL POSITIVO COMBO 42	20	$1.132.276	0%	$1.132.276
C63727	Panel Negativo Combo 94	20	$1.132.276	0%	$1.132.276
B1015-7	INOCULUM WATER PLURONIC -D	60	$403.679	0%	$403.679
B1015-2	STERILE INOCULUM WATER TUBO	60	$306.246	0%	$306.246
B1013-4	INOCULATORS-D PAC	12	$37.094	19%	$44.142
B1010-40	MINERAL OIL 60ML	90	$76.613	19%	$91.170
B1010-44A	SULFANILIC ACID 30ML	600	$46.488	19%	$55.321

B1010-45A	N-N DIMETHYL ALPHA NAPHTHYLAMINE 30ML	600	$49.093	19%	$58.421
B1010-42A	A-NAPHTHOL 30ML	600	$58.110	19%	$69.151
B1010-43A	POTASSIUM HYDROXIDE 30ML	600	$46.488	19%	$55.321
B1010-41A	KOVACS REAGENT 30ML	500	$68.330	19%	$81.313
B1010-48A	FERRIC CHLORIDE 30ML	600	$49.093	19%	$58.421
B1012-30B	PEPTIDASE REAGENT 30ML	600	$45.085	19%	$53.651
B1010-56B	Cover Trays	12	$157.640	19%	$187.591
B1015-3	NaOH Hidróxido de sodio x 30 ml	600	$103.901	19%	$123.642

11. Propuestas técnica gases arteriales y electrolitos

PRIME CCS COMPLTE
3 Unidades

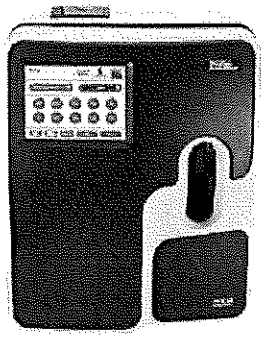

Tecnología avanzada para medición de gases arteriales electrolitos, metabolitos y cooximetría.

Características

- Pantalla táctil
- Lector de códigos de barras de 1 y 2 dimensiones
- Puerto para diferentes tipos de muestra Impresora integrada
- Puerto de seguridad para muestras


Stat Profile Prime combina la revolucionaria microelectrónica del mundo del consumo con la tecnología innovadora de MicroSensor Card™ de Nova Biomedical en un analizador químico simple, pequeño, rápido y costo efectivo, características indispensables en la toma de decisiones en cuidado crítico.

Lista de reactivos

REFERENCIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACIÓN	PRECIO PRUEBA	PRECIO KIT SIN IVA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON IVA
42035	Prime Sensor Card ES Bcomp	440 TEST/KIT	$4.243	$1.866.920	$354.715	$2.221.635
53461	Calibrator Cartridge ES Comp	440 TEST/KIT	$3.184	$ -	$ -	$1.400.960
53469	Calibrator Cartridge CCS COMP	550 TEST/KIT	$6.300	$ -	$ -	$3.465.000
55264	Prime Sensor Card CCS COMP	440 TEST/KIT	$4.594	$2.021.360	$384.058	$2.405.418
BONIFICADOS						
52484	Prime Tubing Harness	Unidad	6 Anual			
42043	Prime Reference Cartridge	Unidad	2 Anual			
5720	Stat Profile Prime Plus Printer Paper ROLLOS	Unidad	400 Anual			
53110	Prime Ampuled Control ES	Unidad	24 Anual			
53455	Prime Auto QC Cartridge CCS 100 Sample	Unidad	12 Anual			
38883	Stat Profile Critical Care Express syringe Clot Catcher NOVA	Caja x200	12 Anual			

12. Propuestas técnica uroanálisis

URIT 560
1 Unidad

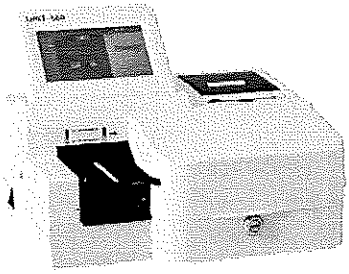

Las tiras reactivas Urit proporcionan pruebas para medición semi-cuantitativa de leucocitos, cetonas, nitritos, urobilinógeno, bilirrubina, proteínas, glucosa, densidad, sangre, pH , ácido ascórbico, creatinina, calcio y microalbumina en orina. Para usar en analizadores de orina Urit- 50, Urit-180, URIT500C , 330 , 31, 560 . La prueba está dirigida para diagnóstico en salud por profesionales.

Características


- Hasta 600P/ H
- Hasta 14parámetros incluyendo Cr, MA, Caf VitC.
- Detectores CIS, resultados más rápidos y precisos.
- Lector de código de barras opcional, pantalla táctil.
- Control URIT UQ-10, UQ-11 y UQ-14 disponible.

Listado de reactivos y consumibles

REFERENCIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACIÓN	PRECIO PRUEBA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON IVA
URIT 11 G	Tira reactiva de orina 11 parametros	100 Tiras	$1.344	$ -	$134.361
BONIFICADOS					
436	Urinalysis Control Level 1	4 viales x 12 mL	10 Anual		
437	Urinalysis Control Level 2	4 viales x 12 mL	10 Anual		
5525	Rollo termico	Unidad	40 Anual		

13. Propuesta técnica inmunología POCT

Biotime
1 Unidad

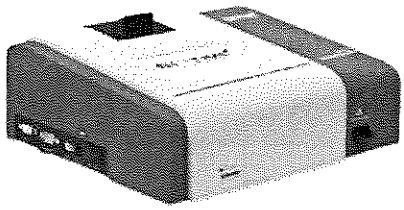

El analizador BIOT-YG-I FIA es un sistema de análisis de inmunoensayo de fluorescencia que puede ayudar a diagnosticar afecciones como enfermedades cardiovasculares, embarazo, infección, diabetes, lesión renal y cáncer, etc. La plataforma BIOT-YG-I proporciona resultados fiables y cuantitativos de varios tipos de analitos en sangre y orina humana en varios minutos. Aplicación: Cardiología, Urgencias, UCI, Respiratorio, Pediatría, Laboratorio, etc.

Características

- Tipo de funcionamiento: Automático
- Aplicaciones: Para diagnóstico clínico
- Método de análisis: De fluorescencia
- Configuración: De mesa, compacto, plataforma
- Otras características: point of care
- Incluye pipeta electronica y pipeta de 5UL

Listado de reactivos y consumibles

REFERENCIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACIÓN	PRECIO PRUEBA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON IVA
BT2106	NT- PRO BNP	25 TEST	$58.613	$ -	$1.465.317
BT2101	Troponina I	25 TEST	$31.851	$ -	$796.263
BT2105	Dimero D	25 TEST	$26.032	$ -	$65.081
W812	CONTROL DIMERO D	3X0.5ML	$-	$ -	$753.750
105-010228-A0	CONTROL PCT low Mindray	1 nivel x 2 ml	$-	$ -	$411.825

14. Propuesta técnica servicio pretransusional



El servicio transfusional es crucial en el sistema de salud, ya que asegura la disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para pacientes que lo necesiten, ya sea por cirugías, traumatismos, enfermedades hematológicas o trastornos metabólicos. La calidad de los equipos utilizados en este servicio es fundamental para garantizar la seguridad, la eficacia y la trazabilidad de las transfusiones, minimizando riesgos como infecciones o reacciones adversas. Además, contar con tecnologías avanzadas y personal capacitado optimiza la gestión de los recursos y mejora los resultados clínicos, salvando vidas y promoviendo una atención de salud más segura y eficiente.


Listado de reactivos y consumibles

Referencia	Poducto	Presentación	Valor Unitario	Valor Total
21033813	DG Gel ABO/Rh (2D)	2x25 tarjetas	$12.119	$605.938
21365913	SERIGRUP DIANA A1/B	2x10 ml	-	$264.715
21035413	DG Gel Sol	2x100 ml	-	$493.235
21020413	SERASCAN DIANA 2	2x10 ml	-	$427.042
21033913	DG Gel Confirm	2x25 tarjetas	$18.679	$933.953
21034213	DG Gel Coombs	2x25 tarjetas	$24.526	$1.226.304
213287-71	ESSENTIAL II CONTROL	2 X 2,6 ml	-	$714.141

Bonificados			
Referencia	Poducto	Presentación	Cantidad Anual
KJ703-2	TUBOS PARA DILUCION	4000	1
T-350-C	PUNTAS PIPETA 5-350	1000	1
TXL-10	PUNTAS PIPETA 0.1-10	1000	1

15. Propuesta técnica hematología

BC 5390
1 Unidad

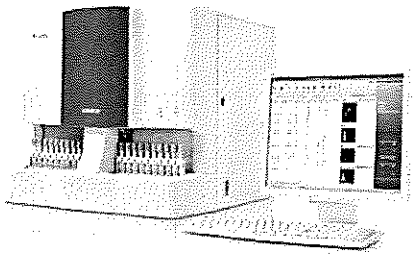

El BC-5390 es un analizador hematológico automático de diferencial leucocitario de 5 partes, diseñado para laboratorios clínicos que requieren un alto desempeño, resultados confiables y una operación eficiente. Este equipo combina tecnología avanzada de análisis celular con un diseño orientado a optimizar el flujo de trabajo del laboratorio, permitiendo obtener resultados rápidos y precisos que contribuyen a un diagnóstico oportuno y a una mejor atención del paciente.

Gracias a su capacidad para realizar un análisis completo del hemograma con diferencial de cinco poblaciones leucocitarias (neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos), el BC-5390 proporciona información hematológica detallada que facilita la identificación de alteraciones relacionadas con enfermedades infecciosas, inflamatorias, hematológicas y otras condiciones clínicas de importancia diagnóstica.

Su rendimiento de 60 muestras por hora le permite ahorrar tiempo, y la capacidad de 40 tubos de carga automática puede extender el tiempo de autonomía

Con diferentes adaptadores de soporte, el analizador admite tres modos de análisis:

- Modo de sangre entera venosa
- Modo prediluido
- Modo de sangre entera capilar.

Adicionalmente, el BC-5390 incorpora un software intuitivo con una interfaz gráfica de fácil manejo que facilita la operación diaria, el almacenamiento y consulta de resultados, la revisión de histogramas y dispersogramas, así como la gestión eficiente de los datos del paciente. El sistema incluye funciones automáticas de control de calidad, mantenimiento programado y monitoreo continuo del estado del equipo, contribuyendo a minimizar errores operativos y a mantener un rendimiento analítico estable.


Listado de reactivos y consumibles

Referencia	Poducto	Presentación	Precio kit sin IVA	IVA	Valor Total
105-011736-A0	M-53D Diluent	20 L	$298.365	0%	$298.365
105-011724-A0	M-5 LEO(I) Lyse	1L×4	$2.542.408	0%	$2.542.408
105-011729-A0	M-5 LEO(II) Lyse	500mL×4	$3.176.690	0%	$3.176.690
105-011734-A0	M-53LH Lyse	500mL×4	$2.031.826	0%	$2.031.826

Bonificados			
Referencia	Poducto	Presentación	Cantidad Anual
040-001496-A0	SC -CAL PLUS	Unidad	1
040-000018-00	BC-5D	Unidad	12
105-002225-A0	Probe cleanser	Unidad	27

16. Propuesta técnica Quimica

BS 480
1 Unidad

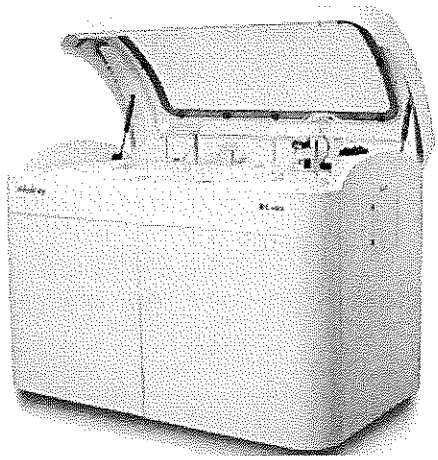

Analizador de bioquímica clínica de piso, de acceso aleatorio que ofrece un rendimiento constante de 400 análisis por hora.

Sistema de líquido mejorado

- Aspiración precisa de muestras y reactivos
- Eliminación de burbujas de aire incorporadas antes del lavado
- Arrastre < 0.05 %
- La tecnología de aplanamiento de punto de luz facilita la reducción del volumen de reacción
- Refrigeración ininterrumpida las 24 horas a 2-10°C
- Indica el volumen de la cubeta: 120~360 µl
- Protección contra colisiones vertical y horizontal
- Recuperación automática del sistema
- Detección del nivel de líquido, detección de coágulos
- Incluye equipo backup y equipo de agua

Listado de reactivos y consumibles


Referencia	Producto	Presentación	Precio kit sin IVA	IVA	Valor Total
1001065	CALCIO	150	$437.178	0%	$437.178
1001241	TIBC	100	$874.910	0%	$874.910
1001285	MAGNESIO	300	$309.116	0%	$309.116
1102134	TRANSFERRINA	150	$327.585	0%	$327.585
1001155	FOSFORO	300	$507.834	0%	$507.834
105-009168-A0	Total Protein in Urine/CSF	378	$67.065	0%	$67.065
MD41001	ACIDO URICO	720	$894.229	0%	$894.229
MD1001020	ALBUMINA	617	$766.483	0%	$766.483
MD1001291	PROTEINAS TOTALES	720	$894.229	0%	$894.229
MD1001046	BILIRUBIN Total	600	$745.191	0%	$745.191

MD1001047	BILIRUBIN Direct	600	$745.191	0%	$745.191
MD1001111	CREATININA	720	$894.229	0%	$894.229
MD1001117	CREATININA Enzimática	443	$946.643	0%	$946.643
MD41011	GLUCOSA	720	$894.229	0%	$894.229
MD41041	UREA	600	$745.191	0%	$745.191
MD41264	GOT/AST	600	$745.191	0%	$745.191
MD41274	GPT/ALT	600	$745.191	0%	$745.191
MD41214	LDH	600	$745.191	0%	$745.191
MD41021	COLESTEROL TOTAL	720	$894.229	0%	$894.229
MD41031	TRIGLICERIDOS	720	$894.229	0%	$894.229
MD41201	AMILASA	720	$2.483.971	0%	$2.483.971
MD41250	CREATIN QUINASA	600	$745.191	0%	$745.191
MD41254	CK-MB	600	$1.821.578	0%	$1.821.578
MD41233	ALP	600	$786.591	0%	$786.591
1001275	LIPASA	108	$1.352.900	0%	$1.352.900
1001247	HIERRO FERROZINE	450	$492.667	0%	$492.667
1107101	PCR CUANTITATIVA	300	$416.575	0%	$416.575
MD1001096	COLESTEROL HDL	514	$1.064.560	0%	$1.064.560
MD1107170	MICROALBUMINA	600	$1.034.987	0%	$1.034.987
1102094	COMPLEMENTO C3	150	$394.650	0%	$394.650
1102104	COMPLEMENT C4	150	$394.650	0%	$394.650
21015025	ETIQUETA TERMICA	2500	$78.659	19%	$93.604
1001410	AMMONIA. Enzymatic - UV	100	$759.314	0%	$759.314

Bonificados			
Referencia	**Poducto**	**Presentación**	**Cantidad Anual**
1002011	SPINTROL H CALIBRADOR	10 x 3 ml	6
428	ADBIO Immunology Control Level 1	4X1ML	27
310	ADBIO Assayed Chemistry Control Level 1	4 x 5 mL	9
315	ADBIO Assayed Chemistry Control Level 2	4 x 5 ml	9
1102003	CALIBRADOR GENERAL PROTEINAS	1 x2 ML	1
43105	HbA 1c-d CALIBRATOR Urine	4x0,5 mL	2
376	ADBIO Quantitative Control Level 1	4 viales x 10 mL	3
377	ADBIO Quantitative Urine Control Level 2	4 viales x 10 mL	3
8740B	ADBIO Diabetes Control Bilevel	2 niveles x 3	8
115- 078927-00	BOTELLA DE REACTIVO	20 mL	10
115- 078924-00	BOTELLA DE REACTIVO CORTA	40 mL	10
115- 078923-00	BOTELLA DE REACTIVO LARGA	40 ml	10
115- 078914-00	TAPAS DE BOTELLAS DE REACTIVO	-	30
115- 004016-00	CUBETAS DE REACCION PARA	-	1
801-BA80- 00222-00	20W LAMP(FRU) Yellow	-	3
801-BA38- 00052-00	Water Inlet Filter	-	1
801-BA40- 00288-00	DISHING FILTER	-	1
801-BA80- 00020-00	Water Inlet Filter Unidad	1	2
105- 000107-A0	DETERGENTE CD80	CAJA 6 X 2 LITROS	13
801-0000- 00011-00xP	Cleaning Tool	10pcs, 1pkg	1

17. Propuesta técnica hormonas e infecciosas

MINDRAY CL1000i
1 Unidad

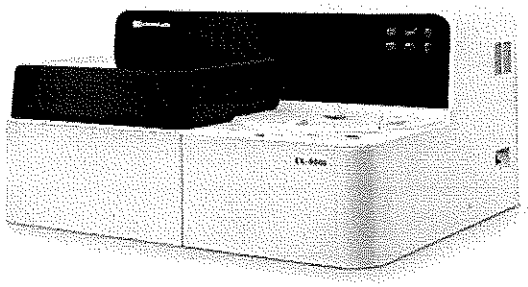

Un analizador de inmunoensayo completamente capaz y robusto con un rendimiento coherente con el CL-2000i, en un tamaño de sobremesa más pequeño y mejor diseñado para laboratorios de tamaño medio y pequeño. Con una capacidad de 180 pruebas por hora, este sistema incluye su gran capacidad de reactivo y muestra, rendimiento fiable e interfaz de operación intuitiva.

- Plataforma SPMP (Partículas micro super paramagnéticas), con capacidad de suspensión alta.
- Reactivos etiquetados con fosfatos alcalinos (ALP) y sustrato AMPPD, método inmunológico de la más alta sensibilidad, para pruebas como TSH, HIV, HBsAg, etc.
- Establece un alto nivel de control de calidad de anticuerpos y antígenos.
- Separación magnética de 4 fases; mezcla entre fases de separación diferentes.
- Mezcla con agitardor vortex sin tocar para solución de reacción sin ninguna contaminación.
- Carga y descarga continuas de las muestras con racks.
- Rack de muestras unificado con adaptador desmontable.
- Información del estado del rack en tiempo real indicada en el número de canal.
- Sistema de muestras de urgencias rápido con prioridad.
- Acceso aleatorio para carga de cubeta sin pausa o detención de 88*2 cubetas en un lote, 200 cubetas por cada bolsa de desechos.
- Indicación en tiempo real del estado de la bolsa de desechos y cubetas.

Listado de reactivos y consumibles

HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES S.A.S
NIT: 900.913.246-8

Referencia	Producto	Presentación	Precio kit sin IVA	IVA	Valor Total
105-004212-A0	TSH 2 X 50	100	$896.990	0%	$896.990
105-004209-A0	FT4 2 X 50	100	$896.990	0%	$896.990
105-004210-A0	T3 2 X 50	100	$896.990	0%	$896.990
105-017089-A0	HCG 2X50	100	$896.990	0%	$896.990
105-004219-A0	PSA TOTAL 2x50	100	$896.990	0%	$896.990
105-004220-A0	FERRITINA 2X50	100	$896.990	0%	$896.990
105-008683-00	Folato 1X50	50	$896.990	0%	$896.990
105-005659-A0	Troponin I (CLIA)	100	$1.793.979	0%	$1.793.979
105-008682-00	Vitamina B12 2X50	100	$1.793.979	0%	$1.793.979
105-008681-00	25-OH-Vitamin D Total 1x50	50	$1.368.376	0%	$1.368.376
105-004208-00	FT3 2 x50	100	$686.123	0%	$686.123
105-004214-00	AFP 2X50	100	$1.056.268	0%	$1.056.268
105-004213-00	CEA 2X50	100	$1.189.107	0%	$1.189.107
105-004215-00	CA125 2x50	100	$1.845.567	0%	$1.845.567
105-010703-00	PCT	100	$5.933.930	0%	$5.933.930
105-008684-00	PTH 2x50	100	$2.897.966	0%	$2.897.966
105-012515-A0	Rubella Virus IgM (CLIA) 2x50	100	$1.432.733	0%	$1.432.733
105-012521-A0	Rubella Virus IgG (CLIA) 2x50	100	$1.432.733	0%	$1.432.733
105-012533-A0	Toxoplasma gondii IgM (CLIA) 2x50	100	$1.387.440	0%	$1.387.440
105-012527-A0	Toxoplasma gondii IgG (CLIA) 2x50	100	$1.387.440	0%	$1.387.440
105-012545-A0	Cytomegalovirus IgM (CLIA) 2x50	100	$1.432.733	0%	$1.432.733
105-012539-A0	Cytomegalovirus IgG (CLIA) 2x50	100	$1.432.733	0%	$1.432.733

Dirección: AV UNIVERSITARIA #75 A- 00 BLOQUE C L3 CENTRO EMPRESARIAL GREEN HILLS
Tunja Boyacá Teléfono celular: 3107353148
Correo electrónico: contabilidad@heiser.com.co


105-004234-00	Human Immunodeficiency Virus	100	$1.580.100	0%	$1.580.100
105-004222-A0	FSH 2 x50	100	$807.730	0%	$807.730
105-004223-A0	LH 2x50	100	$807.730	0%	$807.730
105-004224-A0	PROLACTINA 2 x50	100	$807.730	0%	$807.730
105-004211-A0	T4 2 x50	100	$686.123	0%	$686.123
105-004229-A0	Hepatitis B Surface Antigen	100	$1.090.472	0%	$1.090.472

Bonificados		
Referencia	**Producto**	**Cantidad Anual**
105-002225-A0	Probe Cleanser (50 ml)	27
105-004552-A0	Wash buffer	70
105-009044-A0	Substrate solution- 75 ml * 4	30
115-035753-00	Reaction Cuvette + Waste bin	4
105-015410-00	Detergente C - Exclusivo para CL-900i	2
05-009143-A0	System Wash Solution	1
105-009141-A0	System Detection Solution	1
105-004276-A0	Sample Diluent - Automatico	6
105-004628-A0	Sample Diluent (manual)	2
105-004281-A0	Calibrador TSH	7
105-004278-A0	Calibrador FT4	5
105-004279-A0	Calibrador T3	5
105-004288-A0	CALIBRADOR PSA TOTAL	5
105-004289-A0	CALIBRADOR FERRITINA	5
105-008552-A0	Calibrador Vitamina B	5
105-008551-A0	Calibrador Folato	5

105-005910-A0	Calibrador Troponina	5
105-008553-A0	Calibrador PTH	5
105-010219-A0	Calibrador Procalcitonina	7
105-010228-A0	PCT Control Procalcitonina (L)	5
105-008554-A0	Metabolic Multi Control (L)	6
105-008555-A0	Metabolic Multi Control (H)	6
105-024834-A0	ToRCH IgG Positive Control	6
105-024842-A0	ToRCH IgM Positive Control	6
105-024826-A0	ToRCH IgG/IgM Negative Control	6
105-001144-A0	Multi Sera - Cal 10×3 mL	1
115-078914-A0	REAGENT BOTTLE CAP	30

18. Propuesta técnica coagulación

Rayto RAC-050
1 Unidad

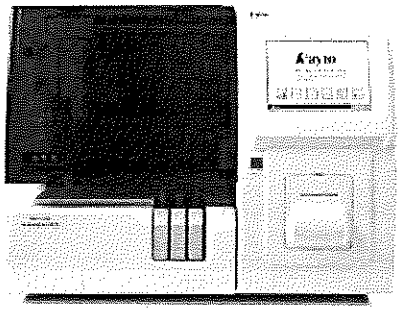

El analizador automatizado Rayto-050 permite realizar pruebas de coagulación de forma eficiente y precisa. Excelente para laboratorios de alto y medio volumen de pruebas.

Características

- Hasta 60 pruebas por hora de TP
- Diseño compacto en un equipo inteligente
- Parámetros de medición: TP, TPT, TT, Fibrinógeno, Antitrombina III, Dímero-D y PDF (Productos de degradación de fibrina)
- Métodos de medición: coagulación, cromogénico e inmunológico
- 7 canales de detección
- 27 posiciones de muestras y 23 posiciones de reactivos
- Pantalla touch con interfaz fácil y simple de operar
- Alto rendimiento en obtener resultados de exámenes


Listado de reactivos y consumibles

Referencia	Poducto	Presentación	Precio kit sin IVA	IVA	Valor Total
10445705	INNOVIN	10 x 4 ml	$1.976.720	0%	$1.976.720
10445713	ACTIN FSL	10 x 2 ml	$2.468.885	0%	$2.468.885
10445718	Fibrinogen - Hemo - RGT	6 x 1 ml	$1.099.243	0%	$1.099.243
7408	ADBIO Coagulation Control Bilevel	2 niv x 12vial x 1 mL	$1.128.449	0%	$1.128.449

Bonificados		
Referencia	Poducto	Cantidad Anual
1-6-076-031-00	Sample Cup x 500	1
1-6-076-032-10	Cuvette x 1000	14
10446232	Calcium Chloride 25 mM - Hemo - CONS 10 x 15 ml	3

18.1 Equipo Backup

ANALIZADOR START MAX
1 Unidad

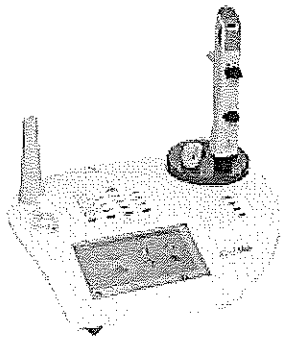


- Instrumento semi-automatizado de sobre mesa completa para el campo de la hemostasia.
- Una solución MAX de hemostasia para un espacio pequeño.
- Amplio panel de pruebas, cubriendo rutina y especiales.
- Máxima estandarización de los resultados.
- Trazabilidad ampliada para mejorar el cumplimiento normativo.

Listado de reactivos y consumibles

Referencia	Poducto	Presentación	Precio kit sin IVA	IVA	Valor Total
10446232	Calcium chloride 25nm	150	$261.380	0%	$261.380
B025E x 700	B025E STA -4 Cuvett x 700	700	$649.954	19%	$773.445
38052	Fintips Star 4	100	$3.244.494	19%	$3.860.948
86553	COMBITIPS - Start Max	100	$3.157.487	19%	$3.757.409

19. Propuesta técnica renovación tecnologica microbiologia

VITEK® COMPACT PRO
1 Unidad

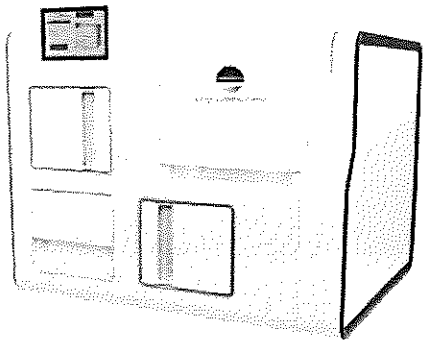

Características

- Preparación de muestras sencilla y estandarizada.
- Pasos totalmente trazables para un flujo de trabajo más sencillo y fiable.
- Interfaz de usuario intuitiva con pasos del flujo de trabajo detallados e ilustraciones.
- Carga y procesamiento de casetes más rápidos en hasta un 20 % menos de tiempo.
- El tiempo de manipulación más breve de todos, con un 40-50 % menos de pasos de flujo de trabajo.
- Resultados de AST sistemático en solo 6-8 horas, con resultados preliminares para informar a los profesionales clínicos más pronto.
- Resultados de sensibilidad y detección de mecanismos de resistencia de gran precisión.
- Transferencia automática de los resultados validados de ID y AST en el sistema de información de laboratorio (SIL).
- Concentración inhibidora mínima (CMI) precisa que cumple con los estándares de EUCAST/CLSI o FDA.

Listado de reactivos y consumibles

Código	Nombre	Presentación	Precio Prueba	Precio kit	IVA	Precio total
21342	GP TEST KIT VTK2	20	$44.149	$882.976	$ -	$882.976
423646	AST-P663 TEST KITS	20	$44.754	$895.077	$ -	$895.077
421040	AST-ST03 TEST KIT	20	$44.149	$882.976	$ -	$882.976
21341	GN TEST KIT VTK2	20	$44.149	$882.976	$ -	$882.976
423643	AST N401 TEST KIT	20	$44.251	$885.011	$ -	$885.011
423645	AST-N403 TEST KIT	20	$46.009	$920.171	$ -	$920.171
423644	AST-N402 TEST KIT	20	$45.932	$918.637	$ -	$918.637
21343	YST TEST KIT VTK2	20	$45.943	$918.850	$ -	$918.850
420739	AST-YS08 TEST KIT	20	$44.149	$882.976	$ -	$882.976
21347	ANC TEST KIT VTK2	20	$44.149	$882.976	$ -	$882.976
21346	NH TEST KIT VTK2	20	$44.149	$882.976	$ -	$882.976
V1204	SALINE SOLUTION 3X500ML	1	$780.051	$780.051	$148.210	$928.261
21219	ACCESSORY KIT VTK2 PIP/DIL	1	$1.172.647	$1.172.647	$222.803	$1.395.450
69285	UNSENSITIZED TUBES 1X2000	2000	$680	$1.359.690	$258.341	$1.618.031

20. Condiciones comerciales

Plazo entrega de equipos: Si el equipo se encuentra disponible se realizará la entrega a los 20 días siguientes a la firma del contrato. De lo contrario, el tiempo será de 90 días por trámite de importación.

Contrato:
Las condciones de la presente propuesta se basan en un contrato de comodato para el cambio y renovación de tecnología de punta, con una duración mínima de cinco (5) años. Adicionalmente, se suscribirá anualmente un contrato de suministro de reactivos e insumos necesarios para el funcionamiento del equipo entregado en comodato, conforme a las condiciones que se acuerden con el hospital.

Forma de pago: crédito 30 días.

Vigencia de la oferta: 30 Días

Servicio de ingeniería: se prestará un servicio de ingeniería de mantenimiento preventivo y correctivo, según la necesidad del laboratorio durante los años en el que se ejecute el contrato.

Se reconocerá sin costo las partes defectuosas por fabricación de los equipos, que sean detectadas por el servicio técnico de ingenieros. Los daños ocasionados por variación de corriente alta, sin estabilizadores electrónicos, eventos adversos externos (Terremoto, Tormenta Eléctrica, Inundaciones, entre otros) o por maltrato del equipo (dejarlo caer al suelo, o regar en su parte interna o externa ácidos corrosivos, etc.), serán cubiertos por la institución. Se prestará servicio de asesoría continua por parte del Bacteriólogo Asesor de cada casa comercial, con entrenamiento de los equipos y apoyo continuo. Los precios de los reactivos y consumibles estarán vigentes hasta diciembre 31 de 2025, siempre y cuando la TRM no supere un aumento del 10%, en este caso se hará necesario reevaluar los precios, de lo contrario los precios se actualizarán anualmente, teniendo en cuenta el IPC y la TRM.

Cualquier inquietud o información adicional, con gusto le estaremos atendiendo.

Cordialmente,

CLAUDIA SIERRA PINILLA GERENTE
HEALTH INTEGRATED SERVICES
S.A.S

NIT: 900536828-7

09 de Julio del 2026

Señores:
Ana Maritza Dávila Barón
Gerente
Angela Reyes
Coordinadora laboratorio clínico
Hospital Regional de Moniquirá


Estimados Señores,

Nos complace presentar, en conjunto con nuestros aliados comerciales, la presente propuesta técnica y económica para el suministro de tecnología de última generación destinada al laboratorio clínico de su institución, abarcando las áreas de química clínica, inmunología, hematología, coagulación, electrolitos, microbiología y gases arteriales.

En Mediqsalud S.A.S. entendemos que la excelencia en un laboratorio clínico depende de la incorporación de soluciones tecnológicas innovadoras, confiables y de alto desempeño. Por ello, ponemos a su disposición un portafolio integral de equipos diseñados para fortalecer la capacidad diagnóstica, optimizar los procesos operativos y responder a las crecientes necesidades del sector salud.

1.Propuestas técnica inmunoquímica clínica

Vitros 5600
1 unidad

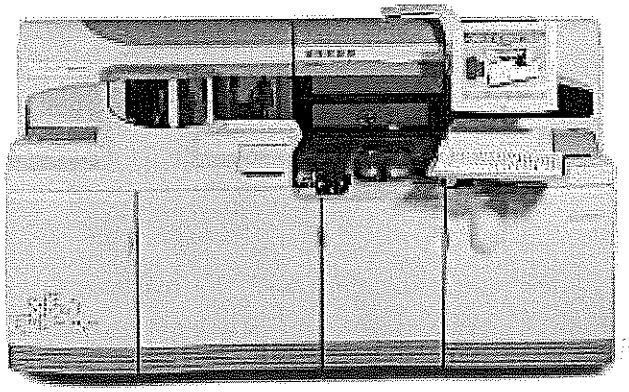


El Sistema VITROS® 5600 combina menús completos de química clínica e inmunoensayo de más de 160 ensayos, todo en una sola plataforma integrada, lo que proporciona alta calidad, productividad y valor a su laboratorio. y está diseñado para ayudarlo a consolidar de manera eficiente las pruebas críticas para brindar resultados precisos y oportunos a los médicos y pacientes que dependen de usted. También puede confiar en que el Sistema VITROS esté en funcionamiento cuando lo necesite, con su tiempo de actividad del analizador líder en la industria del 98 %.*

Valor aportado a su eficiencia operativa:

- Cargue y retire muestras desde un único punto de entrada/salida
- Evite las interrupciones con la carga automática y equilibrio del menú
- Libere al personal para que se concentre en la entrega de resultados precisos con clasificación y destapado automatizados
- Acceda fácilmente a las muestras desde las gradillas donde se preparan y almacenan
- Minimice el tiempo del técnico con enrutamiento y recuperación automáticos de muestras

Vitros 250
1 unidad (Backup química clínica)

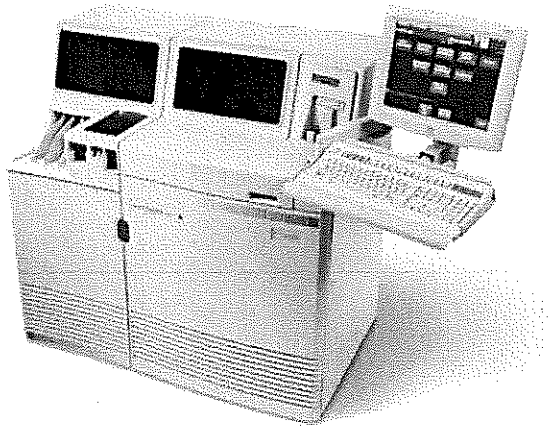

El sistema VITROS® 250, es un sistema automatizado de piso compacto, diseñado para ofrecer eficacia, fiabilidad y, sobre todo, sencillez de uso como sistema primario, de urgencias o de respaldo. **Optimización del trabajo** La eliminación de la preparación de reactivos y las calibraciones semestrales ofrecidas por la Tecnología MICROSLIDE significan que el personal de laboratorio puede ser reasignado a tareas más importantes. Entre sus características estan:

- Mínimo tiempo de mantenimiento del instrumento.
- Capacidad de interfasar bidireccionalmente.
- No requiere agua desionizada, cañerías ni desagües
- Operación de acceso continuo y aleatorio de muestras.
- Calibraciones semestrales o cada cambio de lote.
- Los slides estan empacados en cartuchos, mismos que son identificados con código de barras sin importar el numero de lote permitiendo su carga en el equipo en un solo paso.
- Los cartuchos conteniendo slides, de cualquier lote, al ser identificados con códigos de barras pueden ser cargados en el instrumento en un sencillo paso.
- El equipo realiza la dilución automática de las orinas y de los sueros lo cual se traduce a menor cantidad de tiempo en el proceso.
- Una nueva pantalla plana, anti-reflejo y sensible al tacto con un diseño ergonómico.

Menú de pruebas Vitros 250:

MicroSlide™ (Química Seca)

QUÍMICA
Ácido Úrico (S/U)
ALC
Albúmina
ALT
Amilasa
Amonio
AST
Bilirrubina Total
Buba
BUN (S/U)
Calcio (S/U)
CK-MB
Cloro
Colinesterasa
Colesterol
CRP
dHDL
ECO2
Fosfatasa Ácida
Fosfatasa Alcalina
Fósforo
GGT
Glucosa
Hierro
Lactato
LDH
Lipasa
Magnesio (S/U)
Potasio(S/U)
Proteina (LCR)
Proteina Total
Sodio (S/U)
Triglicéridos
UPRO

TDM
Acetaminofén
Carbamazepina
Digoxina
Fenobarbital
Fenitoina
Litio
Salicilato
Teofilina

S: Suero U: Orina LCR: Liquido Cefalorraquideo

Oferta de Entrenamiento

Los entrenamientos se coordinarán de mutuo acuerdo entre las dos partes se sugiere realizar bajo el siguiente esquema tanto en tiempo como en el personal:

Fase 1:

- Se designará dentro de las profesionales del laboratorio aquellas que requieran tener conocimiento completo de los equipos ya que lo manejarán de rutina, el entrenamiento será de 4 días – durante 7 horas y en un grupo conformado por máximo 4 participantes por entrenamiento, tiempo en el cual obtendrán conocimiento de toda la plataforma: características, ventajas, beneficios, infraestructura, programación, mantenimientos diario mensual y de acuerdo con necesidad, piezas entre otros temas.
- Para personal eventual de turnos, que su conocimiento no requiera el detalle por su rotación, esta capacitación es de 7 horas durante 3 días, en grupos con un máximo de 3 participantes.

Fase 2:

Posterior al entrenamiento inicial, se coordinará una segunda visita para reforzar temas fundamentales de desempeño de los equipos lo mismo que para profundizar áreas como la de Control de Calidad teniendo en cuenta que ya se ha tenido desempeño del sistema en la institución y bajo las condiciones propias del personal lo cual permitirá la finalización del periodo de puesta en marcha de los sistemas.

Estos tiempos pueden estar sujetos a cambios según la institución y al personal a entrenar.

Acompañamientos y servicio de soporte

Dentro de los acompañamientos y servicios de soporte ofrecido por el grupo de especialistas se encuentran:

- Capacitación y entrenamiento en las plataformas y uso de los productos
- Asesoría en control de calidad Interno y externo
- Acompañamiento con el área de Ingeniería en la resolución de situaciones que así lo requieran
- Tramite de garantías por pérdida de producto y reposiciones por daño de máquina y/o fallas en el desempeño de los reactivos.
- Coordinación de planes de contingencia para remisión de muestras a otras plataformas VITROS.

2. Propuesta comercial

- 1 equipo Vitros 5600 integrado usado (química e inmunología) que disminuye costos en tubos pues solo se necesita 1 tubo para química e inmunología, simplifica y consolida el proceso.
- 1 equipo Vitros 250 para química clínica como backup
- Equipos de computo
- Integración al LIS

2.1 Lista de precios química clínica e inmunología:

REFERECIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACION	PRECIO PRUEBA SIN IVA	PRECIO KIT SIN IVA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON INVA
8004707	COLINESTERASA	90	$1.507	$135.650	$ -	$135.650
6801728	LDL DIRECTO	600	$ 7.226	$ 4.335.816	$ -	$ 4.335.816
1726926	AMONIACO	90	$ 6.400	$ 576.044	$ -	$ 576.044
6844425	INSULINA	100	$ 22.375	$ 2.237.494	$ -	$ 2.237.494
1435205	TESTOSTERONA	100	$ 17.137	$ 1.713.679	$ -	$ 1.713.679
8552630	ESTRADIOL	100	$ 16.802	$ 1.680.200	$ -	$1.680.200
6800040	CA19-9	100	$ 28.203	$ 2.820.345	$ -	$2.820.345
1074053	CORTISOL	100	$ 15.692	$ 1.569.153	$ -	$1.569.153
6800120	PROTEINAS TOTALES EN ORINA	90	$ 2.684	$ 241.566	$ -	$241.566
1926740	PCR CUANTITATIVA	250	$ 7.846	$ 1.961.485	$ -	$ 1.961.485
6801735	COMPLEMENTO C3	300	$ 9.291	$ 2.787.310	$ -	$ 2.787.310
6801736	COMPLEMENT C4	300	$ 9.291	$ 2.787.310	$ -	$ 2.787.310
6802001	TIBC	300	$ 12.043	$ 3.612.974	$ -	$ 3.612.974
6801740	MICROALBUMINA	300	$ 6.607	$ 1.982.087	$ -	$ 1.982.087
6801767	TRANSFERRINA	300	$ 7.226	$ 2.167.908	$ -	$ 2.167.908
1924547	HIERRO	90	$ 1.874	$ 168.626	$ -	$168.626
6842844	PSA TOTAL	100	$ 21.526	$ 1.993.168	$ -	$ 1.993.168
1318450	Anti-HCV	100	$ 31.752	$ 3.175.200	$-	$ 3.175.200
6800039	CA15-3	100	$ 34.020	$ 3.402.000	$ -	$3.402.000

MediQSalud

NIT: 900536828-7


8478034	CREATIN QUINASA	90	$ 2.292	$ 206.261	$ -	$ 206.261
1931922	FSH	100	$ 18.169	$ 1.816.912	$ -	$ 1.816.912
1315589	FT3	100	$ 13.420	$ 1.342.037	$ -	$ 1.342.037
8669335	TOXOPLASMA GONDII IgM	100	$ 24.322	$ 2.432.185	$ -	$ 2.432.185
8091399	TOXOPLASMA GONDII IgG	100	$ 23.744	$ 2.374.374	$ -	$ 2.374.374
1921204	MAGNESIO	90	$ 1.776	$ 159.804	$ -	$ 159.804
1513209	FOSFORO	300	$ 2.176	$ 652.714	$ -	$ 652.714
1849793	PROLACTINA	100	$ 14.040	$ 1.404.000	$ -	$ 1.404.000
1350198	LH	100	$ 13.420	$ 1.342.037	$ -	$ 1.342.037
1925551	AFP	100	$ 17.550	$ 1.754.972	$ -	$ 1.754.972
6844436	HS-TROPONINA I	100	$ 26.841	$ 2.684.075	$ -	$ 2.684.075
6844466	TSH	100	$ 13.420	$ 1.342.037	$ -	$ 1.342.037
1387000	FT4	100	$13.420	$ 1.342.037	$ -	$ 1.342.037
6808888	T3 TOTAL	100	$13.420	$ 1.342.037	$ -	$ 1.342.037
6802220	HCG	100	$13.420	$ 1.342.037	$ -	$ 1.342.037
8356636	FERRITINA	100	$13.420	$ 1.342.037	$ -	$ 1.342.037
8744468	T4 TOTAL	100	$13.420	$ 1.342.037	$ -	$ 1.342.037
1920115	CEA	100	$ 17.550	$ 1.754.972	$ -	$ 1.754.972
8392292	PROTEINAS TOTALES	250	$ 1.652	$ 412.935	$ -	$ 412.935
6844452	NT-proBNP II	100	$ 34.411	$ 3.441.123	$ -	$ 3.441.123
1336544	TRIGLICERIDOS	300	$ 1.652	$ 495.521	$ -	$ 495.521
6844430	LDH	250	$ 1.652	$ 412.935	$ -	$412.935
8433815	GOT/AST	300	$ 1.646	$ 493.660	$ -	$ 493.660
6844288	GPT/ALT	250	$ 1.646	$ 411.384	$ -	$ 411.384
1484427	Rubeola Virus IgM	100	$ 18.983	$ 1.898.262	$ -	$ 1.898.262
8536195	Rubeola Virus IgG	100	$18.983	$ 1.898.262	$ -	$ 1.898.262
6800038	CA125	100	$ 25.870	$ 2.587.035	$ -	$ 2.587.035
1988211	ALBUMINA	90	$ 1.646	$ 148.132	$ -	$ 148.132

8001133	CK-MB	90	$ 4.129	$ 371.641	$ -	$ 371.641
6801830	CITOMEGALOVIRUS IgM	100	$ 18.983	$ 1.898.264	$ -	$ 1.898.264
6905558	Procalcitonina	100	$ 78.620	$ 7.862.008	$ -	$ 7.862.008
1053180	ALP	300	$ 1.737	$ 521.087	$ -	$ 521.087
8159931	BILIRRUBINA TOTAL	300	$ 1.596	$ 478.866	$ -	$ 478.866
8383051	BUBC	300	$1.596	$ 478.866	$ -	$ 478.866
8102204	BUN	300	$1.596	$478.866	$ -	$478.866
6801827	CITOMEGALOVIRUS IgG	100	$ 18.448	$ 1.844.789	$ -	$ 1.844.789
6842779	VIH COMBO	100	$ 21.679	$ 2.167.907	$ -	$ 2.167.907
1513266	FOLATO	100	$ 23.056	$ 2.305.610	$ -	$ 2.305.610
6802584	CREATININA	300	$ 1.596	$ 478.866	$ -	$ 478.866
8435307	HBsAg	100	$ 14.448	$ 1.444.793	$ -	$ 1.444.793
1669829	COLESTEROL TOTAL	300	$ 1.596	$ 478.866	$ -	$ 478.866
6801895	COLESTEROL HDL	300	$ 2.662	$ 798.456	$ -	$ 798.456
1943927	ACIDO URICO	300	$ 1.342	$ 402.611	$ -	$ 402.611
1707801	GLUCOSA	300	$ 1.596	$ 478.866	$ -	$ 478.866
1453489	VITAMINA B12	100	$ 23.056	$ 2.305.610	$ -	$ 2.305.610
6900052	PTH	100	$ 37.244	$ 3.724.394	$ -	$ 3.724.394
8112724	AMILASA	90	$ 4.434	$ 399.019	$ -	$ 399.019
6842894	VITAMINA D 25-OH	100	$ 35.172	$ 3.517.233	$ -	$ 3.517.233
1450261	CALCIO	300	$ 3.745	$ 1.123.599	$ -	$ 1.123.599
8297749	LIPASA	90	$12.777	$ 1.149.902	$ -	$ 1.149.902
6844480	aTCRU	100	$ 18.144	$ 1.814.400	$ -	$ 1.814.400
1787753	Anti-HBS	100	$ 27.487	$ 2.748.708	$ -	$ 2.748.708
8577412	ANTI HBC TOTAL	100	$27.487	$2.748.708	$ -	$2.748.708
8257289	GGT	250	$ 2.245	$561.276	$ -	$561.276
21015025	ETIQUETA TERMICA	Unidad	$ 93.604	-	19%	$111.388

6842803	Syphilis TPA	100	$21.546	$ 2.154.600	$-	$2.154.600
6801741	PREALBUMINA	300	$14.860	$ 4.457.916	$-	$4.457.916
8208431	PROTEINAS LCR	90	$ 3.856	$ 347.004	$-	$347.004
8157596	Potasio	250	$ 4.536	$ 1.134.000	$-	$1.134.000
8379034	Sodio	250	$3.448	$ 862.110	$-	$862.110
6844471	Cloruro	250	$ 2.577	$ 644.247	$-	$644.247

3. Propuestas técnica Hematología

DYMIND DH800
1 unidad

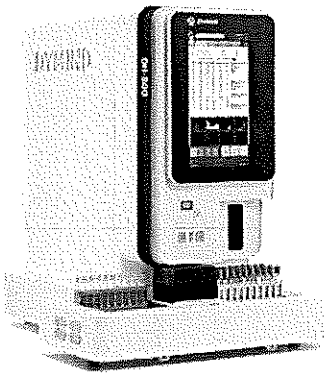

El modelo DH-800 se destaca por su tecnología de inteligencia artificial (AI), permitiendo un diagnóstico automatizado, preciso y eficiente en pruebas de WBC, RBC, PLT, NRBC, RET y fluidos corporales, convirtiéndolo en una solución integral para instituciones que buscan elevar la calidad de sus procesos en el área de hematología.

3.1 Principales ventajas y funciones destacadas:
Avanzada tecnología AI para WBC

- Mejora la precisión en el marcado de blastocitos e IG (granulocitos inmaduros).
- Optimiza el análisis y clasificación diferencial de leucocitos, incluso en muestras complejas

Solución optimizada para RBC

- Inteligente marcación de agregación de eritrocitos.
- Corrección automática de resultados mediante tecnología de baño térmico, reduciendo interferencias por agregación de RBC.

Innovación en análisis de PLT

- El nuevo método de impedancia con flujo de vaina reduce interferencias por microcitos y plaquetas grandes.
- Tecnología exclusiva para desaglomeración de plaquetas, minimizando los errores por agregación.
- Canal especializado PLT-F que elimina interferencias de restos celulares.

La propuesta incluye:

- Mantenimiento preventivo y correctivo
- 1 Kit controles de calidad mensual.
- PC, UPS e Instalación
- Entrenamiento
- Equipos nuevos

3.3. Propuestas económica Hematología DH800

Referencia	Prueba	Presentación	Valor kit
12.01.1907A	D-80 DIL	20L	$273.650
12.01.1936A	D-80LH	1L	$640.742
12.01.1916A	D-80LD	4L	$2.222.575
12.01.1922A	D-80FD	42mL	$1.134.367
12.01.1914A	D-80LN	4L	$1.449.360
12.01.1920A	D-80FN	22mL	$169.150
12.01.1909A	D-80DR	500mL	$184.658
12.01.1989A	D-80FR	12mL	$1.170.245

Precio cuadro hematico: 3.115

3.2 Garantía y soporte

• Todos los equipos y reactivos cumplen con los requerimientos nacionales de registros Sanitarios otorgados por el INVIMA.

• La garantía es de 2 años a partir de la fecha de facturación. No cubre daños producidos por mal manejo del analizador, no ejecución de mantenimiento por parte del usuario, intervención del analizador por personal no autorizado por Biometrika Laboratorio SAS o condiciones de preinstalación erróneas.

• **Capacitación e Instalación:** La capacitación e instalación se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido previamente por Biometrika Laboratorio S.A.S.

• **Servicio postventa y garantía**: Contamos con una línea de soporte técnico científico disponible. La disponibilidad 24/7 aplica sólo para urgencias vitales en clínicas y hospitales que trabajan 24 horas. Línea de Ateción: HELP DESK +57 317 4321900.

Bonificado			
DDC5DPT3H	D-Check 5 DIFF Plus H	3ml	1 MENSUAL
DDC5DPT3L	D-Check 5 DIFF Plus L	3ml	1 MENSUAL
DDC5DPT3N	D-Check 5 DIFF Plus N	3ml	1 MENSUAL
12.01.0046A	CLE-P Cleanser	50 mL	0,5 MENSUAL
DM-RET	DM-RET-LOW	3mLx1	1 MENSUAL
	DM-RET-Middle	3mLx1	1 MENSUAL1
	DM-RET-High	3mLx1	1 MENSUAL

3.2 Garantía y soporte

• Todos los equipos y reactivos cumplen con los requerimientos nacionales de registros Sanitarios otorgados por el INVIMA.


• La garantía es de 2 años a partir de la fecha de facturación. No cubre daños producidos por mal manejo del analizador, no ejecución de mantenimiento por parte del usuario, intervención del analizador por personal no autorizado por Biometrika Laboratorio SAS o condiciones de preinstalación erróneas.

• **Capacitación e Instalación:** La capacitación e instalación se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido previamente por Biometrika Laboratorio S.A.S.

• **Servicio postventa y garantía**: Contamos con una línea de soporte técnico científico disponible. La disponibilidad 24/7 aplica sólo para urgencias vitales en clínicas y hospitales que trabajan 24 horas. Línea de Ateción: HELP DESK +57 317 4321900.

4. Propuestas técnica Coagulación

DYMIND CA1200
1 unidad

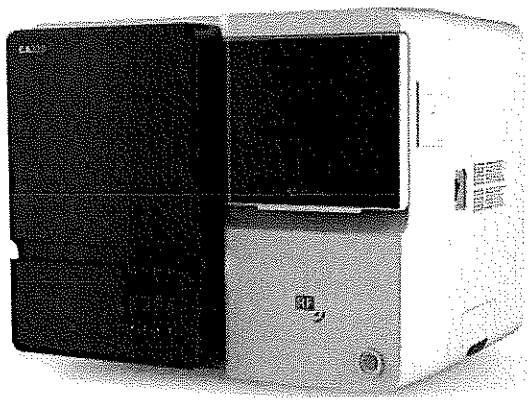


El CA1200 es un analizador automático compacto y robusto, ideal para laboratorios que desean automatizar sus pruebas de hemostasia manteniendo alta precisión, velocidad y eficiencia operativa.

- 4 canales de medición ópticos.
- Capacidad para hasta 30 muestras y 20 reactivos refrigerados.
- Procesamiento de hasta 120 pruebas por hora.
- Tecnología de detección foto-óptica turbidimétrica y cromogénica.
- Interfaz táctil e intuitiva con conectividad LIS/HIS.
- Detección automática de burbujas y control térmico a 37 ± 0.2 °C.
- Carga máxima de muestras: 40 tubos de muestras
- Reactivo a bordo: 23 posiciones de reactivo
- STAT: Apoyar a STAT en cualquier posición de las muestras
- Carga de reacción: 80 tubos de reacción a bordo; acceso continuo automático
- Lavado y limpieza: solución de lavado a bordo
- Estación de trabajo: PC Incorporado
- Pantalla: Pantalla táctil TFT de 10.4 pulgadas La pantalla táctil ajustable y la iluminación interior hacen que su operación sea la más cómoda posible.
- Almacenamiento: Hasta 100.000 registros
- Rendimiento: PT+APTT ≥ 100 Pruebas por hora

4.1 Servicios incluidos sin costo adicional

- Capacitación continua del personal.
- 100% de mantenimientos preventivos.
- Mano de obra de Mantenimientos correctivos y visitas técnicas.
- Soporte técnico remoto 24/7.
- Equipos nuevos
- Equipo back up COAG2D DIAGON Semiautomatizado.

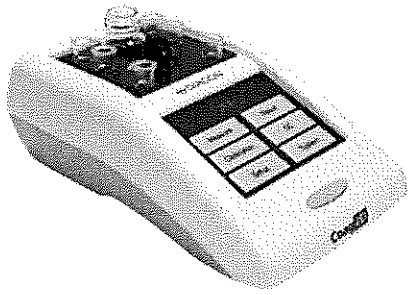

4.2 Beneficios para la institución

- Ahorro de inversión inicial (equipo sin costo de compra).
- Continuidad operativa garantizada (equipo sustituto + soporte inmediato).
- Reactivos de alta calidad con respaldo científico.
- Trazabilidad en resultados, asegurando cumplimiento normativo (CLSI, ISO, INVIMA).
- Alianza estratégica a largo plazo con condiciones flexibles y renovables.

4.3 Garantía y soporte

• Todos nuestros equipos y reactivos cumplen con los requerimientos nacionales de registros Sanitarios otorgados por el INVIMA.
• El analizador BCA1000 contara bajo la modalidad de apoyo tecnológico incluye todos los mantenimientos preventivos y la mano de obra de los mantenimientos correctivos necesarios para garantizar la operación del analizador (sin repuestos).
• **Capacitación e Instalación:** La capacitación e instalación se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido previamente por Biometrika Laboratorio S.A.S.
• **Servicio postventa y garantía:** Contamos con una línea de soporte técnico científico disponible. La disponibilidad 24/7 aplica sólo para urgencias vitales en clínicas y hospitales que trabajan 24 horas. Línea de Atención: HELP DESK +57 317 4321900


4.4. Propuestas económica Coagulación

REFERECIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACION	PRECIO KIT SIN IVA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON INVA
DYM—COA-PT-01	PROTHROMBIN TIME ASSAY	10 fsc x 2 mL	$1.404.907	$ -	$1.404.907
DYM—COA-PTT-01	ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME ASSAY KIT APTT REAGENT	10 fsc x 2 mL	$ 2.965.914	$ -	$ 2.965.914

Bonificado		
DYM—COA-SL-01	CLG-1 (10L)	2 MENSUAL
DYM—COA-SL-02	CLG-2 (30mL)	5 MENSUAL
DYM—COA-CU-01	Optic Cuvvettes	1,7 MENSUAL
DYM—COA-MBC-01	Magnetic Bead Cuvettes (100 pcs)	0,5 MENSUAL
DYM—COA-CTRL-01	CONTROL COAG LEVEL 1	1 Mensual
DYM—COA-CTRL-01	CONTROL COAG LEVEL 2	1 Mensual
DYM—COA-CAL-FIB-01	CAL FIB	1 Mensual
DYM—COA- FIB-01	FIBRINOGENO ASSAY KIT	Depende del uso

5. Propuestas técnica gases arteriales

PT-1000
2 Unidades

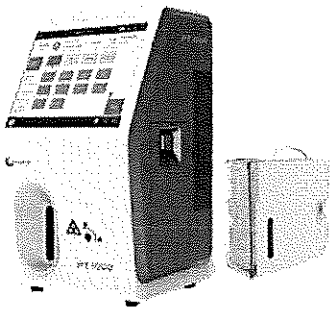

5.1 Características Destacadas del Producto
Cartucho Todo en Uno

- No requiere fluidos en el instrumento, libre de mantenimiento.
- Pack de calibración, solución de limpieza y recolección de residuos biológicos integrado.
- Diseño optimizado del cartucho que minimiza la formación de coágulos.

Alta Eficiencia
- Tecnología revolucionaria de microsensores, 33 parámetros en solo 60 segundos.
- Calibración automática y monitoreo continuo del rendimiento del sistema.
- Impresora incorporada, impresión automática de resultados después de la detección.

Fácil Operación
- Pantalla táctil con indicaciones intuitivas.
- Proceso simple de 4 pasos, fácil de usar.
- Compatible con el protocolo HL7 para integración con LIS/HIS.

Máxima Flexibilidad
- Tamaño compacto adecuado para diversas unidades (UCI, urgencias, quirófano, etc.).
- Asa conveniente para facilitar el transporte.
- Batería incorporada con autonomía de respaldo de 4 horas.

Rendimiento y tipos de muestras
- Tecnología de microsensores, 60 pruebas hora.
- Sangre arterial
- Sangre venosa
- Sangre capilar
- Volumen de muestra: 150 uL

Parámetros:

- Medidos: PH, PCO2, PO2, Na+, K+, Ca++, CL, Glu, Lac, Hct.
- Calculados: cH+, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), HCO3- act, HCO3-std, BB(B), BE(B), BE(ecf), CtCO2, Ca++(7.4), sO2(est), AnGap, tHb(est), pO2(A-a), pO2(A-a) (T), pO2(a/A), pO2(a/A) (T), RI, RI(T), pO2/FIO2, pO2(T)/FIO2.

Otras especificaciones tecnicas:

- Libre de mantenimiento.
- Calibración autónoma.
- Solución de limpieza y compartimento de residuos interno.
- El diseño optimizado del cartucho minimiza la formación de coágulos.
- Tiempo a bordo: Pack de 120 y 200 test 21 días.
- Pack de 300 test 14 días.
- Controles con código QR.
- No necesita filtro
- Temperatura: 10°C -31°C
- Equipos nuevos

5.2 Servicios incluidos sin costo adicional


- Capacitación continua del personal.
- 1 control de calidad interno mensual.
- Mano de obra de Mantenimientos correctivos y visitas técnicas.
- Soporte técnico remoto 24/7.
- UPS

5.1 Lista de reactivos

REFERENCIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACIÓN	PRECIO PRUEBA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON IVA
PT-10-600	REAGENT PACK	600 TEST/KIT	$12.248	$ -	$7.348.524
W-PT10-300	REAGENT PACK	300 TEST/KIT	$12.248	$ -	$3.402.000
BONIFICADOS					
PT-1000 CON	CONTROL DE CALIDAD INTERNO NIVEL 1-2-3	30 UND X 2.5 ML	1 Mensual		
IN 0090	ROLLO TERMICO	Unidad	Dependiendo el uso y la conexión al LIS		

6. Propuestas técnica electrolitos

DIESTRO 103 AP v4
1 Unidades

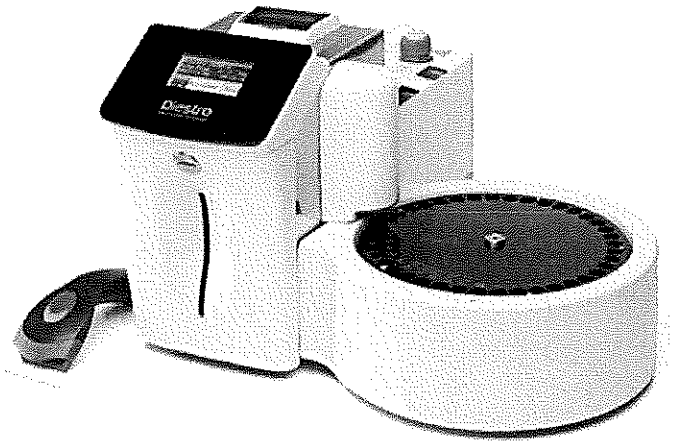

Los analizadores de electrolitos DIESTRO 103 AP v4 representan una solución compacta, robusta y altamente eficiente, diseñada para laboratorios clínicos y hospitales que requieren precisión, velocidad y versatilidad en el análisis de electrolitos. Su diseño modular permite seleccionar el modelo más adecuado en función del volumen de muestras procesadas diariamente, desde entornos con baja carga de trabajo hasta laboratorios de alta productividad.

La propuesta garantiza:

- Precisión clínica con electrodos ISE digitales.
- Escalabilidad desde configuraciones semiautomáticas hasta totalmente automáticas.
- Eficiencia operativa con tiempos de análisis menores de 60 segundos, incluyendo calibración y reporte.
- Optimización de recursos con consumibles de calibración y lavado automáticos.
- Conectividad y trazabilidad gracias a opciones de LIS, USB, código de barras y memoria interna.

6.1 Características destacadas

- Carga de muestra: Automática con detección de nivel.
- Volumen mínimo de muestra: Desde 40 µL.
- Tipos de muestra admitidos: sangre entera, suero, plasma, orina.
- Compatibilidad: jeringa, tubo o capilar con posicionamiento inteligente.
- Velocidad: <60 segundos por muestra (incluye medición, lavado, calibración e impresión).
- Rendimiento: hasta 60 muestras de suero por hora.

- Electrodos: ISE digitales, libres de mantenimiento, expandibles hasta 5 electrolitos (Na+, K+, Cl–, Ca++, Li+).
- Pantalla: gráfica táctil de alta resolución, con guía rápida en pantalla.
- Calibración y lavado: automáticos bajo demanda.
- Memoria: hasta 1000 resultados almacenados.
- Control de calidad: 3 niveles con reportes estadísticos integrados
- Multilenguaje: adaptable a entornos internacionales.

6.2 Especificaciones técnicas:
Reproducibilidad:

- Suero: SD ≤ 0,05 (20 corridas)
- Orina: SD ≤ 0,06 (20 corridas)
- Resolución: 0,01 mmol/L.

Rangos de medición:
- Calcio: 0,2 – 5 mmol/L (suero/sangre).
- Litio: 0,2 – 5 mmol/L (suero/sangre).
- Otros electrolitos: configurables bajo demanda.
- Tiempo real: Reloj integrado para trazabilidad de resultados.

6.3 Beneficios clave
- Ahorro de tiempo: resultados rápidos con mínima intervención del usuario.
- Confiabilidad: Electrodos digitales sin mantenimiento.
- Flexibilidad: desde entornos pequeños hasta hospitales de alta demanda.
- Escalabilidad tecnológica: actualización desde modelos semiautomáticos hasta automáticos.
- Coste eficiente: consumo optimizado de reactivos y estándares.

6.4 Incluye
- Equipo analizador DIESTRO 103 AP v4 nuevo.
- Lector de código de barras
- Mantenimiento correctivo y preventivo
- UPS
- Kit inicial de calibración y lavado.
- Guía rápida en pantalla + manual completo.
- Garantía y soporte técnico especializado.


6.5 Listado de reactivos

REFERECIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACION	PRECIO PRUEBA SIN IVA	PRECIO KIT SIN IVA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON INVA
IN0100	Pack Calibración ISE	800	$5.773	$ 4.618.157	$ -	$ 4.618.157

BONIFICADOS		
IN0750	Diestro Trilevel Control x15 ml	1 Mensual
IN0050	Fill port cleaner	1 Trimestral

7. Propuestas técnica uroanálisis

H500 DIRUI
1 Unidad

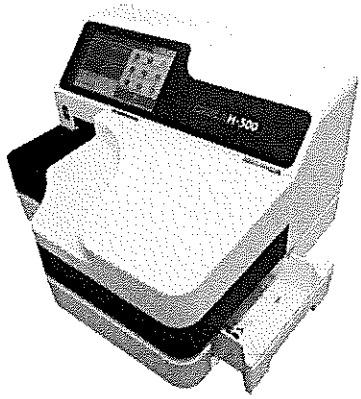

El DIRUI H-500 es un avanzado analizador automático de orina de alta velocidad, diseñado específicamente para laboratorios clínicos que manejan volúmenes medios y altos de muestras. Este equipo utiliza el principio de colorimetría fotoeléctrica para la detección precisa de cambios en las tiras reactivas de orina, lo que le permite realizar análisis rápidos y confiables. Su tecnología avanzada garantiza una excelente precisión en la medición de diversos parámetros, como glucosa, proteínas, pH y densidad, entre otros. Gracias a su diseño automatizado, el DIRUI H-500 no solo mejora la eficiencia operativa del laboratorio, sino que también minimiza el riesgo de errores humanos, permitiendo una gestión más eficiente de las muestras y obteniendo resultados en tiempo récord. Además, su interfaz amigable y sus opciones de personalización lo convierten en una herramienta indispensable para laboratorios clínicos de alta demanda.

7.1 Parámetros analizados

El DIRUI H-500 mide los siguientes parámetros, dependiendo de la tira utilizada:

- Glucosa (GLU)
- Proteína (PRO)
- Bilirrubina (BIL)
- Urobilinógeno (URO)
- Cetonas (KET)
- Sangre (BLO)
- Leucocitos (LEU)
- Nitrito (NIT)
- Densidad específica (SG)
- pH (pH)
- Microalbuminuria (MAU)

7.2 Garantía y soporte


- Todos nuestros equipos y reactivos cumplen con los requerimientos nacionales de registros Sanitarios otorgados por el INVIMA.
- El analizador H-500 es libre de mantenimientos preventivos, el apoyo tecnológico incluye todos los mantenimientos correctivos necesarios para garantizar la operación del analizador (sin repuestos).
- **Capacitación e Instalación:** La capacitación e instalación se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido previamente por Biometrika Laboratorio S.A.S.
- **Servicio postventa y garantía:** Contamos con una línea de soporte técnico científico disponible. La disponibilidad 24/7 aplica sólo para urgencias vitales en clínicas y hospitales que trabajan 24 horas. Línea de Atención: HELP DESK +57 317 4321900

7.3 Listado de reactivos

REFERENCIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACIÓN	PRECIO PRUEBA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON IVA
3000185	Tiras de orina H11	100	$1.524	$ -	$152.365
BONIFICADOS					
3913	Control negativo Dirui orina x 8mL	1 x 8 ml	1 Mensual		
3914	Control positivo Dirui orina x 8mL	1 x 8 ml	1 Mensual		

8. Propuesta técnica Hemoglobina Glicosilada

HB NEXT
1 Unidad

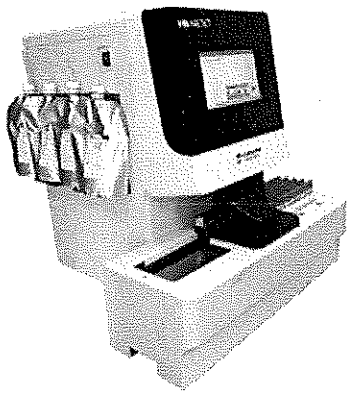

Hb NEXT es el nuevo analizador HPLC de intercambio catiónico en fase inversa diseñado para ofrecer una cuantificación precisa y exacta de HbA1c, HbA2, HbF y las principales variantes de hemoglobina. Basado en más de 35 años de contacto y asistencia diarios con los clientes, Hb NEXT es la respuesta a la necesidad de mayor flexibilidad, productividad y fiabilidad. En UN solo analizador, su laboratorio tiene la posibilidad de elegir libremente entre los DOS modos de análisis disponibles: El modo Variant para medir la HbA1c para la gestión de la Diabetes y el modo Thalassemia para el cribado de hemoglobinopatías. Utilizando la misma columna y todos los recipientes de reactivos instalados, el operador puede cambiar fácilmente de modo de análisis, lo que ofrece a su laboratorio la posibilidad de decidir entre TRES métodos de trabajo diferentes en función de las necesidades.

Reconocimiento automático del tipo de muestra con sólo 2 versiones de gradillas: sangre total/prehemolizada; muestras anémicas Identificación automática de las muestras mediante rotación del tubo y lectura del código de barras

Agitación de muestras por inversión del tubo de muestras Preparación semiautomática de calibradores, controles y muestras prehemolizadas Identificación y trazabilidad de reactivos mediante lectura de códigos QR Resultados trazables al método de referencia IFCC y notificados en unidades IFCC (mmol/mol) y NGSP (%)

8.3 Listado de reactivos y consumibles

REFERENCIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACIÓN	PRECIO PRUEBA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON IVA
55599	Eluyente A	195	$4.320	$ -	$842.400
55600	Eluyente B	1013	$1.361	$ -	$1.378.490
55601	Eluyente C	1162	$583	$ -	$677.678
55603	Solución Hemólisis	268	$7.344	$ -	$1.968.192
BONIFICADOS					
55604	COLUMNA	6000 TEST	Dependiendo del uso		
55605	Hb NEXT HbA1C Control	N/A	Dependiendo el uso		
55606	Hb NEXT HbA1C Calibrador	N/A	Al Cambio de Columna/Filtro		

9 Analizador DS2
1 Unidad



El analizador DS2 es un equipo automatizado de laboratorio clínico diseñado para realizar pruebas inmunoenzimáticas tipo ELISA con alta precisión y eficiencia. Este sistema compacto y completamente automatizado que permite procesar múltiples muestras simultáneamente, reduciendo el error humano y optimizando el tiempo de análisis. Es ideal para laboratorios de tamaño mediano que requieren confiabilidad en el diagnóstico de diversas condiciones médicas, como enfermedades infecciosas, hormonales y autoinmunes. El DS2 cuenta con funciones integradas de control de calidad, manejo de datos y seguimiento del proceso, lo que lo convierte en una herramienta esencial para garantizar resultados consistentes y reproducibles en entornos clínicos exigentes.

9.1 Listado de reactivos y consumibles

BONIFICADOS			
Referencia	**Reactivo/item**	**Presentacion**	**Cantidad al año**
	Deep Well Strips	Caja x250 tiras de 8 pozoz C/U	2
65950	Tubes reagent DSX	Pack de 24	2
62930	Regent Bottles 15 ml	Caja x10	2
157333SP	Sample Vials	50 Unidades	2
157333SP	Sample Caps	50 Unidades	2


MediQSalud


NIT: 900536828-7

65910	Sample Tips	Caja x432	25
65920	Racked Regent Tips	Caja x432 pruebas	10
50200410	L7394 Lamp 6V 20W 280 Lumens	Unidad	1
10495010	401 Cr ⅛ Pies Round Gem Punch	Unidad	1

REFERECIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACION	PRECIO PRUEBA SIN IVA	PRECIO KIT SIN IVA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON INVA
2525-300A	IgE AccuBind	96	$11.398	$ 1.094.181	$ -	$ 1.094.181
3425-300B	NTSH AccuBind	192	$12.654	$ 2.429.599	$ -	$ 2.429.599
BCH192	CHAGAS NATIVO IGG	192	$10.993	$ 2.110.729	$ -	$ 2.110.729
T1020	CHAGAS ELISA IGG+IGM	96	$14.244	$ 1.367.439	$ -	$ 1.367.439
ORG 538	ANAscreen	96	$19.753	$ 1.896.280	$ -	$ 1.896.280
M1018	DENGUE ELISA IGM CAPTURE	96	$20.259	$ 1.944.892	$ -	$ 1.944.892
M1003	Leptospira IgM ELISA	96	$29.921	$ 2.872453	$ -	$ 2.872453
ORG 601	Anti-CCP hs (high sensitive)	96	$ 31.548	$ 3.028.650	$ -	$ 3.028.650
S001	Sorbente Leptospira	92	$6.318	$ 606.528	$ -	$ 606.528

10. AutoSCAN-4 y MicroSCAN TubidityMeter
1 Unidad

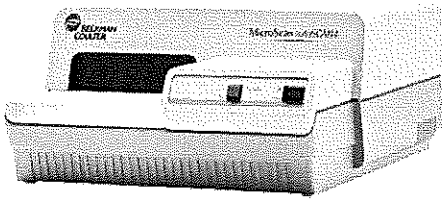



El AutoSCAN-4 es un sistema semiautomatizado utilizado en microbiología clínica para identificar microorganismos patógenos y realizar pruebas de sensibilidad a antimicrobianos, como antibióticos. Este equipo acelera el proceso de diagnóstico al automatizar la inoculación, la lectura de resultados y la interpretación de pruebas, lo que aumenta la precisión y reduce los errores humanos. Utiliza una base de datos extensa de microorganismos y patrones de resistencia, permitiendo una identificación rápida y precisa de infecciones, y ayudando a los médicos a elegir el tratamiento adecuado. Su interfaz amigable y resultados rápidos lo hacen ideal para laboratorios y hospitales.


10.1 Listado de reactivos y consumibles

Referencia	Producto	Presentación	Precio kit sin IVA	IVA	Valor Total
B1016-171	Panel Urin Neg Combo Panel Type	20	$1.222.858	0%	$1.222.858
B1017-70	Microscan Rapid Yeast ID Panel	20	$1.327.952	0%	$1.327.952
C63726	Panel MicroScan Neg MIC 61	20	$1.222.858	0%	$1.222.858
B1016-174	PANEL POSITIVO COMBO 42	20	$1.222.858	0%	$1.222.858
C63727	Panel Negativo Combo 94	20	$1.222.858	0%	$1.222.858
B1015-7	INOCULUM WATER PLURONIC -D	60	$435.973	0%	$435.973
B1015-2	STERILE INOCULUM WATER TUBO	60	$330.746	0%	$330.746
B1013-4	INOCULATORS-D PAC	12	$47.673	19%	$56.731
B1010-40	MINERAL OIL 60ML	90	$98.464	19%	$117.172
B1010-44A	SULFANILIC ACID 30ML	600	$45.977	19%	$71.099

B1010-45A	N-N DIMETHYL ALPHA NAPHTHYLAMINE 30ML	600	$63.095	19%	$75.083
B1010-42A	A-NAPHTHOL 30ML	600	$74.683	19%	$88.873
B1010-43A	POTASSIUM HYDROXIDE 30ML	600	$59.747	19%	$71.099
B1010-41A	KOVACS REAGENT 30ML	500	$87.818	19%	$104.503
B1010-48A	FERRIC CHLORIDE 30ML	600	$63.095	19%	$75.083
B1012-30B	PEPTIDASE REAGENT 30ML	600	$57.943	19%	$68.952
B1010-56B	Cover Trays	12	$202.598	19%	$241.092
B1015-3	NaOH Hidróxido de sodio x 30 ml	600	$133.533	19%	$158.905

11. Propuestas técnica gases arteriales y electrolitos

PRIME CCS COMPLTE
3 Unidades

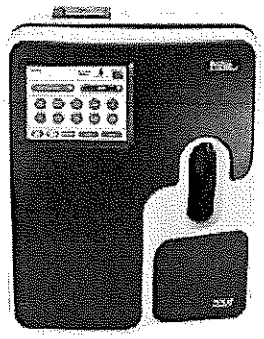

Tecnología avanzada para medición de gases arteriales electrolitos, metabolitos y cooximetría.

Características

- Pantalla táctil
- Lector de códigos de barras de 1 y 2 dimensiones
- Puerto para diferentes tipos de muestra Impresora integrada
- Puerto de seguridad para muestras


Stat Profile Prime combina la revolucionaria microelectrónica del mundo del consumo con la tecnología innovadora de MicroSensor Card™ de Nova Biomedical en un analizador químico simple, pequeño, rápido y costo efectivo, características indispensables en la toma de decisiones en cuidado crítico.

Lista de reactivos

REFERENCIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACIÓN	PRECIO PRUEBA	PRECIO KIT SIN IVA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON IVA
42035	Prime Sensor Card ES Bcomp	440 TEST/KIT	$6.489	$2.399.366	$455.880	$2.855.245
53461	Calibrator Cartridge ES Comp	440 TEST/KIT	$3.184	$ -	$ -	$1.513.037
53469	Calibrator Cartridge CCS COMP	550 TEST/KIT	$8.097	$ -	$ -	$3.742.200
55264	Prime Sensor Card CCS COMP	440 TEST/KIT	$7.026	$2.597.851	$493.592	$3.091.443
BONIFICADOS						
52484	Prime Tubing Harness	Unidad	6 Anual			
42043	Prime Reference Cartridge	Unidad	2 Anual			
5720	Stat Profile Prime Plus Printer Paper ROLLOS	Unidad	400 Anual			
53110	Prime Ampuled Control ES	Unidad	24 Anual			
53455	Prime Auto QC Cartridge CCS 100 Sample	Unidad	12 Anual			
38883	Stat Profile Critical Care Express syringe Clot Catcher NOVA	Caja x200	12 Anual			

12. Propuestas técnica uroanálisis

URIT 560
1 Unidad

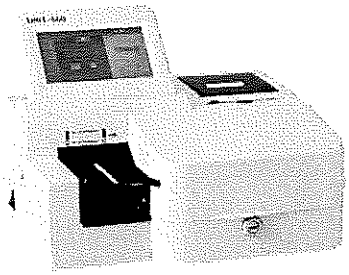

Las tiras reactivas Urit proporcionan pruebas para medición semi-cuantitativa de leucocitos, cetonas, nitritos, urobilinógeno, bilirrubina, proteínas, glucosa, densidad, sangre, pH , ácido ascórbico, creatinina, calcio y microalbumina en orina. Para usar en analizadores de orina Urit- 50, Urit-180, URIT500C , 330 , 31, 560 . La prueba está dirigida para diagnóstico en salud por profesionales.

Características


- Hasta 600P/ H
- Hasta 14parámetros incluyendo Cr, MA, Caf VitC.
- Detectores CIS, resultados más rápidos y precisos.
- Lector de código de barras opcional, pantalla táctil.
- Control URIT UQ-10, UQ-11 y UQ-14 disponible.

Listado de reactivos y consumibles

REFERENCIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACIÓN	PRECIO PRUEBA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON IVA
URIT 11 G	Tira reactiva de orina 11 parametros	100 Tiras	$1.451	$ -	$145.110
BONIFICADOS					
436	Urinalysis Control Level 1	4 viales x 12 mL	10 Anual		
437	Urinalysis Control Level 2	4 viales x 12 mL	10 Anual		
5525	Rollo termico	Unidad	40 Anual		

13. Propuesta técnica inmunología POCT

Biotime
1 Unidad

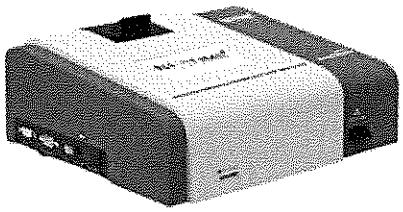

El analizador BIOT-YG-I FIA es un sistema de análisis de inmunoensayo de fluorescencia que puede ayudar a diagnosticar afecciones como enfermedades cardiovasculares, embarazo, infección, diabetes, lesión renal y cáncer, etc. La plataforma BIOT-YG-I proporciona resultados fiables y cuantitativos de varios tipos de analitos en sangre y orina humana en varios minutos. Aplicación: Cardiología, Urgencias, UCI, Respiratorio, Pediatría, Laboratorio, etc.


Características

- Tipo de funcionamiento: Automático
- Aplicaciones: Para diagnóstico clínico
- Método de análisis: De fluorescencia
- Configuración: De mesa, compacto, plataforma
- Otras características: point of care
- Incluye pipeta electronica y pipeta de 5UL

Listado de reactivos y consumibles

REFERENCIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACIÓN	PRECIO PRUEBA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON IVA
BT2106	NT- PRO BNP	25 TEST	$63.302	$ -	$1.582.542
BT2101	Troponina I	25 TEST	$34.399	$ -	$859.964
BT2105	Dimero D	25 TEST	$28.115	$ -	$702.864
W812	CONTROL DIMERO D	3X0.5ML	$-	$ -	$814.050
105-010228-A0	CONTROL PCT low Mindray	1 nivel x 2 ml	$-	$ -	$444.771

14. Propuesta técnica servicio pretransusional

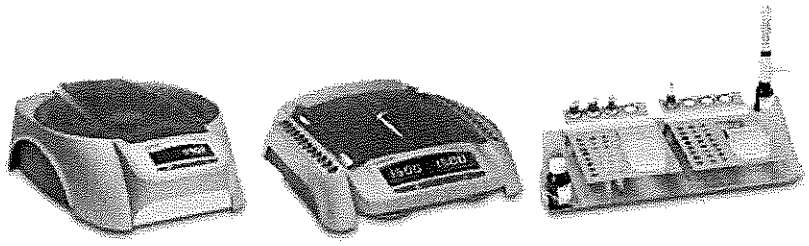

El servicio transfusional es crucial en el sistema de salud, ya que asegura la disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para pacientes que lo necesiten, ya sea por cirugías, traumatismos, enfermedades hematológicas o trastornos metabólicos. La calidad de los equipos utilizados en este servicio es fundamental para garantizar la seguridad, la eficacia y la trazabilidad de las transfusiones, minimizando riesgos como infecciones o reacciones adversas. Además, contar con tecnologías avanzadas y personal capacitado optimiza la gestión de los recursos y mejora los resultados clínicos, salvando vidas y promoviendo una atención de salud más segura y eficiente.


Listado de reactivos y consumibles

Referencia	Poducto	Presentación	Valor Unitario	Valor Total
21033813	DG Gel ABO/Rh (2D)	2x25 tarjetas	$12.119	$605.938
21365913	SERIGRUP DIANA A1/B	2x10 ml	-	$264.715
21035413	DG Gel Sol	2x100 ml	-	$493.235
21020413	SERASCAN DIANA 2	2x10 ml	-	$427.042
21033913	DG Gel Confirm	2x25 tarjetas	$18.679	$933.953
21034213	DG Gel Coombs	2x25 tarjetas	$24.526	$1.226.304
213287-71	ESSENTIAL II CONTROL	2 X 2,6 ml	-	$714.141

Bonificados			
Referencia	Poducto	Presentación	Canlidad Anual
KJ703-2	TUBOS PARA DILUCION	4000	1
T-350-C	PUNTAS PIPETA 5-350	1000	1
TXL-10	PUNTAS PIPETA 0.1-10	1000	1

5. Propuesta técnica hematología

BC 5390
1 Unidad

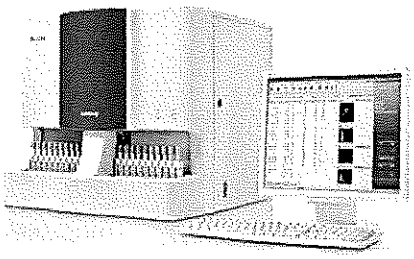

El BC-5390 es un analizador hematológico automático de diferencial leucocitario de 5 partes, diseñado para laboratorios clínicos que requieren un alto desempeño, resultados confiables y una operación eficiente. Este equipo combina tecnología avanzada de análisis celular con un diseño orientado a optimizar el flujo de trabajo del laboratorio, permitiendo obtener resultados rápidos y precisos que contribuyen a un diagnóstico oportuno y a una mejor atención del paciente.

Gracias a su capacidad para realizar un análisis completo del hemograma con diferencial de cinco poblaciones leucocitarias (neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos), el BC-5390 proporciona información hematológica detallada que facilita la identificación de alteraciones relacionadas con enfermedades infecciosas, inflamatorias, hematológicas y otras condiciones clínicas de importancia diagnóstica.

Su rendimiento de 60 muestras por hora le permite ahorrar tiempo, y la capacidad de 40 tubos de carga automática puede extender el tiempo de autonomía

Con diferentes adaptadores de soporte, el analizador admite tres modos de análisis:

- Modo de sangre entera venosa
- Modo prediluido
- Modo de sangre entera capilar.

Adicionalmente, el BC-5390 incorpora un software intuitivo con una interfaz gráfica de fácil manejo que facilita la operación diaria, el almacenamiento y consulta de resultados, la revisión de histogramas y dispersogramas, así como la gestión eficiente de los datos del paciente. El sistema incluye funciones automáticas de control de calidad, mantenimiento programado y monitoreo continuo del estado del equipo, contribuyendo a minimizar errores operativos y a mantener un rendimiento analítico estable.


Listado de reactivos y consumibles

Referencia	Producto	Presentación	Precio kit sin IVA	IVA	Valor Total
105-011736-A0	M-53D Diluent	20 L	$322.234	0%	$322.234
105-011724-A0	M-5 LEO(I) Lyse	1L×4	$2.745.801	0%	$2.745.801
105-011729-A0	M-5 LEO(II) Lyse	500mL×4	$3.430.825	0%	$3.430.825
105-011734-A0	M-53LH Lyse	500mL×4	$2.194.372	0%	$2.194.372

Bonificados			
Referencia	Producto	Presentación	Cantidad Anual
040-001496-A0	SC -CAL PLUS	Unidad	1
040-000018-00	BC-5D	Unidad	12
105-002225-A0	Probe cleanser	Unidad	27

16. Propuesta técnica Quimica

BS 480
1 Unidad

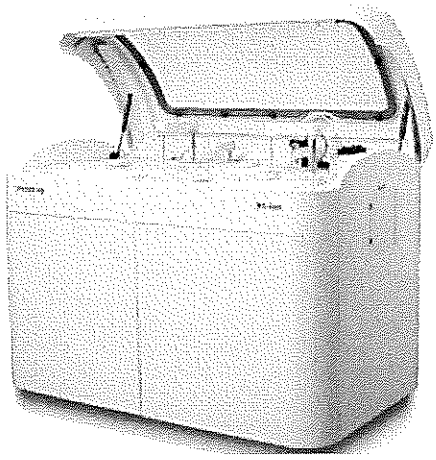

Analizador de bioquímica clínica de piso, de acceso aleatorio que ofrece un rendimiento constante de 400 análisis por hora.

Sistema de líquido mejorado

- Aspiración precisa de muestras y reactivos
- Eliminación de burbujas de aire incorporadas antes del lavado
- Arrastre < 0.05 %
- La tecnología de aplanamiento de punto de luz facilita la reducción del volumen de reacción
- Refrigeración ininterrumpida las 24 horas a 2-10°C
- Indica el volumen de la cubeta: 120~360 µl
- Protección contra colisiones vertical y horizontal
- Recuperación automática del sistema
- Detección del nivel de líquido, detección de coágulos
- Incluye equipo backup y equipo de agua

Listado de reactivos y consumibles

Referencia	Poducto	Presentación	Precio kit sin IVA	IVA	Valor Total
1001065	CALCIO	150	$472.152	0%	$472.152
1001241	TIBC	100	$944.903	0%	$944.903
1001285	MAGNESIO	300	$333.845	0%	$333.845
1102134	TRANSFERRINA	150	$33.792	0%	$33.792
1001155	FOSFORO	300	$548.461	0%	$548.461
105-009168-A0	Total Protein in Urine/CSF	378	$72.430	0%	$72.430
MD41001	ACIDO URICO	720	$965.767	0%	$965.767
MD1001020	ALBUMINA	617	$827.802	0%	$827.802
MD1001291	PROTEINAS TOTALES	720	$965.767	0%	$965.767
MD1001046	BILIRUBIN Total	600	$804.806	0%	$804.806

MD1001047	BILIRUBIN Direct	600	$804.806	0%	$804.806
MD1001111	CREATININA	720	$965.767	0%	$965.767
MD1001117	CREATININA Enzimática	443	$1.022.374	0%	$1.022.374
MD41011	GLUCOSA	720	$965.767	0%	$965.767
MD41041	UREA	600	$804.806	0%	$804.806
MD41264	GOT/AST	600	$804.806	0%	$804.806
MD41274	GPT/ALT	600	$84.806	0%	$84.806
MD41214	LDH	600	$804.806	0%	$804.806
MD41021	COLESTEROL TOTAL	720	$965.767	0%	$965.767
MD41031	TRIGLICERIDOS	720	$965.767	0%	$965.767
MD41201	AMILASA	720	$268.689	0%	$268.689
MD41250	CREATIN QUINASA	600	$804.806	0%	$804.806
MD41254	CK-MB	600	$1.967.304	0%	$1.967.304
MD41233	ALP	600	$849.518	0%	$849.518
1001275	LIPASA	108	$1.461.132	0%	$1.461.132
1001247	HIERRO FERROZINE	450	$532.080	0%	$532.080
1107101	PCR CUANTITATIVA	300	$449.901	0%	$449.901
MD1001096	COLESTEROL HDL	514	$1.149.725	0%	$1.149.725
MD1107170	MICROALBUMINA	600	$1.117.786	0%	$1.117.786
1102094	COMPLEMENTO C3	150	$426.222	0%	$426.222
1102104	COMPLEMENT C4	150	$426.222	0%	$426.222
21015025	ETIQUETA TERMICA	2500	$101.092	19%	$101.092
1001410	AMMONIA. Enzymatic - UV	100	$820.059	0%	$820.059


MediQSalud

NIT: 900536828-7

Bonificados			
Referencia	Producto	Presentación	Cantidad Anual
1002011	SPINTROL H CALIBRADOR	10 x 3 ml	6
428	ADBIO Immunology Control Level 1	4X1ML	27
310	ADBIO Assayed Chemistry Control Level 1	4 x 5 mL	9
315 -	ADBIO Assayed Chemistry Control Level 2	4 x 5 ml	9
1102003	CALIBRADOR GENERAL PROTEINAS	1 x2 ML	1
43105	HbA 1c-d CALIBRATOR Urine	4x0.5 mL	2
376	ADBIO Quantitative Control Level 1	4 viales x 10 mL	3
377	ADBIO Quantitative Urine Control Level 2	4 viales x 10 mL	3
8740B	ADBIO Diabetes Control Bilevel	2 niveles x 3	8
115- 078927-00	BOTELLA DE REACTIVO	20 mL	10
115- 078924-00	BOTELLA DE REACTIVO CORTA	40 mL	10
115- 078923-00	BOTELLA DE REACTIVO LARGA	40 ml	10
115- 078914-00	TAPAS DE BOTELLAS DE REACTIVO	-	30
115- 004016-00	CUBETAS DE REACCION PARA	-	1
801-BA80- 00222-00	20W LAMP(FRU) Yellow	-	3
801-BA38- 00052-00	Water Inlet Filter	-	1
801-BA40- 00288-00	DISHING FILTER	-	1
801-BA80- 00020-00	Water Inlet Filter Unidad	1	2
105- 000107-A0	DETERGENTE CD80	CAJA 6 X 2 LITROS	13
801-0000- 00011-00xP	Cleaning Tool	10pcs, 1pkg	1

17. Propuesta técnica hormonas e infecciosas

MINDRAY CL1000i
1 Unidad

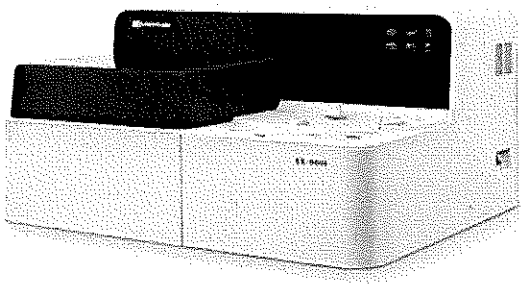

Un analizador de inmunoensayo completamente capaz y robusto con un rendimiento coherente con el CL-2000i, en un tamaño de sobremesa más pequeño y mejor diseñado para laboratorios de tamaño medio y pequeño. Con una capacidad de 180 pruebas por hora, este sistema incluye su gran capacidad de reactivo y muestra, rendimiento fiable e interfaz de operación intuitiva.

- Plataforma SPMP (Partículas micro super paramagnéticas), con capacidad de suspensión alta.
- Reactivos etiquetados con fosfatos alcalinos (ALP) y sustrato AMPPD, método inmunológico de la más alta sensibilidad, para pruebas como TSH, HIV, HBsAg, etc.
- Establece un alto nivel de control de calidad de anticuerpos y antígenos.
- Separación magnética de 4 fases; mezcla entre fases de separación diferentes.
- Mezcla con agitardor vortex sin tocar para solución de reacción sin ninguna contaminación.
- Carga y descarga continuas de las muestras con racks.
- Rack de muestras unificado con adaptador desmontable.
- Información del estado del rack en tiempo real indicada en el número de canal.
- Sistema de muestras de urgencias rápido con prioridad.
- Acceso aleatorio para carga de cubeta sin pausa o detención de 88*2 cubetas en un lote, 200 cubetas por cada bolsa de desechos.
- Indicación en tiempo real del estado de la bolsa de desechos y cubetas.

Listado de reactivos y consumibles

MediQSalud

NIT: 900536828-7

Referencia	Producto	Presentacion	Precio kit sin IVA	IVA	Valor Total
105-004212-A0	TSH 2 X 50	100	$968.749	0%	$968.749
105-004209-A0	FT4 2 X 50	100	$968.749	0%	$968.749
105-004210-A0	T3 2 X 50	100	$968.749	0%	$968.749
105-017089-A0	HCG 2X50	100	$968.749	0%	$968.749
105-004219-A0	PSA TOTAL 2x50	100	$968.749	0%	$968.749
105-004220-A0	FERRITINA 2X50	100	$968.749	0%	$968.749
105-008683-00	Folato 1X50	50	$968.749	0%	$968.749
105-005659-A0	Troponin I (CLIA)	100	$1.937.497	0%	$1.937.497
105-008682-00	Vitamina B12 2X50	100	$1.937.497	0%	$1.937.497
105-008681-00	25-OH-Vitamin D Total 1x50	50	$1.477.846	0%	$1.477.846
105-004208-00	FT3 2 x50	100	$741.013	0%	$741.013
105-004214-00	AFP 2X50	100	$1.140.769	0%	$1.140.769
105-004213-00	CEA 2X50	100	$1.284.236	0%	$1.284.236
105-004215-00	CA125 2x50	100	$1.993.212	0%	$1.993.212
105-010703-00	PCT	100	$3.129.803	0%	$3.129.803
105-008684-00	PTH 2x50	100	$1.547.352	0%	$1.547.352
105-012515-A0	Rubella Virus IgM (CLIA) 2x50	100	$1.547.352	0%	$1.547.352
105-012521-A0	Rubella Virus IgG (CLIA) 2x50	100	$1.498.435	0%	$1.498.435
105-012533-A0	Toxoplasma gondii IgM (CLIA) 2x50	100	$1.498.435	0%	$1.498.435
105-012527-A0	Toxoplasma gondii IgG (CLIA) 2x50	100	$1.498.435	0%	$1.498.435
105-012545-A0	Cytomegalovirus IgM (CLIA) 2x50	100	$1.547.352	0%	$1.547.352
105-012539-A0	Cytomegalovirus IgG (CLIA) 2x50	100	$1.547.352	0%	$1.547.352


105-004234-00	Human Immunodeficiency Virus	100	$1.706.508	0%	$1.706.508
105-004222-A0	FSH 2 x50	100	$872.348	0%	$872.348
105-004223-A0	LH 2x50	100	$872.348	0%	$872.348
105-004224-A0	PROLACTINA 2 x50	100	$872.348	0%	$872.348
105-004211-A0	T4 2 x50	100	$741.013	0%	$741.013
105-004229-A0	Hepatitis B Surface Antigen	100	$1.177.710	0%	$1.177.710

Bonificados		
Referencia	Producto	Cantidad Anual
105-002225-A0	Probe Cleanser (50 ml)	27
105-004552-A0	Wash buffer	70
105-009044-A0	Substrate solution- 75 ml * 4	30
115-035753-00	Reaction Cuvette + Waste bin	4
105-015410-00	Detergente C - Exclusivo para CL-900i	2
05-009143-A0	System Wash Solution	1
105-009141-A0	System Detection Solution	1
105-004276-A0	Sample Diluent - Automatico	6
105-004628-A0	Sample Diluent (manual)	2
105-004281-A0	Calibrador TSH	7
105-004278-A0	Calibrador FT4	5
105-004279-A0	Calibrador T3	5
105-004288-A0	CALIBRADOR PSA TOTAL	5
105-004289-A0	CALIBRADOR FERRITINA	5
105-008552-A0	Calibrador Vitamina B	5
105-008551-A0	Calibrador Folato	5

105-005910-A0	Calibrador Troponina	5
105-008553-A0	Calibrador PTH	5
105-010219-A0	Calibrador Procalcitonina	7
105-010228-A0	PCT Control Procalcitonina (L)	5
105-008554-A0	Metabolic Multi Control (L)	6
105-008555-A0	Metabolic Multi Control (H)	6
105-024834-A0	ToRCH IgG Positive Control	6
105-024842-A0	ToRCH IgM Positive Control	6
105-024826-A0	ToRCH IgG/IgM Negative Control	6
105-001144-A0	Multi Sera - Cal 10×3 mL	1
115-078914-A0	REAGENT BOTTLE CAP	30

18. Propuesta técnica coagulación

Rayto RAC-050
1 Unidad

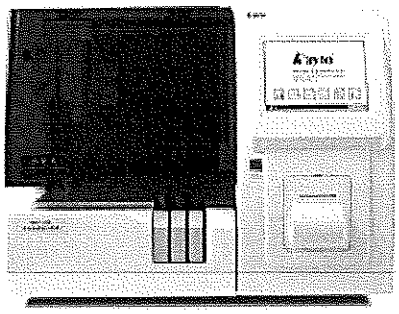

El analizador automatizado Rayto-050 permite realizar pruebas de coagulación de forma eficiente y precisa. Excelente para laboratorios de alto y medio volumen de pruebas.

Características

- Hasta 60 pruebas por hora de TP
- Diseño compacto en un equipo inteligente
- Parámetros de medición: TP, TPT, TT, Fibrinógeno, Antitrombina III, Dímero-D y PDF (Productos de degradación de fibrina)
- Métodos de medición: coagulación, cromogénico e inmunológico
- 7 canales de detección
- 27 posiciones de muestras y 23 posiciones de reactivos
- Pantalla touch con interfaz fácil y simple de operar
- Alto rendimiento en obtener resultados de exámenes


Listado de reactivos y consumibles

Referencia	Producto	Presentación	Precio kit sin IVA	IVA	Valor Total
10445705	INNOVIN	10 x 4 ml	$2.134.858	0%	$2.134.858
10445713	ACTIN FSL	10 x 2 ml	$2.666.396	0%	$2.666.396
10445718	Fibrinogen - Hemo - RGT	6 x 1 ml	$1.187.182	0%	$1.187.182
7408	ADBIO Coagulation Control Bilevel	2 niv x 12vial x 1 mL	$1.218.725	0%	$1.218.725

Bonificados		
Referencia	Producto	Cantidad Anual
1-6-076-031-00	Sample Cup x 500	1
1-6-076-032-10	Cuvette x 1000	14
10446232	Calcium Chloride 25 mM - Hemo - CONS 10 x 15 ml	3

18.1 Equipo Backup

ANALIZADOR START MAX
1 Unidad

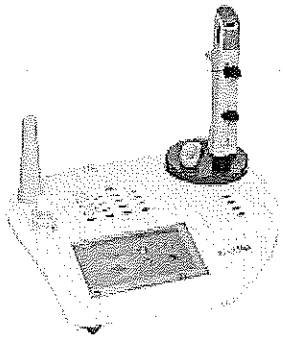


- Instrumento semi-automatizado de sobre mesa completa para el campo de la hemostasia.
- Una solución MAX de hemostasia para un espacio pequeño.
- Amplio panel de pruebas, cubriendo rutina y especiales.
- Máxima estandarización de los resultados.
- Trazabilidad ampliada para mejorar el cumplimiento normativo.

Listado de reactivos y consumibles

Referencia	Producto	Presentación	Precio kit sin IVA	IVA	Valor Total
10446232	Calcium chloride 25nm	150	$282.290	0%	$282.290
B025E x 700	B025E STA -4 Cuvett x 700	700	$835.321	19%	$835.321
38052	Fintips Star 4	100	$4.169.824	19%	$4.169.824
86553	COMBITIPS - Start Max	100	$4.058.002	19%	$4.058.002

19. Propuesta técnica renovación tecnologica microbiologia

VITEK® COMPACT PRO
1 Unidad

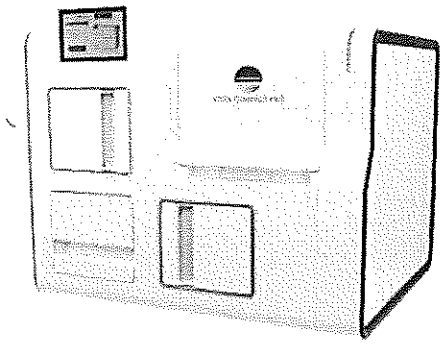

Características

- Preparación de muestras sencilla y estandarizada.
- Pasos totalmente trazables para un flujo de trabajo más sencillo y fiable.
- Interfaz de usuario intuitiva con pasos del flujo de trabajo detallados e ilustraciones.
- Carga y procesamiento de casetes más rápidos en hasta un 20 % menos de tiempo.
- El tiempo de manipulación más breve de todos, con un 40-50 % menos de pasos de flujo de trabajo.
- Resultados de AST sistemático en solo 6-8 horas, con resultados preliminares para informar a los profesionales clínicos más pronto.
- Resultados de sensibilidad y detección de mecanismos de resistencia de gran precisión.
- Transferencia automática de los resultados validados de ID y AST en el sistema de información de laboratorio (SIL).
- Concentración inhibidora mínima (CMI) precisa que cumple con los estándares de EUCAST/CLSI o FDA.

MediQSalud

NIT: 900536828-7

Listado de reactivos y consumibles

REFERECIA	PRUEBA/ITEM	PRESENTACION	PRECIO PRUEBA SIN IVA	PRECIO KIT SIN IVA	VALOR IVA	PRECIO KIT CON INVA
21342	GP TEST KIT VTK2	20	$49.235	$984.709	$ -	$984.709
423646	AST-P663 TEST KITS	20	$49.910	$998.206	$ -	$998.206
421040	AST-ST03 TEST KIT	20	$49.235	$984.709	$ -	$984.709
21341	GN TEST KIT VTK2	20	$49.235	$984.709	$ -	$984.709
423643	AST N401 TEST KIT	20	$49.349	$986.980	$ -	$986.980
423645	AST-N403 TEST KIT	20	$51.310	$1.026.191	$ -	$1.026.191
423644	AST-N402 TEST KIT	20	$51.224	$1.024.479	$ -	$1.024.479
21343	YST TEST KIT VTK2	20	$51.236	$1.024.718	$ -	$1.024.718
420739	AST-YS08 TEST KIT	20	$4.935	$984.709	$ -	$984.709
21347	ANC TEST KIT VTK2	20	$49.235	$984.709	$ -	$984.709
21346	NH TEST KIT VTK2	20	$49.235	$984.709	$ -	$984.709
V1204	SALINE SOLUTION 3X500ML	1	-	$805.488	$165.268	$1.035.213
21219	ACCESSORY KIT VTK2 PIP/DIL	1	-	$1.307.756	$248.474	$1.556.229
69285	UNSENSITIZED TUBES 1X2000	2000	-	$1.404.028	$288.107	$1.804.457

20. Condiciones comerciales

Plazo entrega de equipos: Si el equipo se encuentra disponible se realizará la entrega a los 20 días siguientes a la firma del contrato. De lo contrario, el tiempo será de 90 días por trámite de importación.

Contrato:
Las condciones de la presente propuesta se basan en un contrato de comodato para el cambio y renovación de tecnología de punta, con una duración mínima de cinco (5) años. Adicionalmente, se suscribirá anualmente un contrato de suministro de reactivos e insumos necesarios para el funcionamiento del equipo entregado en comodato, conforme a las condiciones que se acuerden con el hospital.

Forma de pago: crédito 30 días.

Vigencia de la oferta: 30 Días

Servicio de ingeniería: se prestará un servicio de ingeniería de mantenimiento preventivo y correctivo, según la necesidad del laboratorio durante los años en el que se ejecute el contrato.

Se reconocerá sin costo las partes defectuosas por fabricación de los equipos, que sean detectadas por el servicio técnico de ingenieros. Los daños ocasionados por variación de corriente alta, sin estabilizadores electrónicos, eventos adversos externos (Terremoto, Tormenta Eléctrica, Inundaciones, entre otros) o por maltrato del equipo (dejarlo caer al suelo, o regar en su parte interna o externa ácidos corrosivos, etc.), serán cubiertos por la institución. Se prestará servicio de asesoría continua por parte del Bacteriólogo Asesor de cada casa comercial, con entrenamiento de los equipos y apoyo continuo. Los precios de los reactivos y consumibles estarán vigentes hasta diciembre 31 de 2025, siempre y cuando la TRM no supere un aumento del 10%, en este caso se hará necesario reevaluar los precios, de lo contrario los precios se actualizarán anualmente, teniendo en cuenta el IPC y la TRM.

Cualquier inquietud o información adicional, con gusto le estaremos atendiendo.

Cordialmente,

CLAUDIA SIERRA PINILLA GERENTE
HEALTH INTEGRATED SERVICES
S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **40.041.569**

SIERRA PINILLA

APELLIDOS

CLAUDIA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **17-OCT-1976**

TOGUI
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-ABR-1995 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0728200-00632878-F-0040041569-20141018 **00405**19102A 2 30141902

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de julio de 2026, a las 14:01:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	40041569
Código de Verificación	4004156926072914012 8

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300284236

PIB
14:04:20

Bogotá DC, 29 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CLAUDIA SIERRA PINILLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 40041569:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES LEY 2455 / 2025 "LEY ÁNGEL"

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:14:15 PM horas del 29/07/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **40041569**
Apellidos y Nombres: **SIERRA PINILLA CLAUDIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas

Volver al Inicio

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Portal Único de Contratación GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

9mm

(https://www.policia.gov.co

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/07/2026 02:06:33 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº, **40041569** y Nombre: **CLAUDIA SIERRA PINILLA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **144784020** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

4mm

4mm

Nueva Busqueda | Imprimir

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 40041569 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 29/07/2026 02:38 PM

Código Verificación: **U7J4QV1W2L**

Válida hasta: **27/10/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 14:26:45 horas del 29/07/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **40041569,** Apellidos y Nombres **SIERRA PINILLA CLAUDIA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **Heiser**, con NIT **900913246-8** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300299540

PIB
16:28:25

Bogotá DC, 29 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES S.A.S. identificado(a) con NIT número 9009132468:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de julio de 2026, a las 16:30:31, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9009132468
Código de Verificación	9009132468260729163031

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Función Pública

PUBLICACIÓN PROACTIVA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS
(Ley 2013 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)

Tipo de declaración	PERIÓDICO	Fecha de publicación	2026-08-03 14:19

Razón social

HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS - HEISER SAS

NIT

900913246 DV 8

Lugar de ubicación

País COLOMBIA Departamento BOYACÁ Municipio TUNJA

Clase de entidad

Sociedad comercial e instituciones financieras

Si es otra, cual?

Actúa en carácter de Representante Legal Sí [X] No [ ]

Servicios de la entidad:

La sociedad tendrá como objeto principal: comercialización, distribución y venta de equipos médicos, reactivos y elementos diagnósticos, insumos y materiales médicos quirúrgicos así como material de osteosíntesis y equipos biomédicos, en general toda clase de productos, bienes y servicios necesarios para el desarrollo del objeto de la sociedad.

Nombres y apellidos completos del representante legal

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido
CLAUDIA		SIERRA	PINILLA

Documento de identificación del representante legal

Tipo CEDULA DE CIUDADANIA Número 40041569

Lugar de nacimiento del representante legal

País COLOMBIA Departamento BOYACÁ Municipio TOGÜÍ

Lugar de domicilio del representante legal

País COLOMBIA Departamento BOYACÁ Municipio TUNJA

Nombre de la entidad/organismo/institución/persona jurídica pública o privada que presten función pública o servicios públicos o que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos/Notarías/Curadurías/ u otra donde trabaje	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA

Lugar de sede

País	COLOMBIA	Departamento	BOYACÁ	Municipio	MONIQUIRÁ

Dirección	["Calle 19 No. 8-108"]
Cargo o función que cumple	CONTRATISTA

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y jurídica, pública o privada, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.

1. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 2013 DE 2019, A CONTINUACIÓN RELACIONO LOS BIENES Y RENTAS DEL ÚLTIMO AÑO GRAVABLE DE HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS.

1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACREENCIAS

Los ingresos y rentas que obtuvo HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS en el año gravable 2025 fueron:

CONCEPTO	VALOR
Ingresos por la actividad ordinaria - operacionales	$9.425.903.230,00
Ingresos no operacionales	$462.790.446,00
Otros	
TOTAL	$9.888.693.676,00

Las cuentas bancarias de HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS en Colombia y en el exterior son:

Tipo de cuenta	Sede de la cuenta (País)	Saldo total de la cuenta a diciembre 31 del año inmediatamente anterior
CUENTA DE AHORROS	COLOMBIA	$230.164.203,71

Los bienes patrimoniales de HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS son los siguientes:

Tipo de bien	País	Departamento	Municipio	Valor
INMUEBLES	COLOMBIA	BOYACÁ	TUNJA	$2.358.382.641,00
MUEBLES	COLOMBIA	BOYACÁ	TUNJA	$749.303.900,00

Las acreencias y obligaciones vigentes de HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS a la fecha son:

Concepto	Saldo
ACREENCIAS	$826.652.673,00
OBLIGACIONES	$1.602.264.873,00

2. CONFLICTOS DE INTERÉS

A continuación, procedo a publicar y divulgar proactivamente la información que, en mi calidad de representante legal de HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS, es susceptible de generar un posible conflicto de interés a esta persona jurídica, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019 y conforme con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

2.1. POSIBLES CONFLICTOS POR RELACIONES QUE TIENEN LA PERSONA JURÍDICA O EL REPRESENTANTE LEGAL.

¿Es usted representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios de algún servidor público que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos?

Sí [ ] No [X]

Descripción del posible conflicto de interés porque usted es representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios de algún servidor público que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos:

¿La persona jurídica que usted representa tiene litigio o controversia ante autoridades administrativas, jurisdiccionales o denuncias penales con la entidad con la cual HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos?

Sí [ ] No [X]

Descripción del posible conflicto de interés porque la persona jurídica que usted representa tiene litigio o controversia ante autoridades administrativas, jurisdiccionales o denuncias penales con la entidad con la cual HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos:

¿Existe enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre usted y el servidor público que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos?

Sí [ ] No [X]

Descripción del posible conflicto de interés porque existe enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre usted y el servidor público que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos:

2.2. DONACIONES QUE REPRESENTARON REDUCCIONES EN LA DECLARACIÓN DE RENTA

¿HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS realizó donaciones?

Sí [ ] No [X]

Las donaciones realizadas por HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS que le representaron reducciones en la declaración de renta en el último año y los nombres de las instituciones a las cuales hizo esas donaciones son:

Nombre entidad	Valor

2.3. POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS

HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS, o yo, en mi calidad de su representante legal, tenemos otro(s) potencial(es) conflicto(s) de interés:

Sí [ ] No [X]

Los conflictos de interés pueden generarse a partir de, por ejemplo:
> Actividades y negocios que realiza o tiene con socio o socios de hecho o de derecho.
> Establecimientos que posee.
> Litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales.
> Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular.

Los potenciales conflictos personales de interés son:

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

LISTA DE CONTRATOS DEL PROVEEDOR CON EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO

Diligencie este formato, guárdelo en formato PDF y cárguelo al SECOP II siguiendo los pasos explicados en el "Manual de Proveedores para el uso del SECOP II".

Código del clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas	Objeto del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor	Contratista (singular o plural)	Contratante (sector público o privado)	Datos de contacto del área de la Entidad Estatal encargada del supervisión del contrato
42201806	COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA ARCO EN C PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	16/08/2024	15/11/2024	$310.590.000	HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
41100000	CONTRATAR A TÍTULO DE COMODATO DIFERENTES EQUIPOS PARA APOYO TECNOLÓGICO EN EL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	20/11/2024	31/12/2024	$536.519.997	HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS	HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA ESE	ARMANDO TIBADUIZA VARGAS
41100000	CONTRATAR A TÍTULO DE COMODATO DIFERENTES EQUIPOS PARA APOYO TECNOLÓGICO EN EL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	14/01/2025	14/02/2025	$300.000.000	HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS	HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA ESE	ARMANDO TIBADUIZA VARGAS
41116100	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	12/02/2025	30/06/2025	$150.000.000	HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS	HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA ESE	ARMANDO TIBADUIZA VARGAS
41100000	COMODATO DE EQUIPOS PARA APOYO TECNOLÓGICO EN EL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	09/04/2025	31/12/2025	$1.125..000.000	HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS	HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA ESE	ARMANDO TIBADUIZA VARGAS
41116100	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	16/10/2025	31/12/2025	$104.000.000	HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS	HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA ESE	ARMANDO TIBADUIZA VARGAS
41100000	COMODATO DE EQUIPOS PARA APOYO TECNOLÓGICO EN EL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	25/02/2026	30/05/2026	1.000.000.000	HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS	HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA ESE	ARMANDO TIBADUIZA VARGAS
41100000	COMODATO DE EQUIPOS PARA APOYO TECNOLÓGICO EN EL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	29/04/2026	29/04/2029		HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS	HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA ESE	ARMANDO TIBADUIZA VARGAS

LISTA DE CONTRATOS DEL PROVEEDOR CON EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO

41116100	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	30/01/2026	31/07/2026	100.000.000	HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES SAS	HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA ESE	ARMANDO TIBADUIZA VARGAS

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 23/06/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES S A S** con **NIT 900.913.246-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 108900376550

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-900913246
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-10
FECHA DE PAGO:	2026-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37851952
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37851952
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 192.000
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.000	$ 652.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.000	$ 312.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.400	$ 78.400
Subtotal Salud		4	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.234.400	$ 1.234.400
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.600	$ 681.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 400.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.000	$ 304.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.016.000	$ 2.016.000
Subtotal Pensión		4	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.401.600	$ 3.401.600
14-11	890903790	ARL SURA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.800	$ 322.800
Subtotal ARL		1	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.800	$ 322.800
CCF10	891800213	COMFABOY	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.234.400	$ 1.234.400
Subtotal CCF		1	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.234.400	$ 1.234.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.193.200	$ 6.193.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/08/2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165232787

(415)7707212489984(8020) 000014116523278 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 1 3 2 4 6	8	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	HEISER S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
AV UNIVERSITARIA 75 A 00 BL L LC 3 B

42. Correo electrónico contabilidad@heiser.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 3 5 3 1 4 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	2 0 2 3 0 8 0 1	4 6 4 5	2 0 2 3 0 8 0 1	8 6 2 1	7 0 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1		
		58. CPC	9 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-02-28 / 05:30:05PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SIERRA PINILLA CLAUDIA

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165232787

(415)7707212489984(8020) 000014116523278 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 1 3 2 4 6	8	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 1 1 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 1 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 3 8 1 9 5	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 1 1 1 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 1 1 2 7		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165232787

(415)7707212489984(8020) 000014116523278 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 1 3 2 4 6	8	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 2 5			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 0 4 1 5 6 9			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
SIERRA	PINILLA	CLAUDIA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 2 0 1			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 0 1 1 8 7 4			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
GUTIERREZ	PEÑUELA	AURA	SOFIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165232787

(415)7707212489984(8020) 000014116523278 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 1 3 2 4 6	8	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 6 0 4 1 0 9	6	1 6 9 2 8 3

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
NEIRA	CAMARGO	NELSON	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 1 0 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ BOYACÁ E.S.E.

Hospital Regional de Moniquirá E.S.E

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)

CLASE CLIENTE	EMPLEADOR		PROVEEDOR	X
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	30 (DÍA)	07 (MES)	2026 (AÑO)	

1. INFORMACIÓN GENERAL

PERSONA NATURAL

NOMBRES		APELLIDOS			
IDENTIFICACIÓN	TIPO	C.C.	C.E.	T.I.	FECHA DE EXPEDICIÓN
NUMERO		LUGAR DE EXPEDICION			
LUGAR DE NECIMIENTO		FECHA DE NACIMIENTO			

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	CIUDAD	TELEFONO MOVIL	TELEFONO FIJO

ACTIVIDAD

ASALARIADO | INDEPENDIENTE | ESTUDIANTE | SOCIO | PENSIONADO

CÓDIGO ACTIVIDAD "CIIU"		e-mail

Ocupación/Profesión	Nombre de la empresa donde trabaja	Cargo que desempeña

Dirección Empresa	Ciudad	Teléfono	e-mail

PERSONA JURÍDICA

Razón Social		Nit:
HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES S.A.S		900.913.246-8

Dirección Oficina Principal	Ciudad	Teléfono	Fax
Avenida Universitaria No 75ª – 00 BL L LC 3B	TUNJA	3107353148	

Dirección Sucursal o Agencia	Ciudad	Teléfono	Fax
Avenida Universitaria No 75ª – 00 BL L LC 3B	TUNJA	310735148	

Tipo de Empresa: Pública [ ] Privada [X] Mixta [ ] Inversion Extranjera [ ] Otra. Cual? [ ]

Código Actividad "CIIU": 4659 / 4645

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTAMENTE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN (EN CASO DE REQUERIR MAS ESPACIO DEBE ANEXAR RELACIÓN)

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NUMERO
	C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] NIT [ ]	
	C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] NIT [ ]	
	C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] NIT [ ]	
	C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] NIT [ ]	

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

TOTAL ACTIVOS	$ 5.106.129.266	TOTAL PASIVOS	$ 2.428.917.546
INGRESOS MENSUALES	$ 785.491.935	OTROS INGRESOS	$ 462.790.446
CONCEPTO DE LOS INGRESOS	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA		
EGRESOS MENSUALES	$ 658.982.797	OTROS EGRESOS	
CONCEPTO DE LOS INGRESOS	DESECUENTOS COMERCIALES		

4. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Realiza transacciones en moneda Extranjera? Si [ ] No [X]

Tipo de Transacción: Importación [ ] Exportación [ ] Inversiones [ ] Prestamos [ ] Transferencias [ ]

Otros [ ] Cual? [ ]

Tipo de Producto	Identificación	Entidad	Monto	Ciudad	País	Moneda

5. PERSONAS PEP's

¿Por su cargo maneja recursos Publicos?	SI ☐	NO ☑		
¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general?	SI ☐	NO ☑		
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?	SI ☐	NO ☑	Indique	
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?	SI ☐	NO ☑	Indique	
¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?	SI ☐	NO ☑		

6. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACION CONSULTA CENTRALES DE RIESGO

Declaro Expresamente que:

1. Los recursos que Poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupacion, oficio, actividad, negocio, etc)
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA (COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO Y EQUIPOS MEDICOS)

2. Tanto mi actividad, profesion u oficio es licita y la ejerzo dentro del Marco Legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilicitas de las contempladas en el Codigo Penal Colombiano.

3. La informacion que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me obligo a actualizarla anualmente.

4. De manera irrevocable autorizo al HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA, para solicitar, consultar, procesar, suministrar, reportar o divulgar a cualquier entidad con la que mantenga relación comercial vigente ó que se encuentre debidamente autorizada para administrar o manejar base de datos, incluidas las entidades gubernamentales, la informacion contenida en este formulario.

5. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiacion del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

7. INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD	SUCURSAL Y TELEFONO	TIPO DE CUENTA	CUENTA NUMERO
DAVIVIENDA	TUNJA	AHORROS	108900376550


8. FIRMA Y HUELLA

Como constancia de haber leido, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el siguiente documento:

Firma del Representante Legal del proveedor ó Empleado



Huella

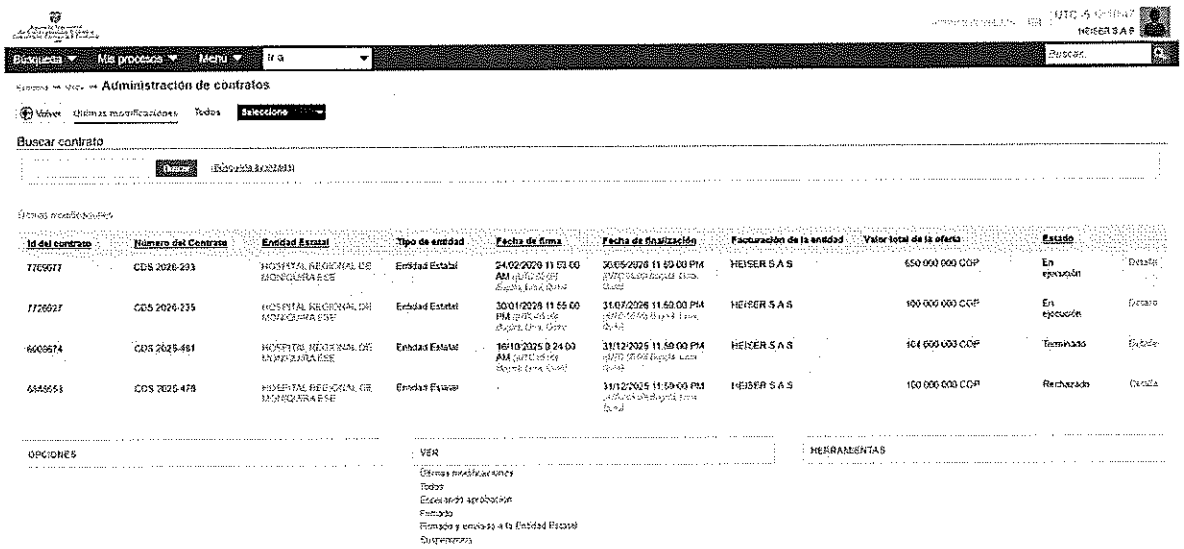

HEISER S A S

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Administración de contratos

Volver | Últimas modificaciones | Todos | Seleccione

Buscar contrato

Buscar | Búsqueda avanzada

Últimas modificaciones

Id del contrato	Número del Contrato	Entidad Estatal	Tipo de entidad	Fecha de firma	Fecha de finalización	Facturación de la entidad	Valor total de la oferta	Estado	
7769677	CDS 2026-293	HOSPITAL REGIONAL DE MONTELIBANO ESE	Entidad Estatal	24/02/2026 11:59:00 AM	30/05/2026 11:59:00 PM	HEISER S A S	650 000 000 COP	En ejecución	Detalle
7726027	CDS 2026-235	HOSPITAL REGIONAL DE MONTELIBANO ESE	Entidad Estatal	30/01/2026 11:55:00 PM	31/07/2026 11:50:00 PM	HEISER S A S	100 000 000 COP	En ejecución	Detalle
6009674	CDS 2025-461	HOSPITAL REGIONAL DE MONTELIBANO ESE	Entidad Estatal	16/10/2025 8:24:00 AM	31/12/2025 11:59:00 PM	HEISER S A S	104 000 000 COP	Terminado	Detalle
6545653	CDS 2025-478	HOSPITAL REGIONAL DE MONTELIBANO ESE	Entidad Estatal	-	31/12/2025 11:59:00 PM	HEISER S A S	100 000 000 COP	Rechazado	Detalle

OPCIONES

VER

Últimas modificaciones
Todos
Esperando aprobación
Firmado
Firmado y enviado a la Entidad Estatal
Suspendido

HERRAMIENTAS