SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

PROCESO DIRECCION DE INTEGRACION TERRITORIAL

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A EJECUCION DE PROYECTOS DE DOTACION HOSPITALARIA EN LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO			
E.S.E o Prestador verificado	ESE POPAYAN	N° de Convenio	2515-2025
Objeto del convenio:	OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ELFORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DE MARÍA OCCIDENTE		
UAS sujeta a verificacion	UAS MARIA OCCIDENTE		

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Se realiza visita de verificacion a la ejecucion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2515-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E POPAYAN. Con el objetivo de validar que la dotacion adquirida sea acorde a los lineamientos técnicos y la operación de la dotación y sus especificacines mínimas técnicas establecidas en el convenio, destinado para la UAS MARIA OCCIDENTE .

VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS DE DOTACION HOSPITALARIA

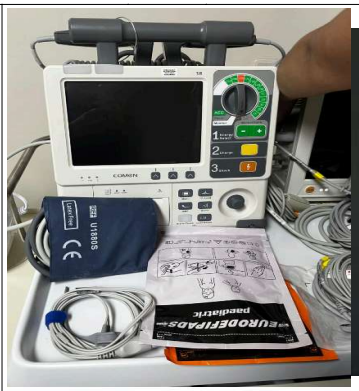
1. EVALUACION DE DOTACION HOSPITALARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	SERVICIO - UBICACIÓN	NOMBRE DE LA DOTACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO - OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	ATENCION DEL PARTO- SALA DE PARTOS	ASPIRADOR DE SECRECIONES	1. Capacidad botella plástica de minimo 1000 ml 2. Máximo Vacio: 600 mmHg 3. Con regulador de presión o vacio o flujo 4. Voltaje 110 V +/- 10 %, 60 Hz. 5. Accesorios: botella, filtro hidrofobico y mangueras. 6. Nivel de ruido de 65 +/- 5 dB 7. Velocidad de flujo: Hasta 40 L/min	GMD	ADS 100	20241227300285	FUNCIONANDO	 
2	HOSPITALIZACION ADULTOS	ASPIRADOR DE SECRECIONES		GMD	ADS 100	20241227300286	FUNCIONANDO	 
3	ATENCION PARTO- SALA DE RECUPERACION	ASPIRADOR DE SECRECIONES		GMD	ADS 100	20241227300287	FUNCIONANDO	 

4	URGENCIAS- SALA DE OBSERVACION	ASPIRADOR DE SECRECIONES		GMD	ADS 100	20241227300288	FUNCIONANDO	 
5	URGENCIAS- SALA DE OBSERVACION	ASPIRADOR DE SECRECIONES		GMD	ADS 100	20241227301149	FUNCIONANDO	 
6	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	ASPIRADOR DE SECRECIONES		GMD	ADS 100	20241227301150	FUNCIONANDO	 
7	URGENCIAS - SALA DE PROCEDIMIENTOS	ASPIRADOR DE SECRECIONES		GMD	ADS 100	20241227301151	FUNCIONANDO	 
8	HOSPITALIZACION ADULTO	ASPIRADOR DE SECRECIONES		GMD	ADS 100	20241227301152	FUNCIONANDO	 
9	URGENCIAS-SALA DE REANIMACION	ASPIRADOR DE SECRECIONES		GMD	ADS 100	20241227300201	FUNCIONANDO	 


10	URGENCIAS- TRIAGE	BASCULA DE PISO GRADO MEDICO	1. Pantalla digital para visualización del peso. 2. Capacidad de 0 a 180 kg (400 libras) o mayor. 3. División de escala o resolución de 100 gramos o menor. 4. Funciones: conversión de lb/kg, puesta a cero/ tara, apagado automático. 7. El equipo debe contar con alimentación eléctrica por adaptador de voltaje a 115V +/- 5%, 8,0Hz y con alimentación por baterías 8. Plataforma para pesaje amplia y en material resistente.	HEALTH O METER	349KLX	350522381645	FUNCIONANDO		
11	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	BASCULA DE PISO GRADO MEDICO		HEALTH O METER	349KLX	3500080620	FUNCIONANDO		
12	HOSPITALIZACION ADULTO	BASCULA DE PISO GRADO MEDICO		HEALTH O METER	349KLX	350272483004	FUNCIONANDO		
13	HOSPITALIZACION ADULTO	BASCULA DE PISO GRADO MEDICO		HEALTH O METER	349KLX	350172482664	FUNCIONANDO		
14	HOSPITALIZACION ADULTO	BOMBA DE INFUSION	1. Bomba de infusión de 1 Canal como mínimo. 2. Campo K.V.O (función mantenimiento vena) entre 0,1 ml/h a 5ml/h. 3. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz. 4. Alarma por oclusión, aire en línea, puerta abierta y error de goteo como mínimo. 5. Velocidad de infusión: 0,1 a 600ml /h o mayor. 6. Rango de flujo (volumen total) de 0 a 9999 ml o mayor 7. Modos de infusión: Tasa, volumen y peso como mínimo 8. Pantalla LCD o TFT Color 9. Batería Recargable de Litio, con autonomía mínima de 4 horas 10. Bolo dentro del rango de 0,2 ml/h a 1200 ml/h 11. Purga de 400 ml/h o mayor 12. Compatible con varios set de infusión. 13. Interfaz de conexión por puerto USB y/o RS-232 14. Precisión: máxima del 5% 15. Biblioteca de fármacos.	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6102405000219	FUNCIONANDO		

15	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	BOMBA DE INFUSION	10. Biblioteca de farmacos.	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6102405000379	FUNCIONANDO	 
16	HOSPITALIZACION ADULTOS	BOMBA DE INFUSION		MEDCAPTAIN	SYS 6010	6102405000592	FUNCIONANDO	 
17	URGENCIAS- REANIMACION	DESFIBRILADOR	1. Desfibrilador /Monitor 2. Mediciones SPO2, NIBP, ECG 3. Monitor con pantalla TFT a color, LCD de 8" mínimo 4. Funciones: Monitoreo, cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). 5. Impresora incorporada 6. Batería incorporada 7. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz 8. Energía suministrada hasta 360J 9. Entregar con los accesorios: cable de paciente ECG, sensor SPO2, paletas de desfibrilación adultas y pediátricas, brazalete NIBP adulto y pediatrico, parches trascutáneos adulto y pediatrico. 10. Alarmas audibles y visibles 11. Tiempo de carga menor o igual a 8 seg a máxima energía (360J) 12. Forma de onda bifásica 13. Autonomía de la batería: para monitorización Mínimo de 5 horas con 1 batería - Modo desfibrilador mínimo 100 veces, descarga de 360 J con 1 batería. 14. Almacenamiento de datos: Perfiles o archivos de máximo 100 pacientes y 1000 eventos por paciente.	COMEN	S8	S8061224011	FUNCIONANDO	 
18	ATENCION DEL PARTO-SALA DE PARTO	DESFIBRILADOR		COMEN	S8	S8061224012	FUNCIONANDO	 

19	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	DESFIBRILADOR		COMEN	S8	S8230315002	FUNCIONANDO		
20	URGENCIAS-CONSULTORIOS	DOPPLER FETAL	1. Rango de LCF: 50 a 210 bpm o mayor 2. Modo de funcionamiento: Tiempo real, promedio y manual. 3. Alimentación eléctrica por baterías recargables. 4. Sonda transductor con frecuencia 2 MHz o mayor 5. Pantalla LCD para visualización de ritmo cardíaco fetal, detección de transductor y estado de batería. 6. Transductor a prueba de agua e intercambiable	EDAN	SONOTRAX II PRO	M23C10120070	FUNCIONANDO		
21	URGENCIAS-CONSULTORIOS	DOPPLER FETAL		EDAN	SONOTRAX II PRO	M23C10120075	FUNCIONANDO		
22	HOSPITALIZACION ADULTOS	ELECTROCARDIOGRAFO	1. Equipo de ECG para doce 12 derivaciones (canales). 2. Pantalla táctil TFT a color tipo LCD de 8 pulgadas mínimo. 3. Teclado alfanumérico. 4. Batería recargable con autonomía mínima de 3 horas o mayor 5. Impresora o registrador térmico integrado. 6. Protección contra desfibrilación. 7. Sensibilidad (Ajuste de ganancia): 5, 10, 20 AGC (mm/mV). 8. Filtros: Pasa bajos y AC como mínimo 9. Respuesta en frecuencia de 0,05 a 150 Hz (-3dB). 10. Función de análisis o interpretación. 11. Almacenamiento mínimo 500 exámenes	MINDRAY	BENEHEART R12	FN-44049378	FUNCIONAI		

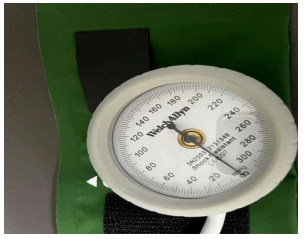
23	URGENCIAS- PROCEDIMIENTOS	ELECTROCARDIOGRAFO	11. Almacenamiento mínimo 500 electrocardiogramas 12. Conectividad: LAN/Ethernet o USB 13. Voltaje de alimentación 110 V +/- 10 % / 60Hz. 14. Accesorios a entregar con el equipo: - Cable EGC. - Set de electrodos para extremidades - Set de electrodos (chupas) para pecho. - Papel de impresión térmica. - Cable de alimentación. - Cable de toma a tierra.	MINDRAY	BENEHEART R12	FN-44049379	FUNCIONANDO	 
24	HOSPITALIZACION ADULTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1. Uso para paciente adulto, pediátrico y neonatal 2. Pantalla: Color TFT, resolución 800x600 (mínimo), de 12 pulgadas mínimo. 3. Batería con autonomía mínima de 1,5 horas. 4. Alarmas audibles y visibles 5. Medición de NIBP, SPO2, RESP, TEMP, ECG 6. Protección contra desfibrilación 7. Monitorización de ECG 3 o 5 derivaciones 8. Tendencias mínimo de 24 Horas con datos gráficos. 9. Instalación: 110 V +/- 10 %, 60 Hz. ±10% 10. Accesorios que se deben entregar con el equipo: cable paciente ECG, brazalete NIBP adulto-pediátrico-neonatal, sensor SPO2 adulto-pediátrico-neonatal y sensor de temperatura. 11. Impresora incluida 12. Detección de marcapasos 13. Debe incluir base movil con ruedas para monitor de signos vitales ofertado 14. Mínimo siete (7) formas de onda en simultánea	COMEN	STAR8000E	E7230315202	FUNCIONANDO	 
25	ATENCION DEL PARTO-SALA DE RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315217	FUNCIONANDO	 
26	HOSPITALIZACION ADULTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315230	FUNCIONANDO	 

27	URGENCIAS - OBSERVACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315239	FUNCIONANDO	 
28	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315240	FUNCIONANDO	
29	URGENCIAS-TRIAGE	MONITOR DE SIGNOS VITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315244	FUNCIONANDO	 
30	URGENCIAS-SALA DE OBSERVACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES		COMEN	STAR8000E	E7230315249	FUNCIONANDO	 

31	URGENCIAS - SALA DE PROCEDIMIENTOS	NEBULIZADOR	1. Rango de Flujo: igual o superior a 9 LPM 2. Libre de aceite 3. Presión máxima de 45 PSI +/- 5 PSI 4. Nivel de Ruido: menos de 55 Db 5. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz.	LENZ	NB-206B	202404021-0268	FUNCIONANDO		
32	URGENCIAS - SALA DE PROCEDIMIENTOS	NEBULIZADOR		LENZ	NB-206B	202404021-0297	FUNCIONANDO		
33	URGENCIAS - SALA DE PROCEDIMIENTOS	NEBULIZADOR		LENZ	NB-206B	202404021-0298	FUNCIONANDO		
34	ATENCION AL PARTO - ADAPTACION AL RECIEN NACIDO	OXIMETRO DE PULSO	1. Uso para adulto y neonatal 2. Pantalla LCD o TFT Color 3. Alarmas audible y visual. 4. Display para visualización de onda pletismográfica de SpO2, frecuencia de pulso y concentración de Oxigeno. 5. Base cargador y batería recargable. 6. Rango de medida SpO2: 0 % - 100% (Resolución 1%) 7. Rango de medida Pulso (PR): entre el rango de 15 a 300bpm (Resolución 1bpm) 8. Capacidad de almacenamiento de datos de 90 pacientes (resultados) o mayor. 9. Autonomía o vida útil de funcionamiento de la batería de 24 horas o mayor	EDAN	H100B	360101-M24612400050	FUNCIONANDO		

35	URGENCIAS-CONSULTORIOS	PESA BEBE	1. Pesa electrónica y/o digital 2. Capacidad de 0 a 20 kilogramos (44 libras) o mayor 3. División de escala o resolución de 15 +/- 5 gramos o menor 4. Bandeja o superficie de pesaje del bebé amplia y en material resistente. 5. Funciones: conversión de lb/kg, puesta a cero/ tara. 6. El equipo debe contar con alimentación eléctrica por adaptador de voltaje 115V +/- 5%, 60Hz y con alimentación por baterías.	HEALTH O METER	522KL	522342309504	FUNCIONANDO	 
36	ATENCION AL PARTO - ADAPTACION AL RECIEN NACIDO	PESA BEBE		HEALTH O METER	522KL	522342309993	FUNCIONANDO	 
37	URGENCIAS - CONSULTORIO	PESA BEBE		HEALTH O METER	522KL	522322410360	FUNCIONANDO	 

38	HOSPITALIZACION ADULTOS	TENSIOMETRO ADULTO	1. Tensiómetro aneroides portable con tecnología resistente a impactos 2. Rango de medición de 0-300 mm 3. Libre de látex 4. Precisión: ± 3mmHg o menor 5. Brazalete adulto 6. Perilla de insuflación 7. Válvula de purga o desinflado	WelchAllyn	DS45-11C DURASSHOCK	SN230110020219	FUNCIONANDO	
39	HOSPITALIZACION ADULTOS	TENSIOMETRO ADULTO		WelchAllyn	DS45-11C DURASSHOCK	SN230110021348	FUNCIONANDO	
40	URGENCIAS - CONSULTORIOS	TENSIOMETRO DE PARED	1. Carátula con rango de medición hasta 300 mmHg. 2. Precisión de ± 3 mmHg o menor. 3. Resolución 2 mmHg 4. Libre de Látex. 5. Perilla de Insuflación con válvula de liberación de aire. 6. Manguera o tubo extensible de 2,4 mts o mayor. 7. Debe entregar brazalete para Adulto 8. Soporte de pared de fácil rotación. 9. Carcasa fabricada en plástico de alto impacto.	RIESTER	BIG BEND OUT	2310040632	FUNCIONANDO	 

41	URGENCIAS - CONSULTORIOS	TENSIOMETRO DE PARED		RIESTER	BIG BEND OUT	2310040649	FUNCIONANDO	
42	URGENCIAS- CONSULTORIOS	TENSIOMETRO PEDIATRICO	1. Tensiómetro aneroides portable con tecnología resistente a impactos 2. Rango de medición de 0-300 mm 3. Libre de látex 4. Precisión: ± 3mmHg o menor 5. Brazalete pediatrico 6. Perilla de insuflación 7. Válvula de purga o desinflado	WelchAllyn	DS44-09 DURASSHOCK CHILD CUFF	SN25061021639	FUNCIONANDO	
43	HOSPITALIXACION PEDIATRIA	TENSIOMETRO PEDIATRICO		WelchAllyn	DS44-09 DURASSHOCK CHILD CUFF	SN250312151349	FUNCIONANDO	 
44	URGENCIAS- CONSULTORIOS	TENSIOMETRO PEDIATRICO		WelchAllyn	DS44-09 DURASSHOCK CHILD CUFF	SN250610211918	FUNCIONANDO	

45	ATENCION AL PARTO-ADAPTACION AL RECIEN NACIDO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	1. Modos de funcionamiento: Pre-calentamiento, manual y bebe. 2. Sonda o sensor de piel (bebe) 3. Funcion de inclinación de la cuna. 4. Función APGAR 5. Alimentación por línea AC 120 v +/- 10 %, 60hz 6. Rango de control de temperatura: 15°C +/- 15 a 55°C +/- 15 7. Colchoneta acorde a las dimensiones de la cuna 8. Alarma de temperatura (sobrecalentamiento) 9. Alarma de fallo de sonda o sensor de piel 10. Alarma de fallo de alimentación 11. Unidad de control microprocesado con indicador digital para visualización de temperatura de paciente 12. Atril porta suero 13. Cuna limitada por paneles de seguridad 14. Ruedas con sistema de freno en dos ruedas como mínimo 15. Bandeja porta-chasis de rayos x 16. Batería interna.	DAVID MEDICAL	HKN-9010	A22BD0073011	FUNCIONANDO	 
46	URGENCIAS - TRIAGE	CAMILLA FIJA (DIVAN)	1. Diván fijo 2. Estructura fabricada en tubería cold rolled 3. Capacidad de carga mínima 100 Kg o mayor 4. Colchoneta en espuma de 5 cm o mayor de espesor 5. Medidas: 185 ± 5 cm de largo, 55 ±5cm de ancho, 83 ±3cm de alto. 6. Acabado en pintura electrostática en polvo.	MEDICOLSA	M-104	N/A	FUNCIONANDO	
47	hosPITALIZACION PEDIATRIA	CARRO DE PARO	1. Estructura en lámina Cold Rolled 2. Tapa o superficie superior elaborada en lámina de acero inoxidable o acrílico aislante 3. Acabado en pintura electrostática / epoxica 4. Ruedas con freno individual en dos ruedas como mínimo. 5. Mínimo cuatro (4) cajones para almacenamiento de insumos 6. Soporte para cilindro o bala de Oxígeno 7. Tabla de reanimación (RCP) en material plástico o MDF. 8. Toma eléctrico para conexión de equipos. 9. Bandeja auxiliar para equipo médico en lámina de acero inoxidable 10. Cerradura centralizada para todos los cajones. 11. Bocel o bomper de protección en el perímetro inferior. 12. Atril porta suero	MEDICOLSA	M-084	N/A	FUNCIONANDO	 
48	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTABLE	1. Luz led. 2. Otoscopio con sistema de fibra óptica. 3. Oftalmoscopio con mínimo 18 lentes y dioptrías entre -20 a +20 4. Bombilla LED de 3,0V - 3,7V con vida útil de hasta 20.000 horas 5. Mango para soporte de otoscopio y oftalmoscopio 6. Accesorios: conos y espéculos desechables 7. Estuche	GMD	GMDKOS-2TF-100V	N/A	FUNCIONANDO	
49	HOSPITALIZACIÓN ADULTO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTABLE		GMD	GMDKOS-2TF-100V	N/A	FUNCIONANDO	

50	HOSPITALIZACIÓN ADULTO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTABLE		GMD	GMOKOS-2TF-100V	N/A	FUNCIONANDO	
51	ATENCION DEL PARTO - SALA DE RECUPERACION	FONENDOSCOPIO ADULTO	1. Pieza de contacto pectoral (campana) fabricado en acero inoxidable 2. Campana acústica con membrana (diafragma) y anillos de protección contra el frio. 3. Olivas flexibles blandas y/o suaves 4. Tubo o manguera flexible. 5. Libre de látex 6. Uso en adultos	GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO	
52	URGENCIAS- OBSERVACION	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO	
53	URGENCIAS- OBSERVACION	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO	
54	URGENCIAS- TRIAGE	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO	

55	URGENCIAS-CONSULTORIOS	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO	
56	HOSPITALIZACION ADULTOS	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO	
57	HOSPITALIZACION ADULTOS	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO	
58	URGENCIAS CONSULTORIOS	FONENDOSCOPIO ADULTO		GMD	OIS300-GMD30-DCJ	N/A	FUNCIONANDO	
59	URGENCIAS- SALA DE REANIMACIÓN	LARINGOSCOPIO	1. Hojas con guia de luz de fibra optica autoclavables. 2. Mango tipo "C" ergonomico metalico, inoxidale con suoperficie antideslizante. 3. Luz blanca de 2.5 Volts. 4. Hojas para paciente adulto y pediátrico, como se describen a continuación : Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller), Neonatal. 00, 0 (Miller). Adultos. 3,4 (Macintosh y Miller). 5. Alimentación por bateria recargable 6. Entregar Estuche y cargador de baterias	WelchAllyn	LIMANO FIBRA OPTICA - LUZ LED	N/A		

60	URGENCIAS- SALA DE REANIMACIÓN	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIMANO FIBRA OPTICA - LUZ LED	N/A		
61	ATENCIÓN AL PARTO - ADAPATACIÓN AL RECIEN NACIDO	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIMANO FIBRA OPTICA - LUZ LED	N/A		
62	ATENCIÓN AL PARTO- ADAPATACIÓN AL RECIEN NACIDO	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIMANO FIBRA OPTICA - LUZ LED	N/A		
63	HOSPITALIZACION ADULTO	LARINGOSCOPIO	1. Hojas con guia de luz de fibra optica autoclavables. 2. Mango tipo "C" ergonomico metalico, inoxidale con suoperficie antideslizante. 3. Luz blanca de 2.5 Volts. 4. Hojas para paciente adulto y pediátrico, como se describen a continuación : Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller) Adultos. 3,4 (Macintosh y Miller). 5. Alimentación por bateria recargable 6. Entregar Estuche y cargador de baterias	WelchAllyn	LIMANO FIBRA OPTICA - LUZ LED	N/A	FUNCIONANDO	
64	HOSPITALIZACION ADULTO	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIMANO FIBRA OPTICA - LUZ LED	N/A		
65	HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIMANO FIBRA OPTICA - LUZ LED	N/A		


66	HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA	LARINGOSCOPIO		WelchAllyn	LIMANO FIBRA OPTICA - LUZ LED	N/A		
67	ATENCION DEL PARTO	SILLA DE RUEDAS	1. Estructura plegable fabricada en acero cromado o pintado 2. Tapicería del asiento, espaldar y apoya brazos en material impermeable de facil limpieza y desinfección. 3. Plataforma de apoya pies plegables o desmontables. 4. Capacidad de carga de 100 a 150 kg de peso. 5. Frenos de mano tipo palanca. 6. Ruedas delanteras de 8 pulgadas y ruedas trasera de 20 a 24 pulgadas aprox.	Konfort Plus	KBE-9953-III	N/A	FUNCIONANDO	  
68	HOSPITALIZACION ADULTOS	SILLA DE RUEDAS		Comfort Plus	KBE-9953-III	N/A	FUNCIONANDO	 
69	Adaptación al recien nacido	Fonendoscopio pediatrico	1. Pieza de contacto pectoral (campana) fabricado en acero inoxidable 2. Campana acústica con membrana (diafragma) y anillos de protección contra el frio. 3. Olivas flexibles blandas y/o suaves 4. Tubo o manguera flexible. 5. Libre de látex 6. Uso en niños	RIESTRER	4220-02	NA	FUNCIONANDO	 
70	Hospitalización pediatria	Fonendoscopio pediatrico		RIESTRER	4220-02	NA	FUNCIONANDO	
71	Hospitalización pediatria	Fonendoscopio pediatrico		RIESTRER	4220-02	NA	FUNCIONANDO	 
72	Consultorio medico -Urgencias	Fonendoscopio pediatrico		RIESTRER	4220-02	NA	FUNCIONANDO	
73	Consultorio medico -Urgencias	Fonendoscopio pediatrico		RIESTRER	4220-02	NA		

74	HOSPITALIZACIÓN ADULTO	Equipo de organos de los sentidos de pared	1. Pieza de contacto pectoral (campana) fabricado en acero inoxidable 2. Campana acústica con membrana (diafragma) y anillos de protección contra el frio. 3. Olivas flexibles blandas y/o suaves 4. Tubo o manguera flexible. 5. Libre de látex 6. Uso en niños	LENZ	SS-S400	NA		
75	HOSPITALIZACIÓN ADULTO	Equipo de organos de los sentidos de pared		LENZ	SS-S400	NA		
76	ATENCION AL PARTO	Mesa para atención de partos	1. Mesa de partos completamente eléctrica, de 3 secciones. 2. Estructura en tubo de acero de alta resistencia con acabado en pintura electrostática en polvo o equivalente. 3. Sistema de freno individual en las ruedas o con bloqueo centralizado 4. Colchón en esponja dura o material similar, forrado en material lavable . 5. Movimientos mínimos por control digital: Cambio de altura, elevación de respaldo (sentado), trendelenburg y trendelenburg inverso. 6. Regulación de altura entre 50cm a 90cm mediante sistema de control electrico. 7. Con barandas laterales en material resistente de alto impacto (desmontables o abatibles). 8. Peso a soportar: no menor a 200 kg 9. Dimensiones aproximadas: 195cm +/- 10cm x 95cm +/- 10cm (largo x ancho) 10. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz. 11. Atril porta suero con su respectivo mecanismo de fijación a la cama 12. Pierneras con su respectivo apoyo y todos los elementos de sujeción necesarios 13. Batería de respaldo 14. Con contenedor en material lavable para recoger fluidos incluido en la cama con soportes para retirar y poner	MB	10-1 TPR	CC9100	FUNCIONANDO	  
77	URGENCIAS CONSULTORIOS	Camilla fija con estribos	1. Tendido de tres planos 2. Con gabinete con un cajón mínimo y alacena con puerta auxiliar. 3. Tapizado en espuma de 4,5 cm o mayor 4. Pintura en polvo de aplicación electrostática. 5. Capacidad de carga 120 kg o mayor. 6. Estribos o taconeras removibles y graduables 7. Medidas: largo 180 ±5cm, ancho 55 ±5cm, alto 80 ±5cm.	MB	M-154	NA	FUNCIONANDO	 
78	URGENCIAS CONSULTORIOS	Camilla fija con estribos		MB	154	NA	FUNCIONANDO	

OBSERVACIONES REPORTES DOCUMENTALES				
Criterio	PRESENTA A CONFORMIDAD	NO PRESENTA	PRESENTA CON OBSERVACIONES	INFORMACION ADICIONAL
1.Factura (s) Electrónica de venta.	X			La E.S.E POPAYAN, presenta soportes correspondientes a facturas que se han presentado segmentadas conforme a la entregas realizadas, las cuales se encuentran descritas a continuacion: - Factura DASM-4006 emitida el 27/11/2025 por D&S TRADE S.A.S. NIT: 900010849; valor total = $329,424,232 ; N°Equipos facturados : 68. - Factura DASM-4009 emitida el 30/12/2025 por D&S TRADE S.A.S. NIT: 900010849; valor total = $17,367,741 ; N°Equipos facturados : 8. -Factura DASM-4010 emitida el 04/03/2026 por D&S TRADE S.A.S. NIT: 900010849; valor total = $15,611,4910 ; N°Equipos facturados : 2.. Consolidando las 3 facturas aportadas por la E.S.E se envidencia un valor facturado total de $ 362,403,464 correspondiente a un total de 78 equipos.
2. Acta de entrega de dotación por parte del proveedor.	X			La E.S.E POPAYAN aporta a conformidad acta de entrega emitida por el proveedor, relacionando en total 78 equipos, cantidad coherente con la facturacion parcial presentada, la informacion se encuentra detallada a continuacion: . - Acta de entrega N°1, emitida el 25/11/2025 por D&S TRADE S.A.S. NIT: 900010849; N°Equipos entregados: 68. - Acta de entrega N°2, emitida el 30/12/2025 por D&S TRADE S.A.S. NIT: 900010849; N°Equipos entregados: 8. - Acta de entrega N°3, emitida el 05/02/2026 por D&S TRADE S.A.S. NIT: 900010849; N°Equipos entregados: 2. Las actas anteriormente descritas refieren dar entrega real y a satisfaccion de la dotacion adquirida mediante el contrato de compraventa N°282 Suscrito entre la E.S.E Popayan y el contratista D&S TRADE S.A.S.
3.Recibo a satisfacción y /o acta de instalación y/o prueba de funcionamiento y/o recepción técnica (si aplica).	X			La E.S.E Popayan aporta informe de instalacion y ejecucion de pruebas de funcionamiento de la dotacion adqurida, documento emitido por el proveedor con fecha 10 de junio de 2026, declarando resultados de puesta en marcha favorables de acuerdo a los requermientos tecnicos especificos de las fichas tecnicas de cada equipo.
4. Comprobante de entrada o ingreso de la dotación expedido por almacén General o dependencia a cargo.	X			La E.S.E POPAYAN aporta a conformidad soportes documentales relacionados a continuacion: - Certificado de Ingreso a almacen N°41376, emitido el 28 de Noviembre de 2025, relacionando 68 unidades, por un valor de $ 329,424,232. soporta parcialmente la entrega de equipos a la institucion - Certificado de Ingreso a almacen N°41852, emitido el 31 de Diciembre de 2025, relacionando 8 unidades, por un valor de $ 17,367,741. soporta parcialmente la entrega de equipos a la institucion - Certificado de Ingreso a almacen N°42698, emitido el 16 de marzo de 2026, relacionando 2 unidades, por un valor de $ 15,611,491. soporta parcialmente la entrega de equipos a la institucion
5.Comprobante de entrega o recibo de recepción o asignación de la dotación al servicio asistencial previsto.	X			La E.S.E POPAYAN aporta soportes documentales relacionados a continuacion: - Nota de traslado N°41377, emitido el 28 de Noviembre de 2025, relacionando 68 unidades, por un valor de $ 329,424,232. - Nota de traslado N°41853, emitido el 31 de Diciembre de 2025, relacionando 8 unidades, por un valor de $ 17,367,741. - Nota de traslado N°42699, emitido el 16 de marzo de 2025, relacionando 2 unidades, por un valor de $ 15,611,491
6. Garantía De la Dotación	X			En los documentos aportados por la E.S.E se evidencia, certificacion y terminos de garantia con vigencia de un (1) año a partir de la fecha de entrega.
7. Hoja de vida de los equipos Biomédicos	X			La E.S.E Popayan presenta a conformidad las hojas de vida de la dotacion clasificada como equipo biomedico de acuerdo a lo contemplado en el decreto 4725 de 2005, de manera complementaria sustenta mediante oficio la categorizacion de mobiliario hospitalario dentro del subproceso de gestion de tecnologia.

8. Capacitación en el uso y manejo de la dotación (adjuntar lista de asistencia)	X			En los documentos aportados por la E.S.E POPAYAN, se identifican soportes relacionados a continuacion: - Acta de capacitacion uso adecuado de equipos biomedicos efectuada el dia 27 de noviembre de 2025, relacionando listado de asistencia el desarrollo de la jornada refiere: Configuración, manejo y uso adecuado de equipos biomédicos Desfibrilador Manual, Desfibrilador DEA, Bomba de infusión entre otros. - Acta de capacitacion uso adecuado de equipos biomedicos efectuada el dia 29 de Diciembre de 2025, relacionando listado de asistencia el desarrollo de la jornada refiere: Mobiliario hospitalario, camilla ginecologica con estribos, equipo de organos a pared, fondendoscopio pediatrico. - Acta de capacitacion uso adecuado de equipos biomedicos efectuada el dia 19 de enero de 2026, relacionando listado de asistencia el desarrollo de la jornada refiere: Mobiliario hospitalario, monitor de signos vitales, cama de partos.
9. Certificado de comercialización de la dotación - declaración de Importación de la dotación	X			La E.S.E Popayan presenta la declaracion de importacion de la dotacion adquirida, se excluye de dicho requerimiento a equipos de fabricacion nacional.
10.Registro Sanitario de la dotación	X			La E.S.E Popayan aporta documentos soportando los registros sanitarios de la dotacion de acuerdo a lo establecido en el decreto 4725 de 2005, aplicable a dotacion hospitlaria.

OBSERVACIONES GENERALES
Se implementa herramientas que permiten verificar el cumplimeintos de las mínimas especificaciones técnicas obligatorias , así como de la documentación asociada a la dotación adquirida en el marco del convenio 2515 de 2025.

RESPONSABLES DE DILIGENCIAMIENTO	
PROCESO DIT -SDSC	 Daniel Felipe Maya Villarreal Profesional de apoyo - Ingeniero Biomedico Dirección Integral Terrirorial SDSC
PROCESO DIT -SDSC	 Maria Fernanda Ordoñez Astaiza Profesional de apoyo - Ingeniero Biomedico Dirección Integral Terrirorial SDSC