Radproct
SAFERAY FOR ALL

Resolución DIAN No. 18764111501783 de fecha 22/06/2026, numeración autorizada con prefijo RADP del No. 10001 al 30000. vigencia 24 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RADP 16446

FORMA DE PAGO	FECHA					
30 DIAS	FACTURA			VENCIMIENTO		
03:48:22 p. m.	21	8	2026	20	09	2026
TIMBRADO	2026-08-21 15:47:51 -05:00					

RADPROCT SAS Nit 800.162.425-3

Actividad ICA 8699 Tarifa 9,66x1000

DATOS DEL CLIENTE

Nombre HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit 890700666 - 8

Centro 491 T Orden N° 0491

Dirección CL 9 AV CENTENARIO 16 38

Ciudad HONDA

Teléfonos

Para efectos de ICA, se convienen el precio y la cosa vendida en la ciudad de BOGOTA

No somos Grandres contribuyentes Ni Autorretenedores- Retenedores IVA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DOSIMETRIA PERSONAL TLD MENSUAL PERIODOJULIO 2026 CONTRATO 000116-2026	2.00	49,184.00	98,368.00

ON NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

SUBTOTAL	98,368
I.V.A.	0
TOTAL A PAGAR	**98,368**

Favor consignar : BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente # 062129663

CUFE:

f4e0b93884fcce573ec71f122c38ebc12f785d8e1558f7ba35a56e714fae55bde207e0744e516b78314d131de5f05aeb

Proveedor tecnológico, Ateb Colombia NIT 900965992 - 7

RADPROCT SAS

Nit 800.162.425-3
Lic. Min de Minas y Energia LPD-MME-007-2026 / LPD-MME-008-2026
Carrera 45 No. 93-15
Tels. 3157592171 - 3155150410
E-mail info@radproct.com

REPORTE DE DOSIMETRIA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA TOLIMA

No. Centro	491-0	Fecha Recibo Dosimetria	12/08/2026
Nit Entidad	890700666-8	Fecha Ingreso Lectura	24/08/2026
Municipio/Ciudad	Honda	Vo.Bo. / Firma del Resposable del Reporte	Uriel Chica Villegas
Contacto	Luis Fernando Santos Castro		
Cargo	Recursos Fisicos		

Codigo	Nombres y Apellidos	Genero	Radiacion	Identificacion	Fecha de Ingreso al Servicio	Periodo de Uso		Periodo Recambio	Ubicacion del Dosimetro	Dosis del Periodo (mSv)				Dosis Acumulada del año (mSv)				Dosis Acumulada desde Ingreso al Servicio (mSv)				Tec.	Lab.	Notas
						Primer dia	Ultimo dia			Neutro	Profun.	Ojo	Super.	Neutro	Profun.	Ojo	Super.	Neutro	Profun.	Ojo	Super.			
2481380	Control C	Masculino	Rayos X	1	10/01/2013	01/07/2026	31/07/2026	M	Torso		ND	ND	ND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59	15.39	15.40	TLD	Inter	1
62064	nasliy katherin espitia rodriguez	Femenino	Rayos X	1105789131	01/10/2025	01/07/2026	31/07/2026	M	Torso		ND	ND	ND	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20	TLD	Inter	1
62065	vanessa ordoñez manrique	Femenino	Rayos X	1105792300	01/10/2025	01/07/2026	31/07/2026	M	Torso		ND	ND	ND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TLD	Inter	1

* Para los dosimetros generados en las instalaciones de **RADPROCT SAS** La dosis del **DOSIMETRO DE CONTROL** no ha sido sustraída

Nomenclatura: ER=Envio Registrado, EU=En Uso, RD=Recibido, NP=No Presentado, PPL=En Proceso Para Lectura, ND=No Detectable, DNL=Dosimetro No Leible, SL=Dosimetro Sin Lectura.

Tecnologia utilizada (TLD: Dosimetro Termoluminiscente, OSL: Luminiscencia Estimulada Opticamente), **Laboratorio:** Interno (lectura realizada por RADPROCT) Externo (Lectura realizada por intercomparación)

Notas: 1.Ninguna, 2.Extraviado, 3.Llego nuevo, 4.Supera dosis permitida de 1,67 mSv (Torso), 41,6 mSv (Anillo) y 12,5 mSv (Cristalino), 5.Emulcion Destruida, 6.Dosimetro Control No Leible, 7.Supera Tiempo para Lectura

Una Nota Importante: La razon por la cual la ICRP=Comision Internacional de Proteccion Radiologica, recomienda que el limite de dosis para Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos sea de 20 mSv año obedece a estimar que la vidalaboral de una persona es de 50 años y que en toda la vida debe recibirse como maximo una dosis de un Sievert. El limite de dosis para trabajadores con ubicacion dosimetro extremidad (anillo) es de 500mSv año.

Informacion de interes general:

* Una dosis reportada como ND=No Detectable, significa que la lectura esta entre cero y el nivel de deteccion (0,01 mSv)

* Hp(d), es la dosis equivalente personal a la profundidad indicada en milimetros. Asi: Hp(10) estima la dosis en tejido profundo, Hp(0.07) estima la dosis en tejido superficial y Hp(3) estima la dosis al cristalino.

* Los dosimetros de control, tienen por objeto la verificacion de irradiaciones incidentales o accidentales durante el transporte y/o lugar de almacenamiento mientras es retornado para lectura. No deben utilizarse o ser asignados a usuario.

* Una dosis reportada como PPL, significa que el dosimetro se recibio y esta en proceso para lectura.

* Toda dosis que sea igual o supere el valor de 1.67 mSv/mes debe ser investigada y documentada al interior de la instalacion. Tal registro, es una señal de alerta indicadora de la posibilidad de sobrepasar el limite anual, o indicadora de la necesidad de optimizar la practica.

* Toda dosis que sea igual o supere el valor de 12.0 mSv/mes debe ser inmediatamente reportada a la Autoridad Reguladora, con el fin de emprender acciones que reduzcan o eviten la exposicion o la probabilidad de exposicion.

* La periodicidad de recambio de los dosimetros, reviste importancia ante la necesidad de investigar registros de dosis fuera de los rangos recomendados, ante un incidente, un accidente o una situacion de emergencia.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 890.700.666-8

Honda, 25 de marzo de 2026

Señoras:
Naslly Katherin Espitia Rodríguez
Vanessa Ordoñez Manrique
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Ciudad

Por medio de la presente, se hace entrega de dos dosímetros en que medirán la radiación emitida a las personas que utilizan el periapical, los cuales quedan bajo la responsabilidad del área de odontología, en caso de daño o perdida cada dosímetro tiene un valor de $80.000 cada uno. También se hace entrega del folleto donde informan las recomendaciones de uso.

Cordialmente:

LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
Contratista Profesional Recursos Físicos

Naslly Espitia
Vanessa Ordoñez


Calle 9 No.16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22
e-mail: ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co
Teléfono: 3102249692

¿QUÉ ES?

Es un dispositivo que permite estimar la dosis en piel que una persona recibe en determinado intervalo de tiempo debido a la exposición a fuentes de radiación ionizante

TE CUIDAMOS

En un entorno donde la radiación es una realidad, la seguridad de nuestros trabajadores es primordial. Descubre cómo la dosimetría personal contribuye a proteger sus vidas.

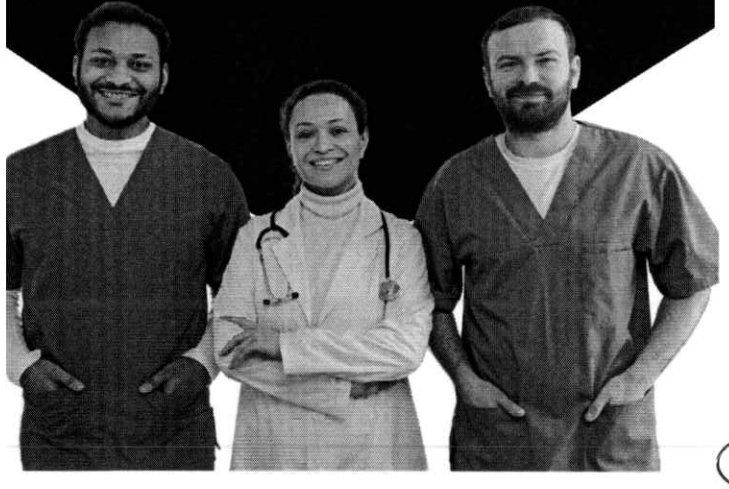

¡SIEMPRE COMPROMETIDOS CON TU SEGURIDAD!

CONTÁCTANOS

3157592171

radproct

@radproct

RADPROCT SAS

WWW.RADPROCT.COM

Radpr



DOSIMETRÍ

Protección y Seguri
en el Manejo d
Radiaciones

RECOMENDACIONES EN SU USO

01. Uso exclusivo: El dosímetro es personal e intransferible.

02. Almacenamiento adecuado: Cuando no esté en uso, almacena el dosímetro en un lugar seguro, lejos de fuentes de radiación y condiciones extremas.

03. Uso obligatorio: Utiliza el dosímetro en todo momento mientras te encuentres en áreas donde exista riesgo de exposición a radiaciones ionizantes.

04. Cambio de periódico: Devuelve el dosímetro en los períodos establecidos para su lectura y reemplázalo por uno nuevo.

05. Anotación de incidentes: Registra cualquier incidente o situación relacionada con el dosímetro, como pérdida, exposición inadvertida o daño.

06. Manejo cuidadoso: Evita exponer el dosímetro a condiciones extremas como calor, humedad, campos magnéticos intensos o golpes.

VIGILANCIA RADIOLÓGICA INDIVIDUAL

es un programa crucial que brinda información valiosa sobre la exposición ocupacional a radiaciones ionizantes, permitiendo controlar y minimizar los riesgos para la salud de los trabajadores, identificar áreas de mejora y garantizar el cumplimiento de las regulaciones y límites de exposición establecida.

MARCO LEGAL

El marco legal colombiano exige que todas las prácticas que implican el uso de radiaciones ionizantes garanticen la seguridad radiológica de los trabajadores, cumplan con los límites de dosis recomendadas y establezcan un sistema de registro de exposiciones, con el fin de limitar los riesgos. asociados a la radiación ionizante.

32

AÑOS

PROTEGIENDO TU SALUD

DOSÍMETRO DE ANILLO

El dosímetro de anillo sirve
estimar dosis máxima
extremidades y en piel midi
en la base del dedo de ac
mano más expuesta a la radi

DOSÍMETRO DE CRISTALINO

Diseñado para medir la
equivalente de cristalino, por
deberás portarlo en el protect
tiroides, en el borde superi
exterior del mismo.

DOSÍMETRO TLD TORSO

Siempre deberá ser usado e
torso, preferiblemente a la altur
pecho, si usas chaleco plom
deberás usarlo por debajo
mismo.