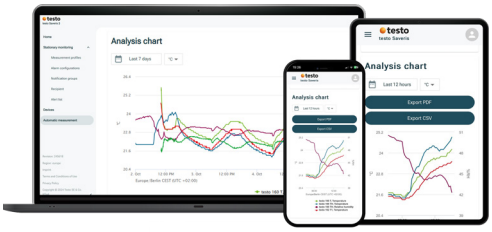
Be sure. testo

Sistema de monitorización

testo 162 – Sistema de registradores de datos online para la supervisión de la temperatura y la humedad





Para usar el sistema y el testo Saveris Cloud, es necesario contratar la licencia Testo Data Monitoring.

- Alerta por notificaciones push, correo electrónico o SMS cuando se sobrepasan los valores límites (opcional)
- Conexión a la App testo Smart: puesta en marcha sencilla, notificaciones push y tablero de mandos
- Documentación automática de los valores medidos en el testo Saveris Cloud

Los registradores de datos online testo 162 forman parte del sistema global de monitorización testo 16x. Los testo 162 registran valores de temperatura, humedad y CO_2 y los envían directamente a la nube testo Saveris a través de una conexión WLAN.

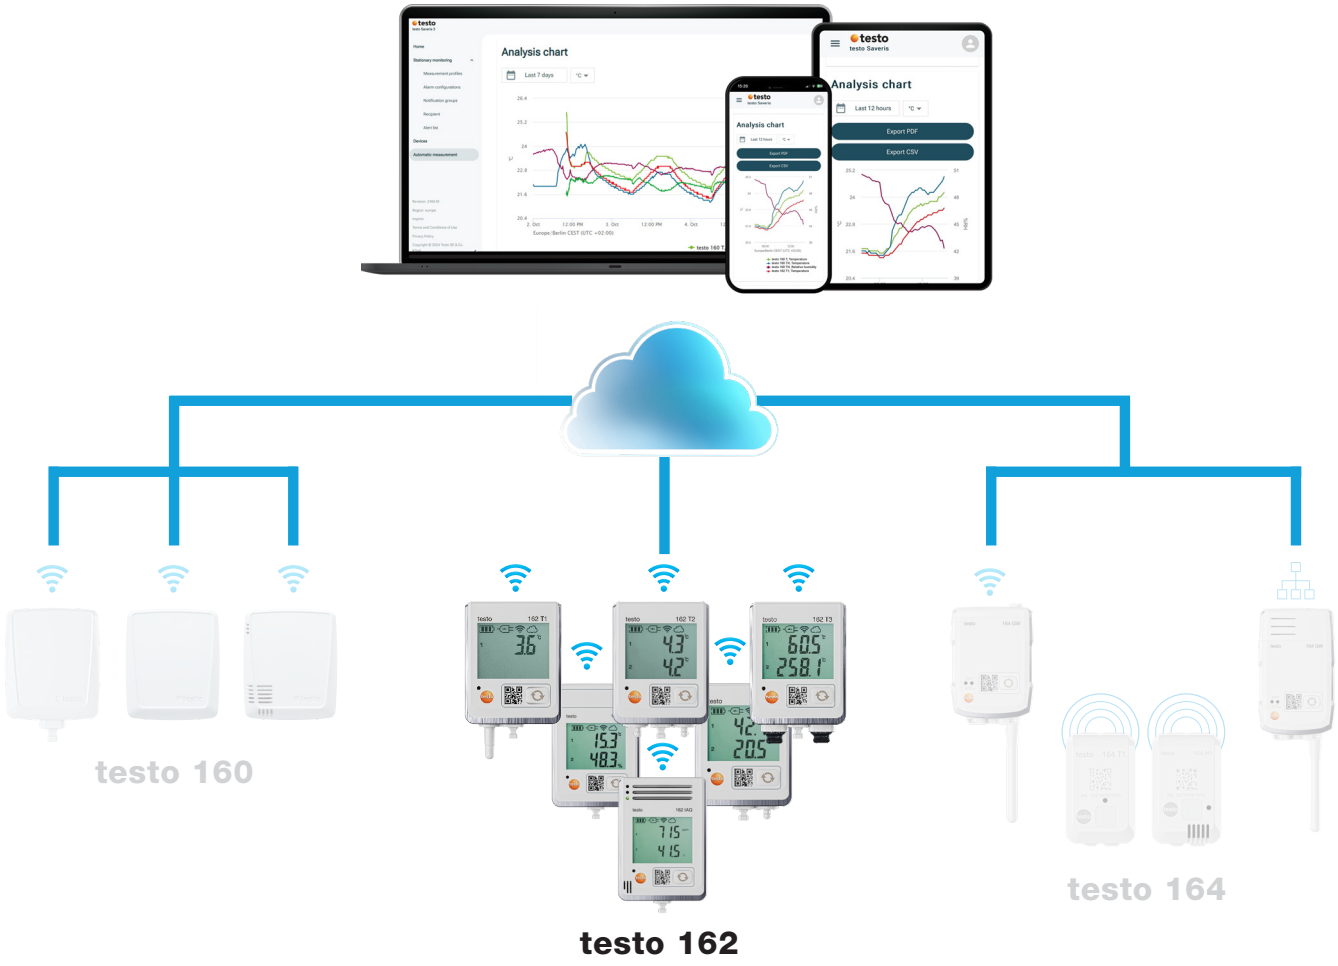
Si se incumplen los valores límite, la aplicación testo Smart le avisa directamente mediante notificaciones push, pero también puede configurar el Saveris Cloud para recibir avisos por e-mail o por SMS (esta última opción es de pago).

Puede acceder a todos los datos de medición y funciones de análisis en todo momento y desde cualquier lugar con un dispositivo (smartphone, tablet o PC) con conexión a internet.


Para utilizar los registradores de datos online y el testo Saveris Cloud es necesario contratar la licencia Testo Data Monitoring.

Así funciona la supervisión de la climatización con el sistema de registro de datos en línea testo 16x

El sistema de registro de datos en línea testo 16x consta de los componentes de hardware (testo 160, testo 162, testo 164), el testo Saveris Cloud y la App testo Smart.
La nube testo Saveris Cloud es la plataforma central desde la que se puede gestionar todo el sistema, visualizar y analizar los valores medidos.
Los registradores de datos testo 160, testo 162 y testo 164 le ofrecen la máxima flexibilidad gracias a su amplia gama de modelos y pueden combinarse y ampliarse fácilmente en su cuenta Testo del Saveris Cloud.



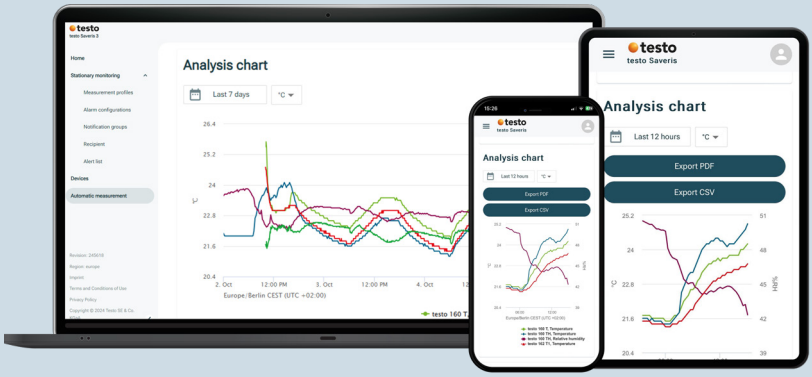Supervisión automática del valor medido.
Gracias a la conexión a la nube.



Con los registradores de datos online conectados al testo Saveris Cloud, la monitorización de las condiciones ambiente en interiores se hace sin esfuerzo en segundo plano. Usted apenas interviene, ya que el proceso está completamente automatizado. Luego puede acceder a todos los datos de medición en el Cloud mediante un dispositivo (smartphone, tablet o PC) con conexión a internet. Tan solo necesita contratar la licencia Testo Data Monitoring y configurar el sistema la primera vez: añadir los registradores de datos, establecer los valores límite y definir el método de envío y los receptores de las alarmas. El resto se hace solo.

- **Control centralizado para ver los datos y gestionar los puntos de medición**
- **Transmisión automática de los datos, elaboración de informes automatizada y emisión de alarmas cuando se incumplen los valores límite establecidos**
- **Datos accesibles en todo momento y desde cualquier lugar**
- **Vinculación a la App testo Smart para tener más funciones y prestaciones**

¡Abre tu cuenta en el testo Saveris Cloud! *

testo Saveris

* Solo para nuevos usuarios. Si ya es usuario de la tienda online Testo o de cualquiera de los otros servicios online Testo, no hace falta abrir una cuenta, puede acceder con su usuario y su contraseña.

Datos de pedido

testo 162 T1

testo 162 T1 -
Registrador de datos online con pantalla y sensor de temperatura integrado



Modelo 0572 1621

testo 162 T2

testo 162 T2 -
Registrador de datos online con pantalla y 2 conexiones para sondas de temperatura NTC



Modelo 0572 1622

testo 162 T3

testo 163 T3 -
Registrador de datos online con pantalla y 2 conexiones para sondas de temperatura TP



Modelo 0572 1623

testo 162 H1

testo 162 H1 -
Registrador de datos online con pantalla y sensor de temperatura y humedad integrado



Modelo 0572 1624

testo 162 H2

testo 162 H2 -
Registrador de datos online con pantalla y conexión para sonda de humedad y temperatura



Modelo 0572 1625

testo 162 IAQ

Registrador de datos online testo 162 IAQ con pantalla y sensores integrados para temperatura, humedad, CO2 y presión atmosférica



Modelo 0572 1626

Datos técnicos de los testo 162 de temperatura

	testo 162 T1	testo 162 T2	testo 162 T3
Medición de temperatura			
Tipo de sensor	NTC interno	NTC	Termopar tipo K, tipo J, tipo T
Rango de medición	-30 … +50 °C	-50 … +150 °C	Tipo K: -195 … +1350 °C
Exactitud	±0,5 °C	±0,5 °C	Tipo J: -100 … +750 °C
Resolución	0,1 °C	0,1 °C	Tipo T: -200 … +400 °C
Certificados/homologaciones			
	EN12830, HACCP		-
WLAN			
Estándar	802.11 b/g/n		
Seguridad	WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP		
Información general			
Temperatura de funcionamiento	-30 … +50 °C		
Temperatura de almacenamiento	-40 … +70 °C		
Clase de protección	IP65		IP54
Ciclo de medición y ciclo de comunicación	1 min … 24 h		
Memoria	10.000 valores de medición por canal		
Autonomía de la pila (con un ciclo de comunicación y medición de 15 min)	1 año		
Medidas	95 x 75 x 30,5 mm		
Peso (pilas incluidas)	240 g		






Datos técnicos de los testo 162 de humedad y CO2

	testo 162 H1	testo 162 H2	testo 162 IAQ
Medición de temperatura			
Tipo de sensor	NTC interno	NTC	NTC
Rango de medición	-30 … +50 °C	Véanse los datos técnicos de la sonda conectable	0 … +50 °C
Exactitud	±0,5 °C	Véanse los datos técnicos de la sonda conectable	±0,5 °C
Resolución	0,1 °C		
Medición de humedad			
Tipo de sensor	NTC interno	-	-
Rango de medición	0 … 100 %RH (sin condensación)	-	0 … 100 %RH (sin condensación)
Exactitud	± 2 %HR (20 … 80 % HR @25 °C) ± 3 %HR (@ 25 °C & < 20 % HR & > 80 % HR) ± 1 %HR histéresis ± 1 %HR deriva por año	Véanse los datos técnicos de la sonda conectable	± 2 %HR (20 … 80 % HR @25 °C) ± 3 %HR (@ 25 °C & < 20 % HR & > 80 % HR) ± 1 %HR histéresis ± 1 %HR deriva por año
Resolución	0,1 %HR	0,1 %HR	0,1 %HR
Medición de CO_2			
Rango de medición	-	-	0 … 5000 ppm
Exactitud	-	-	±(50 ppm + 3 % del v.m.) a +25 °C // ±(100 ppm + 3 % del v.m.) a +25 °C (en el funcionamiento con pilas)
Resolución	-	-	1 ppm
Presión atmosférica			
Rango de medición	-	-	600 … 1100 mbar
Exactitud	-	-	±3 mbar a +22 °C
Resolución	-	-	1 mbar
WLAN			
Estándar	802.11 b/g/n		
Seguridad	WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP		
Información general			
Temperatura de funcionamiento	-30 … +50 °C		
Temperatura de almacenamiento	-40 … +70 °C		-20 … +50 °C
Clase de protección	IP30	IP54	IP20
Ciclo de medición y ciclo de comunicación	1 min … 24 h	1 min … 24 h	1 min … 24 h (con alimentación de corriente continua) 5 min … 24 h (en el funcionamiento con pilas)
Memoria	10.000 valores de medición por canal		32.000 total de todos los canales
Autonomía de la pila (con un ciclo de comunicación y medición de 15 min)	1 año		
Medidas	115 x 82 x 31 mm	95 x 75 x 30,5 mm	117 x 82 x 32 mm
Peso (pilas incluidas)	240 g		

Accesorios





	Modelo	
Cable del contacto de la puerta testo 162 T2	0572 2152	
Alimentación de corriente para testo 162	0572 2020	
4 pilas tipo AA para funcionamiento hasta -10 °C	0515 0414	
4 pilas tipo AA para funcionamiento por debajo de -10 °C	0515 0572	
Elemento magnético para soporte de pared	0554 2001	
Soporte de pared para testo 162 H1, IAQ	0554 2015	
Cubierta decorativa para testo 162 IAQ	0554 2012	
Certificado de calibración ISO de temperatura, sonda de temperatura; puntos de calibración -18 °C, 0 °C, +40 °C; por canal/instrumento	0520 0153	
Certificado de calibración DAkkS de temperatura, sonda de temperatura; puntos de calibración -18 °C, 0 °C, +40 °C; por canal/instrumento	0520 0262	
Certificado de calibración ISO de humedad, puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C/+77 °F; por canal/instrumento	0520 0076	
Certificado de calibración DAkkS de humedad; sondas de humedad, puntos de calibración 11.3 %HR y 75.3 %HR a +25 °C; por canal/instrumento	0520 0246	
Certificado de calibración ISO de CO_2, puntos de calibración 0; 1.000; 5.000 ppm	0520 0033	

Sondas de temperatura para testo 162 T2

Tipo de sonda	Dimensiones Tubo de la sonda/punta del tubo de la sonda	Rango de medición	Exactitud	t_{99}	Modelo
Mini sonda, IP 54		-20 … +70 °C	±0,2 °C (-20 … +40 °C) ±0,4 °C (+40,1 … +70 °C)	15 s	0628 7510
Sonda integrada con funda de aluminio, IP 65, cable fijo extendido de 2,4 m		-30 … +90 °C	±0,2 °C (0 … +70 °C) ±0,5 °C (rango restante)	190 s	0628 7503
Sonda precisa de inmersión/ penetración, cable de 6 m, IP 67, cable fijo extendido		-35 … +80 °C	±0,2 °C (-25 … +74,9 °C) ±0,4 °C (rango restante)	5 s	0610 1725
Sonda para medición de superficies, cable fijo extendido de 2 m		-50 … +80 °C	±0,2 °C (0 … +70 °C)	150 s	0628 7516
Sonda NTC de penetración con cable plano, longitud del cable 2 m, IP 54, cable fijo extendido		-40 … +125 °C	±0,5% del v.m. (+100 … +125 °C) ±0,2 °C (-25 … +80 °C) ±0,4 °C (rango restante)	8 s	0572 1001
Sonda abrazadera con velcro para diámetros del tubo de máx. 75 mm, Tmáx +75°C, NTC, cable fijo extendido		-50 … +70 °C	±0,2 °C (-25 … +70 °C) ±0,4 °C (-50 … -25,1 °C)	60 s	0613 4611
Sonda de temperatura externa de 12 mm, enchufable sin cable		-30 … +50 °C	±0,2 °C (-30 … +50 °C)		0572 2153

¡Encontrará más sondas en www.testo.com!

Sonda de temperatura para testo 162 T3

Tipo de sonda	Dimensiones Tubo de la sonda/punta del tubo de la sonda	Rango de medición	Exactitud	t_{99}	Modelo
Sonda integrada con funda de acero inoxidable, TP tipo K	 Conexión: Cable fijo extendido de 1,9 m	-50 … +205 °C	Clase 2*	20 s	0628 7533
Sonda TP de penetración con cable plano, tipo K, longitud del cable 2 m, IP 54		-40 … +220 °C	Clase 1 (-25 … +200 °C) Clase 2 (<-25 °C y >+200 °C)	7 s	0572 9001
Sonda magnética, fuerza de adhesión aprox. 10 N, con imán, para mediciones a temperaturas elevadas en superficies metálicas, TP tipo K	 Conexión: Cable fijo extendido de 1,6 m	-50 … +400 °C	Clase 2*		0602 4892
Sonda abrazadera para tubería de 5 … 65 mm de diámetro del tubo, con cabezal de medición intercambiable, rango de medición, brevemente hasta +280°C, TP tipo K	 Conexión: Cable fijo extendido de 1,2 m	-60 … +130 °C	Clase 2*	5 s	0602 4592
Sonda abrazadera para tubería con velcro para mediciones de temperatura en tuberías con diámetro máx. 120 mm, Tmáx +120 °C, TP tipo K	 Conexión: Cable fijo extendido de 1,5 m	-50 … +120 °C	Clase 1*	90 s	0628 0020
Punta de medición de inmersión, flexible, de poca masa, ideal para mediciones en volúmenes pequeños, como placas de Petri o para mediciones en superficies (fijada, por ejemplo, con cinta adhesiva), TP tipo K, 2 m de cable térmico con aislamiento FEP, resistente a temperaturas de hasta 200 °C, cable oval con medidas: 2,2 mm x 1,4 mm		-200 … +1000 °C	Clase 1*	1 s	0602 0493

*Según la norma EN 60584-1 la exactitud de la clase 1 se refiere a -40 … +1.000 °C (tipo K), la clase 2 a -40 … +1.200 °C (tipo K), la clase 3 a -200 … +40 °C (tipo K).

Sondas de humedad y temperatura para testo 162 H2

Tipo de sonda	Dimensiones Tubo de la sonda/punta del tubo de la sonda	Rango de medición	Exactitud	Modelo
Sonda de humedad/temperatura de 12 mm, cable fijo extendido, longitud del cable de 1,3 m		-30 … +70 °C 0 … 100 %HR	±0,3 °C ±2 %HR a +25 °C (2 … 98 %HR) ±0,03 %HR/K ±1 dígito	0572 2155
Sonda de humedad/temperatura externa de 12 mm, enchufable sin cable		-30 … +50 °C 0 … 100 %HR	±0,5 °C ±2 %HR Coeficiente de temperatura: ±0,03 %HR/K (k=1) Estabilidad a largo plazo: ±1 %HR/año	0572 2154

¡Encontrará más sondas en www.testo.com!

1985 036X/cg/ITSA/05.2025

Reservado el derecho a realizar modificaciones, también de carácter técnico.

Instrumentos Testo, S.A.
P.I. La Baileta-Can Xinxa, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520
E-Mail: info@testo.es

Síganos en:

www.testo.com

testo 162 H1 / testo 162 IAQ

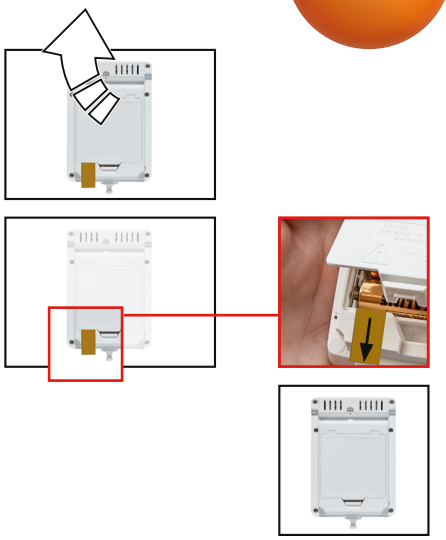
1



2




3



4



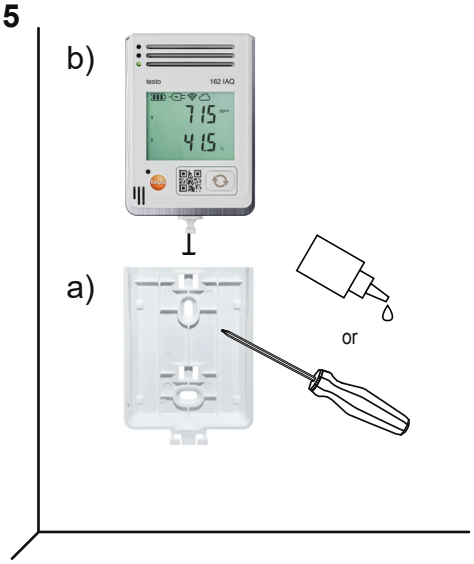5




6


www.testo.com/manuals

https://qr.testo.com/ldtw8z

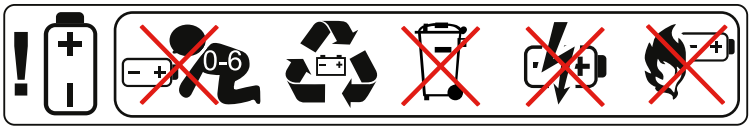www.saveris.testo.com/get-started





	°C				
117 x 82 x 32 mm 4.6 x 3.2 x 1.3 in  	-30 ... +30 °C -22 ... +86 °F  -40 ... +70 °C -40 ... +158 °F 	testo 162 H1: 0.1 °C 0.1 °F 0.1 %RH testo 162 IAQ: 0.1 °C 0.1 °F 0.1 %RH	testo 162 H1: -30 ... +50 °C -22 ... +122 °F 0 ... 100 % RH (non condensing) testo 162 IAQ: 0 ... +50 °C +32 ... +122 °F 0 ... 100 % RH (non condensing)	testo 162 H1: ± 0.5 °C ± 0.9 °F ±2 %RH @ +25 °C / +77 °F & 0 ... 90 %RH ±0.03 %RH / K (k=1) ±1 %RH hysteresis ±1 %RH / year drift testo 162 IAQ: ± 0.5 °C ± 0.9 °F ±2 %RH @ +25 °C / +77 °F & 20 ... 80 %RH ±3 %RH @ +25 °C / +77 °F & 20 ... 80 %RH ±1 %RH hysteresis ±1 %RH / year drift	testo 162 H1: 250 g IP 30 8.8 oz testo 162 IAQ: 269 g IP 20 9.5 oz

Approval and Certification

Product	testo 162 H1 testo 162 IAQ
Order no.	0572 1624 0572 1626
Model no.	H1 (2016) testo 160 IAQ
Date	28.07.2025

The use of the wireless module is subject to the regulations and stipulations of the respective country of use, and the module may only be used in countries for which a country certification has been granted. The user and every owner has the obligation to adhere to these regulations and prerequisites for use, and acknowledges that the re-sale, export, import etc. in particular in countries without wireless permits, is his responsibility.

Country	**Comments**
Australia & New Zealand	E 1561 80007249603
Brazil	testo 162 H1: 00842-18-04701 testo 162 IAQ: 00853-18-04701 See Brazil Information
Canada	testo 162 H1: IC: 6127B-05722034 Contains IC:21461-LSD4WF0459 testo 162 IAQ: IC: 6127B-05722014 Contains IC:21461-LSD4WF0459 See IC Warnings
Europa + EFTA	Hereby, Testo SE & Co. KGaA declares that the radio equipment types testo 162 H1 (H1(2016)) and testo 162 IAQ (testo 160 IAQ) are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.testo.com/eu-conformity **EU countries:** Belgium (BE), Bulgaria (BG), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Finland (FI), France (FR), Greece (GR), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Sweden (SE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Spain (ES), Czech Republic (CZ), Hungary (HU), Republic of Cyprus (CY). **EFTA countries:** Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland WEEE Reg. no.: DE 75334352
Israel	Authorized
Japan	R 211-160704 See Japan information
Malaysia	Authorized
Pakistan	Authorized
Philippines	Authorized
South Africa	testo 162 H1: TA-2017/762 testo 162 IAQ: TA-2025/1805
South Korea	testo 162 H1: MSIP-CRM-te2-05722034 testo 162 IAQ: R-CRM-te2-05722014 See KCC Warning
Thailand	Authorized
Türkiye	Authorized
Vietnam	Authorized
United Kingdom (UK)	The UK Declaration of Conformity can be found on the testo homepage www.testo.com under the product specific downloads.
USA	testo 162 H1: IC: WAF-05722034 Contains FCC ID: N8NLSD4WF0459 testo 162 IAQ: IC: WAF-05722014 Contains FCC ID: N8NLSD4WF0459 See FCC Warnings

WLAN Information	**Feature** 特征与参数	**Values** 数值
	WLAN range / 范围	up to 100 m (328 feet) (free field /无障碍场地)
	WLAN type / 型号	LSD4WF0459-01D0
	Radio type / 类型	Accord with the standard of IEEE 802.11b/g/n
	Company / 制造商	Lierda Science & Technology Group Co., Ltd
	RF Band / 射频频段	2412 – 2472 MHz
	Power output / 输出功率	13.42 dBm

Country / 国家	**Comments / 备注**	
China	Mic-power equipment / 微功率设备	
WLAN Information	**Feature** 特征与参数	**Values** 数值
	WLAN range / 范围	up to 100 m (328 feet) (free field /无障碍场地)
	WLAN type / 型号	LSD4WF0459-01D0
	Radio type / 类型	Accord with the standard of IEEE 802.11b/g/n
	Company / 制造商	Lierda Science & Technology Group Co., Ltd
	RF Band / 射频频段	2412 – 2472 MHz
	Power output / 输出功率	< 10 mW

- 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用无线遥控设备技术要求，用于数据传输应用。采用内置天线。
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗 (ISM) 应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 微功率部分使用时温度和电压的环境条件（温度见说明书，由内部电池供电）

IC Warnings

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

RSS-Gen & RSS-247 statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Caution: Radio Frequency Radiation Exposure
This equipment complies with radio frequency exposure limits set forth by the Innovation, Science and Economic Development Canada for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the user or bystanders.

Co-Location
This device must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Attention : exposition au rayonnement de radiofréquences

Ce dispositif a été testé pour la conformité avec les valeurs Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences définies par la Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre le dispositif et l'utilisateur ou des tiers

Co-location
Ce dispositif ne doit pas être utilisé à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur.

FCC Warnings

Information from the FCC (Federal Communications Commission)

For your own safety
Shielded cables should be used for a composite interface. This is to ensure continued protection against radio frequency interference.

FCC warning statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Shielded interface cable must be used in order to comply with the emission limits.

Warning
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Radio Frequency Radiation Exposure
This equipment complies with radio frequency exposure limits set forth by the FCC for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the user or bystanders.

Co-Location
This device must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Brazil Information

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este equipamento não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas necessárias para minimizar estas interferências.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – https://www.gov.br/anatel/pt-br/

Japan Information

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

KCC Warning

이 기기는 사용 중 전파 혼신 가능성이 있으며, 타기기로 부터 유해한 혼신을 받을 수 있음.

Manufacturer/ importer

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany
+49 7653 681-0
www.testo.com

Warning: Please follow the instructions when using the product.