

Reporte de sesión

27/08/2026

Panel de información

Nombre	S926
Hora de inicio	2026-08-22 10:53:13 p.m.
Hora de paro	2026-08-22 11:08:13 p.m.
Número de serie	BLM120002
Duración:	00:15:00
Tipo de modelo	SoundPro DL

Panel de datos de resumen

<u>Descripción</u>	<u>Medidor</u>	<u>Valor</u>	<u>Descripción</u>	<u>Medidor</u>	<u>Valor</u>
Leq	1	81,3 dB	L90	1	78,6 dB
Ponderación	1	A	Respuesta	1	SLOW
Ancho de banda	1	1/3			
Leq	2	84 dB			
Ponderación	2	A	Respuesta	2	IMPULSE


Tabla de resumen de filtros - Leq

<u>Filtro</u>	<u>Leq</u>
	81,3 dB
12.5 Hz	12,1 dB
16 Hz	10,4 dB
20 Hz	12,4 dB
25 Hz	19,7 dB
31.5 Hz	23,5 dB
40 Hz	28,8 dB
50 Hz	45,1 dB
63 Hz	53,4 dB
80 Hz	60,4 dB
100 Hz	58,6 dB
125 Hz	60,9 dB
160 Hz	61,9 dB
200 Hz	60,5 dB
250 Hz	62,2 dB

315 Hz	65,2 dB
400 Hz	68,1 dB
500 Hz	71,9 dB
630 Hz	73,8 dB
800 Hz	72,5 dB
1,00 kHz	71,3 dB
1,25 kHz	70,5 dB
1,60 kHz	70,5 dB
2,00 kHz	68,9 dB
2,50 kHz	68,2 dB
3,15 kHz	65,6 dB
4,00 kHz	62,6 dB
5,00 kHz	56,4 dB
6,30 kHz	52,8 dB
8,00 kHz	50,2 dB
10,00 kHz	46 dB
12,50 kHz	40 dB
16,00 kHz	34,4 dB
20,00 kHz	34,2 dB


Resumen de la tabla de filtros - Leq

S926: Resumen de la tabla de filtros - Leq

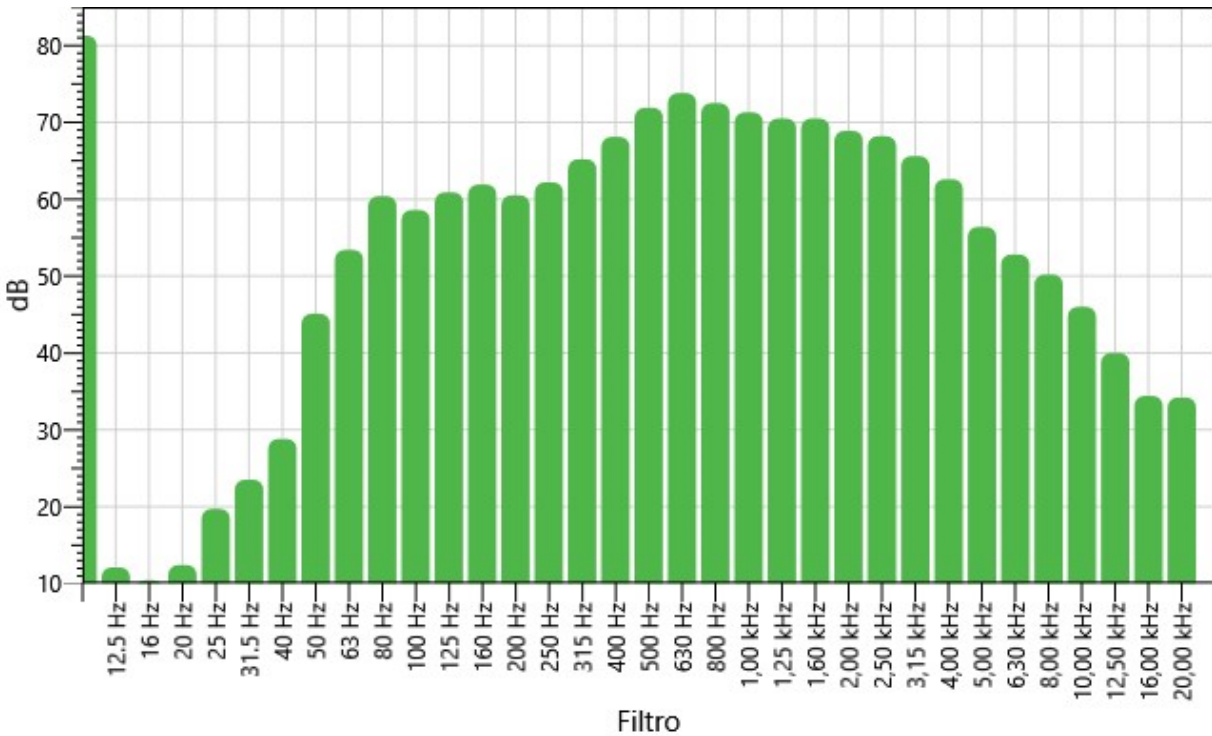

Gráfica de datos de registro

S926: Gráfica de datos de registro

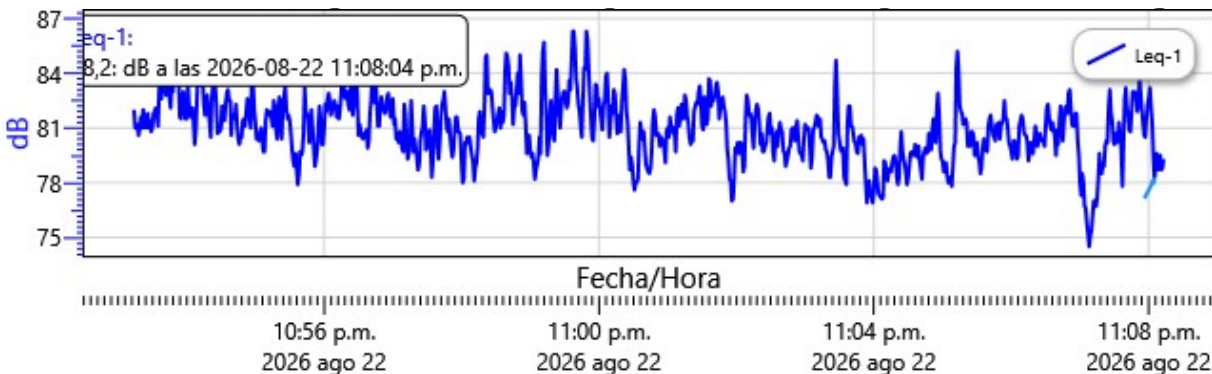

Historial de calibración

Fecha	Acción de calibración	Nivel	Tipo de modelo del calibrador	Número de serie	Fecha de certificación
2026-08-22 p.m.	10:40:11 Calibración	114,0			