Reporte de sesión

17/07/2026

Panel de información

Nombre	S116
Hora de inicio	2026-07-10 10:19:55 p.m.
Hora de paro	2026-07-10 10:34:59 p.m.
Nombre del dispositivo	BIJ060007
Tipo de modelo	SoundPro DL
Número de serie	BIJ060007

Panel de datos de resumen

Descripción	Medidor	Valor	Descripción	Medidor	Valor
Leq	1	81,5 dB	L90	1	78,8 dB
Ponderación	1	A	Respuesta	1	SLOW
Ancho de banda	1	1/3			
Leq	2	84,2 dB			
Ponderación	2	A	Respuesta	2	IMPULSE


Tabla de resumen de filtros - Leq

Filtro	Leq
	81,5 dB
12.5 Hz	18,5 dB
16 Hz	16,8 dB
20 Hz	15,3 dB
25 Hz	19,1 dB
31.5 Hz	21,9 dB
40 Hz	30,9 dB
50 Hz	39 dB
63 Hz	48,2 dB
80 Hz	55,3 dB
100 Hz	56,8 dB
125 Hz	59,9 dB
160 Hz	64,6 dB
200 Hz	62,9 dB
250 Hz	63 dB

315 Hz	64,5 dB
400 Hz	65,4 dB
500 Hz	69,8 dB
630 Hz	73,2 dB
800 Hz	72,2 dB
1,00 kHz	71 dB
1,25 kHz	72,6 dB
1,60 kHz	73 dB
2,00 kHz	70,3 dB
2,50 kHz	68,5 dB
3,15 kHz	66,6 dB
4,00 kHz	63 dB
5,00 kHz	57,8 dB
6,30 kHz	56,3 dB
8,00 kHz	54,2 dB
10,00 kHz	45,8 dB
12,50 kHz	45,3 dB
16,00 kHz	45,2 dB
20,00 kHz	45,2 dB


Resumen de la tabla de filtros - Leq

S116: Resumen de la tabla de filtros - Leq

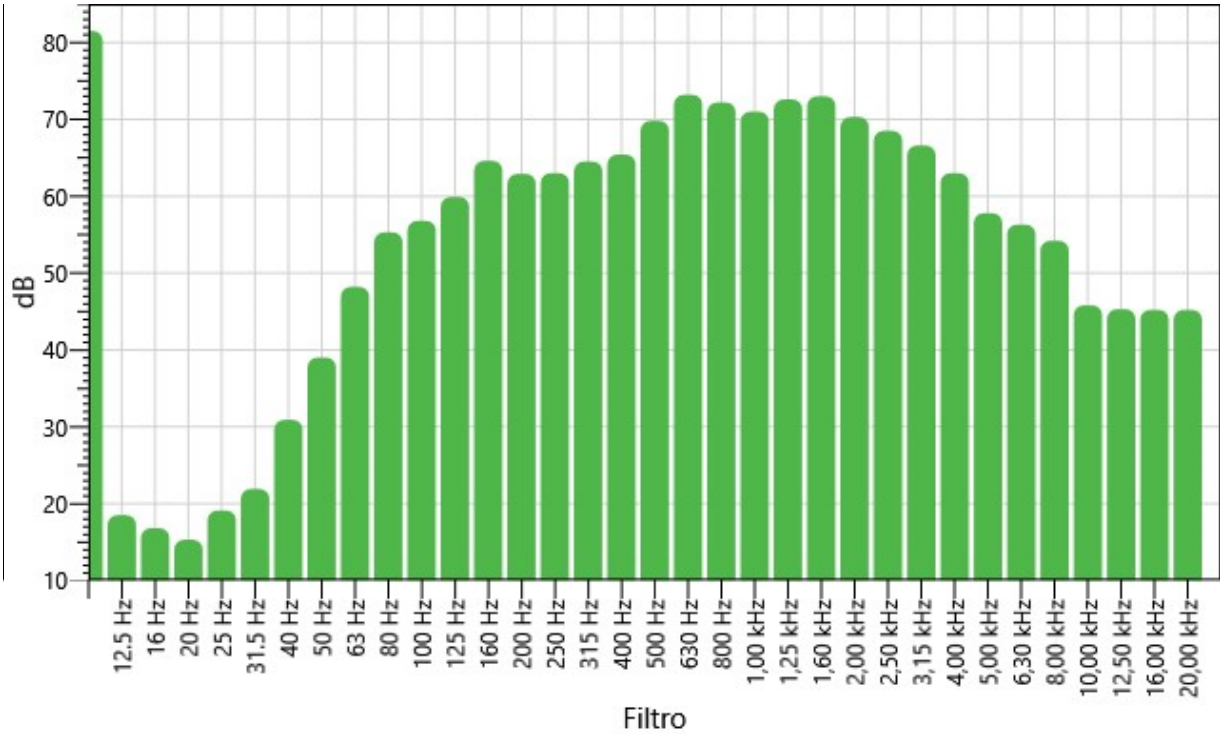

Gráfica de datos de registro

S116: Gráfica de datos de registro

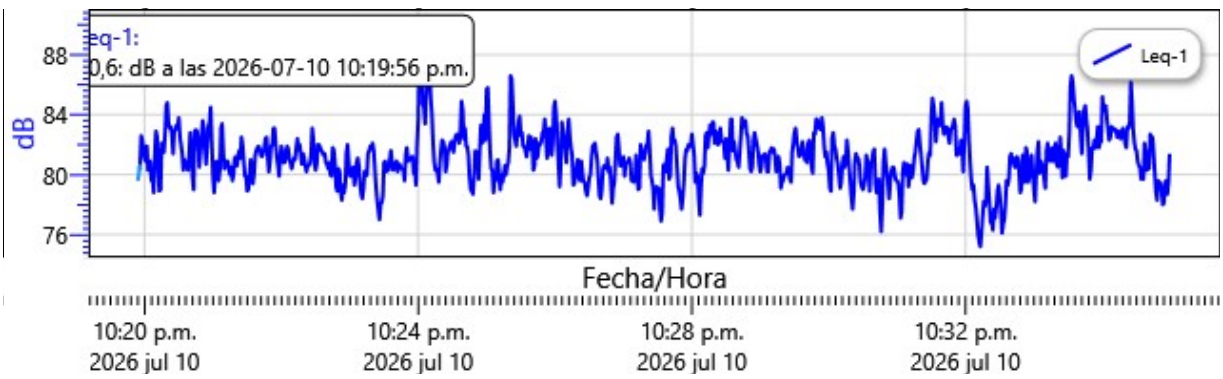

Historial de calibración

Fecha	Acción de calibración	Nivel	Tipo de modelo del calibrador	Número de serie	Fecha de certificación
2026-07-10 10:18:37 p.m.	Calibración	114,2			