Reporte de sesión

21/07/2026

Panel de información

Nombre	S119
Hora de inicio	2026-07-11 10:49:35 p.m.
Hora de paro	2026-07-11 11:04:45 p.m.
Nombre del dispositivo	BIJ060007
Tipo de modelo	SoundPro DL
Número de serie	BIJ060007

Panel de datos de resumen

Descripción	Medidor	Valor	Descripción	Medidor	Valor
Leq	1	61,7 dB	L90	1	57,4 dB
Ponderación	1	A	Respuesta	1	SLOW
Ancho de banda	1	1/3			
Leq	2	65,7 dB			
Ponderación	2	A	Respuesta	2	IMPULSE


Tabla de resumen de filtros - Leq

Filtro	Leq
	61,7 dB
12.5 Hz	18,1 dB
16 Hz	17,8 dB
20 Hz	15,5 dB
25 Hz	19,8 dB
31.5 Hz	20,8 dB
40 Hz	23,9 dB
50 Hz	30,8 dB
63 Hz	33,8 dB
80 Hz	40 dB
100 Hz	41,4 dB
125 Hz	43,5 dB
160 Hz	44,9 dB
200 Hz	44,6 dB
250 Hz	45 dB

315 Hz	47,2 dB
400 Hz	47,8 dB
500 Hz	49,8 dB
630 Hz	51,1 dB
800 Hz	51,1 dB
1,00 kHz	52,7 dB
1,25 kHz	52,3 dB
1,60 kHz	51,8 dB
2,00 kHz	51,1 dB
2,50 kHz	49,4 dB
3,15 kHz	47,7 dB
4,00 kHz	45,3 dB
5,00 kHz	43,3 dB
6,30 kHz	43,3 dB
8,00 kHz	42,4 dB
10,00 kHz	42,3 dB
12,50 kHz	45,2 dB
16,00 kHz	45,2 dB
20,00 kHz	45,2 dB


Resumen de la tabla de filtros - Leq

S119: Resumen de la tabla de filtros - Leq

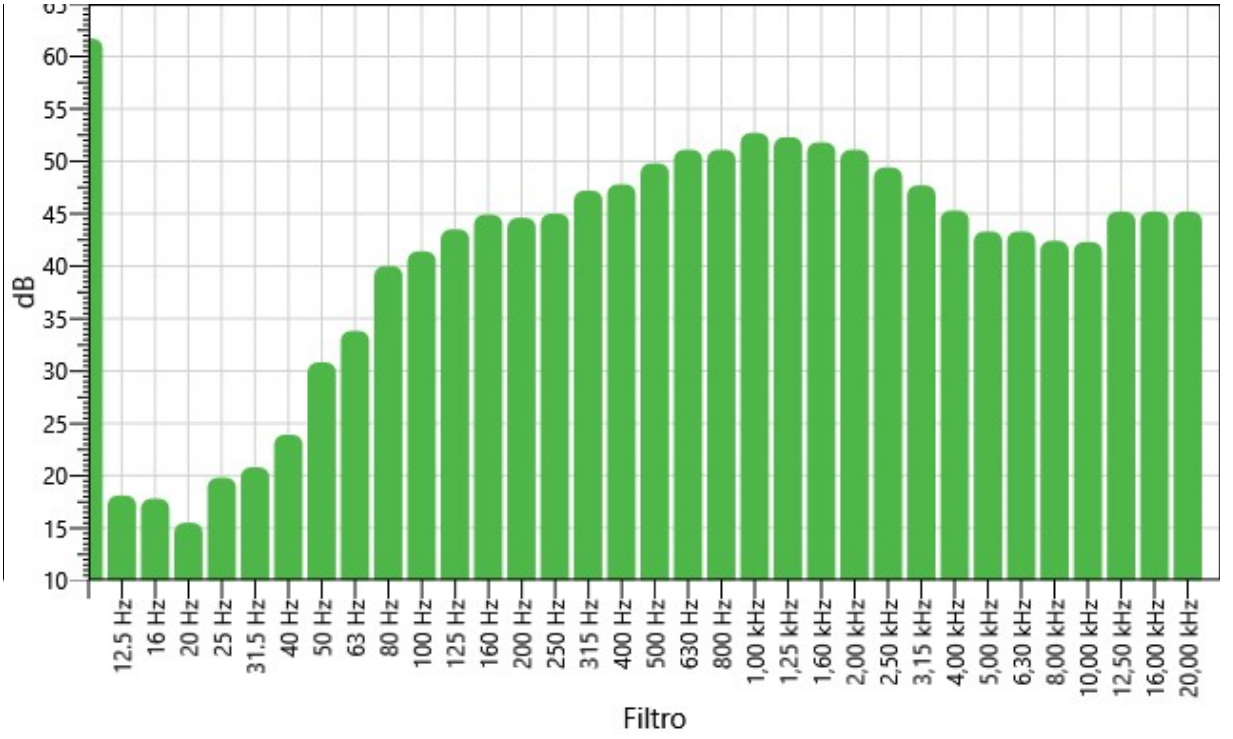

Gráfica de datos de registro

S119: Gráfica de datos de registro

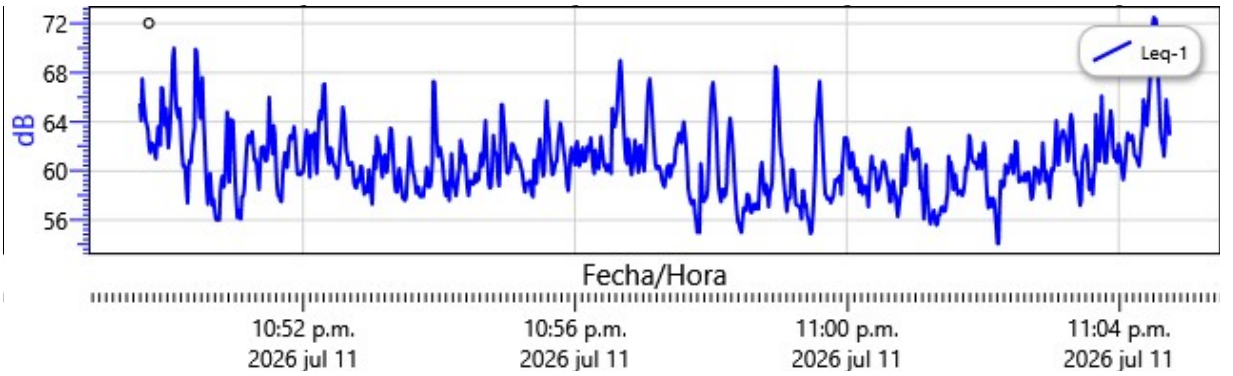

Historial de calibración

Fecha	Acción de calibración	Nivel	Tipo de modelo del calibrador	Número de serie	Fecha de certificación
2026-07-11 10:47:21 p.m.	Calibración	114,2			