



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT 800095785 : 2
ADMINISTRACION CENTRAL



SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nro. 0000000911

PARA: TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO - SECRETARIA DE HACIENDA
DE: ALCALDE MUNICIPAL
FECHA 27 DE AGOSTO DE 2026

Sírvase expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia 2026, conforme al siguiente detalle:

Inversión : X Codigo BPIN :

OBJETO: "ADQUIRIR EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA LA NOVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ."

ART.PRESUPUESTAL	SECCION	ARTICULO	FUENTE	INDICADO PRODUCTO	BPIN	VALOR
2.3.2.02.01.004.005	16-Entidades Territoriales - Administracion Central	Servicio De Apoyo Para La Dotación Hospitalaria	1.3.3.1.00-Recursos Del Balance De Libre Destinacion	190602601-Sedes dotadas	202500000036762	40.000.000,00
TOTAL						40.000.000,00

Ordenador del Gasto:


LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde Municipal



Dirección	CALLE 4 N° 4-65 Esquina Palacio Municipal	Elaboró	Yeimi Alesandra Fernandez Cano Sec. Inclusión Social
Página	www.sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co	Revisó	Yeimi Alesandra Fernandez Cano Sec. Inclusión Social
Teléfono	Teléfonos: -311 5338024 Fax: 098-4644757	Revisó	El Noga! Caqueta S.A.S. (Firma)
Email	hacienda@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co	Revisó	Mayerly Cardozo Garcia (Firma)



desarrollosocial desarrollosocial <desarrollosocial@sanvicedelcaguan-caqueta.gov.co>

SOLICITUD DE REVISION Y VISADO DE LA SCDP 911

2 mensajes

desarrollosocial desarrollosocial <desarrollosocial@sanvicedelcaguan-caqueta.gov.co>

28 de agosto de 2026 a las 15:21

Para: el nogal sas <elnogalcaquetasas@gmail.com>

Cordial saludo, Señor Asesor Financiero:

Remito para su revisión y visado previo la solicitud de CDP No. 0911 adjunta, bajo los siguientes datos técnicos:

Objeto del gasto: "ADQUIRIR EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA LA NOVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ."

Valor: \$ 40.000.000,00

Fuente de Financiación: 1.3.3.1.00-Recursos Del Balance De Libre Destinacion

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.01.004.005

Se adjunta solicitud de CDP

Cordialmente,

YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO

Secretaría de Inclusión Social

Edificio Centro Vida

Calle 3 con Carrera Esquina

San Vicente del Caguán - Caquetá

**SCDP AACIÓN POPULAR - LA NOVIA.pdf**

255K

el nogal sas <elnogalcaquetasas@gmail.com>

30 de agosto de 2026 a las 21:00

Para: desarrollosocial desarrollosocial <desarrollosocial@sanvicedelcaguan-caqueta.gov.co>

[El texto citado está oculto]

--

Cordialmente,

ERIKA JOHANNA PEREZ MONCAYO

R.L. El Nogal Caquetá SAS

**SCDP AACIÓN POPULAR - LA NOVIA.pdf**

268K



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT 800095785 : 2



ADMINISTRACION CENTRAL
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nro. 0000000890
VIGENCIA FISCAL 2026

FECHA DOCUMENTO: 27 DE AGOSTO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO: 05 DE DICIEMBRE DE 2026

ORDENADOR : 17672500 - LUIS TRUJILLO OSORIO

Inversión : X Codigo BPIN :

DOC. SOPORTE: SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD

Nro.0000000911

FECHA DOC.
SOPORTE:

27 DE AGOSTO DE 2026

OBJETO: "ADQUIRIR EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA LA NOVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ."

ART.PRESUPUESTAL	SECCION	ARTICULO	FUENTE	INDICADO PRODUCTO	BPIN	VALOR
2.3.2.02.01.004.005	16-Entidades Territoriales - Administracion Central	Servicio De Apoyo Para La Dotación Hospitalaria	1.3.3.1.00-Recursos Del Balance De Libre Destinacion	190602601-Sedes dotadas	202500000036762	40.000.000,00
TOTAL						40.000.000,00

Johany Parra Conde
Técnico Administrativo Código 367 Grado 6
Secretaria De Hacienda



Dirección	CALLE 4 N° 4-65 Esquina Palacio Municipal	Proyectó	
Página	www.sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co	Elaboró	Johany Parra Conde Técnico Administrativo Código 367 Grado 6
Teléfono	Teléfonos: -311 5338024 Fax: 098-4644757	Revisó	Magnolia Concepcion Rubio Montenegro Secretaria De Hacienda
Email	hacienda@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co	Aprobó	Johany Parra Conde Técnico Administrativo Código 367 Grado 6

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo para la dotación de equipos biomédicos, mobiliario clínico, equipos TIC y equipos industriales de uso hospitalario que fortalezcan la capacidad de atención en los servicios de salud en el municipio de San Vicente Del Caguán

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000036762

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/10/2025 17:01:32

Identificador: 1591746

Formulador Ciudadano: YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO

Formulador Oficial : YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CAÑO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

OBRAS Y NO PROMESAS 2024 -2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1 Desarrollo integral del Tejido Humano.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

TRABAJAMOS Y SERVIMOS AL CAGUAN 2024 - 2024

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Paz y Justicia Social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitada capacidad operativa del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán por la insuficiente dotación de equipos biomédicos y hospitalarios, lo que restringe la prestación de servicios de salud con calidad y oportunidad.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El sector salud del municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, enfrenta actualmente una limitada capacidad operativa para atender la demanda de servicios de salud, especialmente en áreas críticas como urgencias, hospitalización, consulta externa y apoyo diagnóstico. Esta situación se debe principalmente a la insuficiente dotación de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario, así como al deterioro y obsolescencia de muchos de los elementos existentes, algunos con más de 10 años de uso sin reposición ni mantenimiento adecuado.

El hospital atiende una población amplia, incluyendo zonas rurales y veredas apartadas, muchas de ellas con altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica y difícil acceso geográfico. Sin embargo, la falta de equipamiento actualizado limita su capacidad para brindar atención oportuna, segura y resolutive, obligando a la remisión constante de pacientes a otros centros hospitalarios en Florencia o Neiva, lo cual genera sobrecostos al sistema de salud, incrementa los tiempos de espera y expone a los usuarios a riesgos adicionales durante los traslados.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Impreso el 3/12/2025 2:01:20 a. m.

La limitada capacidad operativa del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, derivada de la insuficiente dotación de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario, se refleja en varios indicadores que evidencian el impacto negativo sobre la prestación de servicios de salud en el municipio y la región.

1. Tasa de remisión de pacientes a otros municipios

Valor actual: Aproximadamente el 42% de los casos que requieren atención especializada o diagnóstica son remitidos a hospitales en Florencia o Neiva (datos reportados por la ESE Hospital San Rafael, 2024).

Valor de referencia nacional: Según el Ministerio de Salud, el promedio nacional de remisiones en municipios similares no supera el 25%.

Interpretación: Una tasa elevada de remisiones refleja una baja capacidad resolutive del hospital local por falta de equipamiento adecuado.

2. Tiempo promedio de espera para atención médica en servicios de urgencias y consulta externa

Valor actual (2024): Urgencias: 3 a 6 horas / Consulta externa: 15 a 30 días.

Valor recomendado: Urgencias <2 horas / Consulta externa <7 días (según estándares del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud – SOGCS).

Interpretación: Los tiempos elevados de espera son resultado de la baja disponibilidad de equipos funcionales y limitaciones en infraestructura clínica.

3. Porcentaje de equipos biomédicos obsoletos o en mal estado

Valor actual: 47% del total de equipos médicos presentan obsolescencia, mal estado o están fuera de servicio (según inventario técnico interno, Hospital San Rafael, 2024).

Estándar recomendado: Menor al 15% (referencia del Ministerio de Salud para instituciones de mediana complejidad).

Interpretación: La alta proporción de equipos no funcionales limita la atención segura y oportuna.

4. Satisfacción de usuarios del servicio de salud

Valor actual (última encuesta interna 2024): Solo el 58% de los usuarios manifestaron satisfacción general con la atención recibida.

Meta nacional del Plan D

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de inversión en la adquisición, renovación y mantenimiento de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario en el sector salud.	1.1 Debilidades en la planeación y priorización de necesidades en infraestructura y dotación hospitalaria por parte de las entidades territoriales de salud. 1.2 Limitada asignación de recursos del presupuesto público para el fortalecimiento del equipamiento en el sector salud.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento en los tiempos de espera, en las remisiones a centros hospitalarios fuera del municipio y en la insatisfacción de los usuarios por la baja capacidad resolutive en el sector salud	1.1 Incremento en los costos para las familias y el sistema de salud por traslados, remisiones y atención en centros de mayor complejidad fuera del municipio. 1.2 Desconfianza de la comunidad hacia los servicios de salud pública y mayor preferencia por atención en entidades privadas o fuera del territorio.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar su capacidad resolutive y operativa. Reducir la necesidad de remitir pacientes a otros municipios. Cumplir con los estándares de habilitación y calidad en salud. Optimizar la atención médica	Lidera la formulación y ejecución del proyecto. Aporta recursos propios del municipio (si aplica) y gestiona recursos del SGP, regalías o cooperación. Realiza los procesos contractuales para la adquisición y entrega de la dotación. Garantiza el seguimiento y la supervisión del proyecto. Identifica y prioriza las necesidades técnicas de dotación (listado de equipos, especificaciones, cantidad). Apoya en la formulación técnica del proyecto. Se compromete a recibir, instalar, operar y mantener adecuadamente los equipos adquiridos. Designa personal responsable de los equipos y gestiona su sostenibilidad a largo plazo.
Actor: Otro Entidad: Hospital municipal y comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Usuarios esperan que, con la dotación de equipos y mobiliario hospitalario, el hospital pueda brindar atención médica más rápida y eficaz, sin largos tiempos de espera ni demoras en los procedimientos	Los beneficiarios, a través de las Juntas de Acción Comunal, veedurías ciudadanas, asociaciones comunitarias y comités de salud, han participado en espacios de diálogo y socialización donde expresaron sus necesidades frente a la atención en salud y la urgencia de mejorar la dotación hospitalaria. Esta información fue clave para priorizar el proyecto.

02 - Análisis de los participantes

Durante la fase de identificación y formulación del proyecto "Apoyo para la dotación de equipos biomédicos, mobiliario clínico y hospitalario que fortalezcan la capacidad de atención en los servicios de salud del Hospital San Rafael del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá", se ha promovido un proceso de consulta y coordinación interinstitucional y comunitaria, orientado a garantizar la pertinencia técnica, la participación social y la articulación entre los actores clave del sector salud.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

54.932

Fuente de la información

Base de datos Dane

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

54.932

Fuente de la información

Base de datos Dane

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas		
Departamento: Caquetá		
Municipio: San Vicente Del Caguán		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitada capacidad operativa del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán por la insuficiente dotación de equipos biomédicos y hospitalarios, lo que restringe la prestación de servicios de salud con calidad y oportunidad.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad operativa del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán mediante la dotación de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario, con el fin de mejorar la calidad, oportunidad y resolutivez en la prestación de los servicios

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sedes dotadas	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Secretaria de Inclusión Social Documentos oficiales Reportes del Hospital Comunidad en General

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de inversión en la adquisición, renovación y mantenimiento de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario en el sector salud.	Permite derivar productos y actividades específicas como: Compra de equipos. Contratación de mantenimiento. Actualización del inventario hospitalario.
Causa indirecta 1.1 Debilidades en la planeación y priorización de necesidades en infraestructura y dotación hospitalaria por parte de las entidades territoriales de salud.	Fortalecer la capacidad de planificación y priorización técnica de las entidades territoriales de salud para la identificación, gestión y actualización de necesidades en infraestructura y dotación hospitalaria.
Causa indirecta 1.2 Limitada asignación de recursos del presupuesto público para el fortalecimiento del equipamiento en el sector salud.	Gestionar y garantizar la asignación eficiente y sostenible de recursos públicos para la adquisición y mantenimiento de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario en el Hospital

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Promover alianzas interinstitucionales y fuentes de financiamiento complementarias para incrementar los recursos destinados a la dotación y mantenimiento del equipamiento hospitalario en el municipio.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Promover alianzas interinstitucionales y fuentes de financiamiento complementarias para incrementar los recursos destinados a la dotación y mantenimiento del equipamiento hospitalario en el municipio.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de apoyo para la dotación, mantenimiento y renovación de equipos biomédicos, mobiliario clínico y hospitalario para la mejora de la capacidad operativa del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán.

Medido a través de

Número

Descripción

El proyecto entregará un conjunto integral de equipos biomédicos, mobiliario clínico y hospitalario renovado y adecuado, que permitirá fortalecer la capacidad operativa del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, garantizando la prestación de servicios de salud con calidad, oportunidad y seguridad.

Descripción de la Demanda

Actualmente, el hospital enfrenta una insuficiente dotación de equipos médicos y mobiliario, que limita la prestación de servicios de salud con calidad, oportunidad y seguridad, generando demoras en la atención, aumento en las remisiones a centros hospitalarios fuera del municipio, y una baja satisfacción de los usuarios.

Descripción de la Oferta

Consiste en la adquisición, dotación e instalación de equipos biomédicos y mobiliario clínico-hospitalario para el Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en el municipio.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Promover alianzas interinstitucionales y fuentes de financiamiento complementarias para incrementar los recursos destinados a la dotación y mantenimiento del equipamiento hospitalario en el municipio.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa propuesta consiste en la adquisición, renovación e instalación de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para el Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, con el propósito de fortalecer su capacidad operativa y mejorar la calidad, oportunidad y cobertura de los servicios de salud prestados a la población del municipio.

Esta intervención busca responder a la problemática identificada de insuficiente dotación y obsolescencia de equipos y mobiliario, que limita la capacidad del hospital para atender de manera eficiente y segura la demanda creciente de servicios médicos.

Alternativa: Promover alianzas interinstitucionales y fuentes de financiamiento complementarias para incrementar los recursos destinados a la dotación y mantenimiento del

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: San Vicente Del Caguán Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Otros

Alternativa: Promover alianzas interinstitucionales y fuentes de financiamiento complementarias para incrementar los recursos destinados a la dotación y mantenimiento del

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 50.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 50.000.000,00

Permite derivar productos y actividades específicas como: Compra de equipos. Contratación de mantenimiento. Actualización del inventario hospitalario.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de elementos de dotación hospitalaria Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 50.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 54932 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 54932	1.1.1 Proceso de adquisición y compra de equipos y mobiliario hospitalario: Elaborar especificaciones técnicas y términos de referencia. Convocar y evaluar ofertas de proveedores. Realizar la compra de equipos y mobiliario conforme a la normativa vigente. Costo: \$ 45.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.1.2 Implementación de plan de mantenimiento preventivo y correctivo: Definir y ejecutar un programa periódico de mantenimiento. Contratar servicios técnicos especializados para reparaciones y ajustes. Monitorear el estado operativo de los equipos para garantizar su funcionamiento continuo. Costo: \$ 5.000.000,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Promover alianzas interinstitucionales y fuentes de financiamiento complementarias para incrementar los recursos destinados a la dotación y mantenimiento del

Actividad 1.1.1 Proceso de adquisición y compra de equipos y mobiliario hospitalario: Elaborar especificaciones técnicas y términos de referencia. Convocar y evaluar ofertas de proveedores. Realizar la compra de equipos y mobiliario conforme a la normativa vigente.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$45.000.000,00
Total	\$45.000.000,00

Periodo	Total
0	\$45.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Implementación de plan de mantenimiento preventivo y correctivo: Definir y ejecutar un programa periódico de mantenimiento. Contratar servicios técnicos especializados para reparaciones y ajustes. Monitorear el estado operativo de los equipos para garantizar su funcionamiento continuo.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Alternativa: Promover alianzas interinstitucionales y fuentes de financiamiento complementarias para incrementar los recursos destinados a la dotación y mantenimiento del

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Retrasos en los procesos de contratación y compras públicas debido a trámites burocráticos o falta de experiencia en la elaboración de términos de referencia técnicos específicos.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incremento de costos: Retrasos o correcciones derivadas de fallas administrativas pueden aumentar el presupuesto necesario para finalizar el proyecto.	Planeación detallada del cronograma y del proceso de adquisiciones. Elaborar un plan de adquisiciones con tiempos definidos, responsables y mecanismos de seguimiento. Iniciar con anticipación los trámites precontractuales para evitar cuellos de botella administrativos.
2-Componente (Productos)	Financieros	Demoras en los giros o asignación de recursos por parte del municipio o entidades cofinanciadoras, lo que puede afectar el cumplimiento del cronograma de ejecución.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retrasos en la ejecución del proyecto. Si los recursos no se asignan o desembolsan a tiempo, se puede generar una demora en los procesos de adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y mobiliario.	segurar la disponibilidad presupuestal antes de iniciar el proceso contractual Expedir el CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y el Registro Presupuestal (RP) previo al inicio de las contrataciones para evitar interrupciones por falta de recursos.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Proceso de adquisición y compra de equipos y mobiliario hospitalario: Elaborar especificaciones técnicas y términos de referencia. Convocar y evaluar ofertas de proveedores. Realizar la compra de equipos y mobiliario conforme a la normativa vigente. Riesgo: Ausencia o deficiencia en la documentación de legalización y actas de entrega, lo que puede generar problemas en la auditoría, control fiscal o recepción definitiva de los bienes.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Si no se especifican correctamente los requisitos técnicos o no hay control durante el proceso de compra, pueden entregarse equipos inadecuados, obsoletos o de baja calidad.	Designar un interventor técnico que supervise estrictamente el cumplimiento de los términos contractuales, especialmente en cuanto a calidad, cantidad y oportunidad de entrega.

Alternativa: Promover alianzas interinstitucionales y fuentes de financiamiento complementarias para incrementar los recursos destinados a la dotación y mantenimiento del

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

La ejecución del proyecto generará beneficios sociales y operativos directos al fortalecer la capacidad de atención del Hospital San Rafael mediante la dotación de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario. Entre los principales beneficios se destacan:
Disminución en los tiempos de espera para diagnóstico y tratamiento.
Reducción en las remisiones a otros municipios por falta de equipos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Las cantidades estimadas de los elementos a entregar se detallan de acuerdo con las necesidades de las áreas de urgencias, hospitalización, consulta externa y apoyo diagnóstico, mantenimiento de infraestructuras.

Descripción Valor Unitario: Precio base del equipo o mueble.

Costos de transporte e instalación.

Impuestos y gravámenes aplicables (si los hay).

Capacitación básica para su uso (en caso de equipos biomédicos).

Garantía y soporte técnico inicial.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2,00	\$1.500.000,00	\$3.000.000,00
1	20,00	\$2.000.000,00	\$40.000.000,00
2	5,00	\$2.500.000,00	\$12.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00
1	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00
2	\$12.500.000,00	\$12.500.000,00



Impreso el 3/12/2025 2:01:20 a. m.

Flujo

[illegible]

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Promover alianzas interinstitucionales y fuentes de financiamiento complementarias para incrementar los recursos destinados a la dotación y mantenimiento del equipamiento hospitalario en el municipio.					
\$174.598,10	9,41 %	\$1,00	\$728,17	\$40.000.000,00	\$68.975,81

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria (Producto principal del proyecto)	\$40.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Promover alianzas interinstitucionales y fuentes de financiamiento complementarias para incrementar los recursos destinados a la dotación y mantenimiento del equipamiento hospitalario en el municipio.

04 - Alcance

Permite derivar productos y actividades específicas como: Compra de equipos. Contratación de mantenimiento. Actualización del inventario hospitalario. Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria (Producto principal del proyecto), Medido a través de: Número de elementos de dotación hospitalaria, Cantidad: 1 con el fin de Fortalecer la capacidad operativa del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán mediante la dotación de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario, con el fin de mejorar la calidad, oportunidad y resolutivez en la prestación de los servicios Sedes dotadas, Número, 1 Caquetá, San Vicente Del Caguán

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Permite derivar productos y actividades específicas como: Compra de equipos. Contratación de mantenimiento. Actualización del inventario hospitalario.

Producto

1.1. Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Elementos de dotación hospitalaria adquiridos

Medido a través de: Número de elementos de dotación hospitalaria

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de Inclusión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	Total:	1,0000

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación		
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios	
0	50.000.000,00	50.000.000,00	1,0000	1,0000	0	

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------

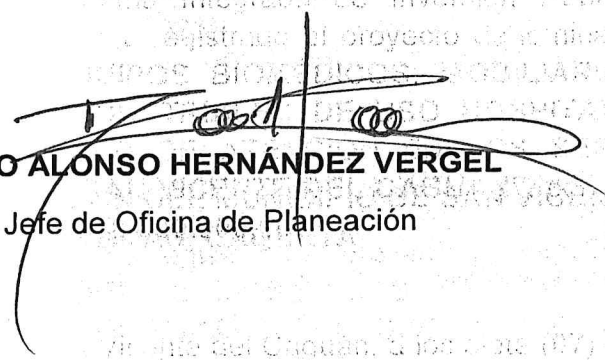
140-101

**LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUÁN, CAQUETÁ**

CERTIFICA QUE:

Que en el banco de proyectos de Inversión del municipio de San Vicente del Caguán y las plataformas PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública) y MGA (Metodología General Ajustada) fue registrado el proyecto denominado: **"APOYO PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO CLÍNICO, EQUIPOS TIC Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN"**, con código BPIN 202500000036762 por valor de **\$40.000.000,00**

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los siete (07) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).


DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL

Jefe de Oficina de Planeación


Elaboró

Yisneidy Sánchez Díaz –Técnico Administrativo 

Revisó

Diego Alonso Hernández- Jefe Oficina DE Planeación

Aprobó

Diego Alonso Hernández- Jefe Oficina DE Planeación 

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



CERTIFICADO DE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ,

CERTIFICA:

El contrato que se pretende celebrar cuyo objeto es "ADQUIRIR EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN EL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA LA NOVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ," con un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000,00) M/CTE, se encuentra incluido actualmente en el plan anual de adquisiciones de 2026, del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, del siguiente modo:

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable	PLATAFORMA
42172017 42172201 42172002 42172001	SUMINISTRO A TODO DE COSTO DE REPUESTOS, ACEITES Y ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, PARA LA REPARACION Y PREVENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS (CAMIONETA Y BUSETA), QUE PRESTAN EL SERVICIO EN CENTRO VIDA EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ	SEPTIEMBRE	3 MESES	MINIMA CUANTIA	SGP	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	NO	0	Yeimi Alesandra Fernández Cano- Secretaria de Inclusión Social	SECOP 2.

La presente certificación se expide para los fines pertinentes de contratación y al expediente en mención. Dada en San Vicente del Caguán, Caquetá, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2026.

YEIMI ALESANDRA FERNÁNDEZ CANO
Secretaria de Inclusión Social

Elaboró Fabián Andrés Gaviria Rojas – Técnico Administrativo SIS
Revisó Yeimi Alesandra Fernández Cano – Secretaria de Inclusión Social
Aprobó Yeimi Alesandra Fernández Cano – Secretaria de Inclusión Social

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
sanvicentefelcaguan-caqueta.gov.co
contáctenos@sanvicentefelcaguan-caqueta.gov.co



desarrollosocial desarrollosocial <desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACION EQUIPOS BIOMEDICOS

desarrollosocial desarrollosocial <desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

6 de agosto de 2026 a las 17:48

Para: comercializadoramaxiuniversal@gmail.com, angelita.teto@hotmail.com, az.9camiloandresvega@gmail.com

Buen día, amablemente solicitamos la cotización de los bienes relacionados en el documento adjunto.

Cordialmente,

YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO

Secretaría de Inclusión Social
Edificio Centro Vida
Calle 3 con Carrera Esquina
San Vicente del Caguán - Caquetá



SOLICITUD DE COTIZACIÓN_ EQUIPOS BIOMEDICOS.pdf

217K

San Vicente del Caguán – Caquetá, 06 de agosto de 2026.

Señores:

COMERCIALIZADORA MAXI UNIVERSAL A&M S.A.S

NIT. 900.672.523-4

Correo: comercializadoramaxiuniversal@gmail.com

Rep. Anyi Lizeth Vargas

JAM LOGISTICAS Y SERVICIOS S.A.S

NIT.901044158-2

Correo: angelita.teto@hotmail.com

Rep. Angela Maria Terranova Toledo

COMERCIALIZADORA JI S.A.S

NIT. 901.680.047

Correo: az.9camiloandresvega@gmail.com

Rep. Camilo Andrés Vega Bautista

ASUNTO: Solicitud de cotización.

El municipio de San Vicente del Caguán desea adelantar un proceso para **“ADQUIRIR EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA LA NOVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.”**

Para ello debe, en primer lugar, comprender la dinámica de los precios y establecer el presupuesto oficial para la contratación, lo cual implica realizar un estudio de mercado que, para el proceso en cuestión, se hará mediante cotizaciones a posibles proveedores.

Se aclara que la cotización que eventualmente se presente será tenida en cuenta para la realización del estudio de mercado, por lo tanto, **NO CONSTITUYE OFERTA**, ni surte efecto alguno entre quien emite la cotización y el municipio de San Vicente del Caguán.

Dicho esto, si desea presentar la cotización deberá tener en cuenta lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ELEMENTOS DE SALUD			
1	MONITOR DE SIGNOS VITALES: Unidad de medida: mm CmH₂O seleccionable. Tipo de medición: sistólica, diastólica, media Rango de presión para los adultos: Sistólica: 40 a 270 mmHg. Diastólica: 10 a 215 mmHg. Media: 20 a 235 mmHg. Rango de presión de Pediatría: Sistólica: 40 - 200 mmHg. Diastólica: 10-150 mmHg. Media: 20 a 165 mmHg. Rango de presión para los neonatos: Sistólica: 40 - 135 mmHg. Diastólica: 10-100 mmHg. Media: 20 - 110 mmHg. Prueba de fugas y calibración automática de la presión: Sí Protección contra presión excesiva. Resolución: 1 mm Hg. Precisión: Error medio máximo de ± 5 mmHg. Desviación estándar de ± 8 mm Hg. Alarma: sistólica, diastólica, media. PR de NIBP: Medida 40 ~ 240 latidos por minuto Resolución: 1 bpm. Precisión: ± 3bpm o 3% el que sea mayor. EDAN SpO₂: Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: $\pm 2\%$ (70-100%, Adulto / Pediátrico). $\pm 3\%$ (70-100%, Neonato). PR Medición y Rango de alarma: 30 - 300bpm. Resolución: 1 ppm. Precisión: 2bpm. Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Nellcor SpO₂ (opcional): Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: $\pm 2.3\%$ (70-100%, Adulto / Pediátrico). $\pm 3\%$-3.5% (70-100%, Neonato). Medición y Rango de alarma PR: 20 - 300 lpm. resolución: 1 bpm. Precisión: 3bpm (depende de la sonda). Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Temperatura (2 canales, una sonda de forma predeterminada)	UNIDAD	1
2	DOPPLER FETAL: Pantalla LCD de 45 mm x 25 mm Dos opciones de brillo: Activado / desactivado Frecuencia de trabajo: 2/3 MHz ($\pm 10\%$) Frecuencia nominal: 2 MHz/3MHz Modo de funcionamiento: CW (ondacontinua) Rango de FHR: 50/210lpm Frecuencia de muestreo de audio: 4KHz Duración de la grabación: 240 segundos Reducción y filtración de ruido Apagado automático tras un minuto sin señal o actividad. Parlante incorporado Tipo: AAR61. 2V, NI-MH recargables Tiempo de funcionamiento: 8 horas Tiempo de carga: 4 horas Adaptador cargador: Entrada: 100 a 240 VAC, 50/60Hz, 0, 2A Peso: <300 g (incluidas las pilas)	UNIDAD	1
3	ELECTROCARDIOGRAFO	UNIDAD	1

	Pantalla TFT grande de alta resolución de 5,7" a color de 640 x 480 puntos. Teclado alfanumérico. Operación de un solo toque. Adquisición simultánea de 12 derivaciones. Detección mejorada de señal débil. Filtro integrados y tecnología anti-ruido. Algoritmo avanzado SEMIP para mediciones e interpretación automática. Impresora integrada para presentación de informe de 6 canales.		
4	CAMILLA DIVAN FIJO 1. Diván con tendido fijo de un plano 2. Material de tubo en acero cold rolled 2*1 calibre 18 3. Patas con sus cuatro tapones plásticos 4. Tapizado en facil limpieza y lavable 5. Grosor de colchoneta 5cm 6. Dimensión: Largo de 1,80m x ancho de 0,55m x alto de 0,80m 7. Pintura electrostática el terminado 8. Capacidad de carga: 100 - 150Kg	UNIDAD	1
5	KIT DE SUTURA MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: portaagujas, tijera de mayo, tijera de tejido, pinza mosquito curva, pinza mosquito recta, pinza kely curva	UNIDAD	1
6	KIT DE PARTO: MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: tijera para episiotomia, pinza kelly recta, pinza mosquito curva y demas pinzas que componen el kit.	UNIDAD	1
7	KIT INSERCIÓN DE DIU MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: pinza tenaculo, histerometro, pinza rochester recta, tijera de mayo	UNIDAD	1
8	PESA BEBE: Capacidad: 20 Kg, División: 5Gr<10Kg>10Gr, Mecanismo: Electrónica, Material: Acero y Plástico, Retorno acero automático, Gran pantalla LCD de 1,0 pulgada, Bandeja extraíble, para ubicar al infante de pie, Diseño de la plataforma delgada Extreme, Celda de carga de alta precisión, Fácil de operar 3 teclas funcionales, Función de bloqueo para bloquear el peso del bebé en movimiento, Función taraparatar el peso del pañal y obtener el peso neto de bebé, Ahorro de energía función AUTO-OFF, Kg Unidadosleccionablelb,funcionaconbaterías9voadaptadordecorrientea110voltios.Básculagrado medico.	UNIDAD	1
9	BASCULA DIGITAL ADULTO: 1. Capacidad: 180 kg / Division: 100g 2. Material: Plástico y acero	UNIDAD	1

	3. Dimensiones: 31 x 29,8 , 3,5 cm 4. Electrónica 5. Fuente de alimentación: 2 Pilas AAA 6. Display: LCD 7. Certificado de calibración 8.Registro INVIMA 9.Grado médico		
10	TENSIOMETRO PEDIATRICO: 1 - Intervalo de 0-300mmHg 2 - Precisión de presión de ± 3 mmHg. 3 - División de escala de 2 mmHg. 4 - Brazaletes pediátrico libre de Látex y lavable 5 - Pera con válvula 6 - Estuche protector para transporte 7- Certificado de calibración	UNIDAD	1
11	LAMPARA CUELLO CISNE: N.º de LED : 1 LED blanco. Temperatura del color : 5.500 k Intensidad de la luz a distancia de trabajo : 20.000 lux a 30 cm (12 pulg). 15.000 lux a 50 cm (20 pulg). Tamaño del punto de la luz a distancia de trabajo : 16 cm a 30 cm (12 pulg), 15cm a 50cm (50 pulg). Dimensiones Físicas Alcance de la base móvil : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte de pared : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte al techo : n/a Techo arriba/abajo : n/a Artefacto de luz (alto/ ancho/ largo) : 19/9/8cm, (7,48/ 3,45/3,15 pulg). Cuadro de control (alto/ ancho/ largo) : 27,5/10,0/8,0cm, (10,83/3,94/3,15 pulg). Base móvil (alto/diámetro) : 61 cm/53 cm, (24,02 pulg./ 20,87 pulg). Peso total del soporte de mesa/ pared : 5,56 kg (5,65 libras). Peso total de base móvil : 5,78 kg (12,75 libras). Especificaciones eléctricas Suministro eléctrico : entrada= 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx. Cable eléctrico : Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud. Encendido/apagado sin contacto Datos variados Opciones de montaje : base móvil, mesa pared, rail Tipo de extensión : Cuello de cisne/cuello de ganso Accesorios opcionales : n/a Vida útil : 50.000 horas	UNIDAD	1
12	PULSOXIMETRO:	UNIDAD	1

	Características: •pulsoxímetro con sensor tipo dedo integrado para medición de saturación de oxígeno (spo2) y frecuencia cardiaca (fc) con visualización de curva pletismografica. Es un dispositivo pequeño y portátil, cuenta con iluminación intensa de pantalla led para una adecuada visibilidad de pulso, la interfaz de la pantalla cuenta con giro automático en 4 direcciones. Especificaciones técnicas: •alimentación: 2 baterías aaa 1,5v •rango de medidas po 2:35– 100% •resolución: 1% •precisión: 2% •rango frecuencia cardiaca: 30–250lpm •resolución: 1lpm •precisión: 2lpm •dimensiones: 74mm(l) x 37mm(w) x 38mm(h) •peso:50g(bateríasincluidas)accesorios:•bandadefijaciónparaelcuello. •2pil asaaa•manualdeuso		
13	GLUCOMETRO: Eyector de tira • No requiere CODIFICACIÓN • Detección de llenado audible • Almacena 1.000 resultados con fecha y hora • Promedia 7,14,30, y 90 días • Alarmas recordatorias • SMART LOG® (software de control) • Sistema Bluetooth	UNIDAD	1
14	SUCCIONADOR: Bomba libre de aceite (pistón libre de lubricación). Alta velocidad de flujo, con filtro bactericida. Recipiente: vidrio 2500 ml x 2 und reutilizables. Máximo vacío: 0.09Mpa (680 mmHg). Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40L/min. Intervalo de vacío ajustable: 0.02 – 0.09Mpa (150-680 mmHg). Nivel de ruido: 60 dB a 1 M. Potencia de trabajo: 250 VA. Requerimiento eléctrico: 220 V, 50/60 Hz, 250 VA Sistema de trabajo: Operación continua con carga intermitente.	UNIDAD	1

COSTOS:


Se deberán tener en cuenta los impuestos nacionales y retenciones (reteica y reteiva) según las siguientes variables:

- ✓ Estampilla Pro desarrollo Uniamazonía: 0.5%
- ✓ Estampilla Pro Adulto Mayor: 4%
- ✓ Estampilla Pro Cultura: 1%
- ✓ Estampilla Pro Electrificación Rural: 1%
- ✓ Estampilla Pro Justicia: 2%
- ✓ Estampilla Pro Deporte: 2%
- ✓ Rete Ica (De acuerdo a la actividad económica del RUT) ver acuerdo municipal número 015 de 2024 en la página <http://www.sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>
- ✓ Demás impuestos nacionales aplicables.

ENTREGA DE COTIZACIÓN:

De tener interés en presentar la cotización que aquí se requiere, deberá remitirla al correo electrónico desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Atentamente,


YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO
Secretaría de Inclusión Social



desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

SOLICITUD DE COTIZACION EQUIPOS BIOMEDICOS

Camilo andres Vega bautista <az.9camiloandresvega@gmail.com>

2 de septiembre de 2026 a las 11:53

Para: desarrollosocial desarrollosocial <desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

Buenas tardes de manera atenta me permito adjuntar la cotización solicitada.

Cordial saludo

El jue, 6 ago 2026 a las 17:48, desarrollosocial desarrollosocial (<desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>) escribió:

desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

 **COTIZACION ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE_COMERCILIZADORA JI_SUMINISTRO BIOMEDICO.pdf**
213K



Florencia, 11 de agosto de 2026

Señores:

Municipio de San Vicente del Caguán- Caquetá

Asunto: Cotización

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de presentar la siguiente cotización

I T E M	PRODUC TO	DESCRIPCIÓN	CAN TID AD	UN ID AD	PRE CIO UNI TAR IO	VR. TOTA L
1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Normas de Seguridad CE en conformidad con el Consejo Directivo 2007/47/CE relativo a los productos Médicos. IEC 60601-1 + A1 + A2, IEC 60601-1-2 + A1. Especificaciones Físicas: Dimensiones: 260 mm (L) x 140 mm (W) x 205 mm (H). Peso: Configuración Normal; 3.6 kg. Pantalla: TFT LCD a color de 8,4" (Pantalla táctil opcional). Resolución: 800 x 600 dpi. Numero de ondas: hasta 8. Visualización de formas de onda: hasta 11. Interfaz seleccionable: Pantalla estándar. Pantallas Letras grandes para cuidados intensivos. Representación de curvas, gráfico y tendencias. Visualización cama a cama en pantalla (opcional). Oxícardiorespirografia dinámico visto en pantalla. Interfaz de cálculo de dosis para medicamentos. Velocidad de barrido: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s Ambiente de operación: Temperatura: Almacenamiento 20-55°C Trabajo 5-40°C. Humedad: Almacenamiento 25%-93% (Sin condensación). Trabajo 25%-80%(Sin condensación). Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa: AC 100-240V, 50/60HZ Pmax: 80VA Batería interna de alimentación: Tipo: Batería recargable Litio. Voltaje: 14,8 V DC. Capacidad: 5000 mAh . Período de trabajo de la batería: Hasta 7 horas. Tiempo de carga<380 min Respiración: Método: La impedancia transtorácica. El modo de operación: Auto / Manual Rango de medición RR:	UNI DAD	1	\$ 10.804.000	\$ 10.804.000



Adultos: 0 ~ 120 rpm Neonato / pediátrico: 0 ~ 150 rpm Resolución: 1 rpm Alarma de umbral de Apnea: 10s, 15s, 20s (por defecto), 25s, 30s, 35s, 40s. Alarma: Sí, alarma acústica y visual eventos de alarma revocables. Ancho de banda: 0.2-2,5 Hz (-3 dB) Velocidad de barrido: 12,5 mm/s. ECG: Cables: 5 derivaciones y 3 derivaciones 3 derivaciones del cable: RA; LA; LL o R, L, F. 5 derivaciones del cable: RA; LA; RL, LL, V o R, L, N, F, Selección de cable: 3 derivaciones: I, II, III. derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. Ganancia seleccionable: x0.125, x0.25, x0.5, auto. Velocidad de barrido: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s ECG HR Gama: Adultos y pediátricos: 15-300bpm. Neonato: 15-350bpm. Resolución y precisión: +1 bpm 0 +-1% el que sea Filtros: Modo diagnóstico: 0.05-150Hz. Modo monitoreo: 0,5 a 40 Hz. Modo cirugía: 1-20Hz. Detección del segmento ST: Rango de medición: -2,0 mV ~ 2.0mV. Rango de alarma: -2,0 mV ~ 2.0mV. Segmento ST análisis de la arritmia y categorización. Alarmas: Alarma Audible y visuales anormal detectables IEC 60601-2-25; AAMI CE 11/EC 13; IEC 60601-2-27 NIBP: Método: Oscilométrico automático. Modos de funcionamiento: manual / automático / Medición automática intervalo de tiempo: Ajustable 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 minutos. Unidad de medida: mm CmH2O seleccionable. Tipo de medición: sistólica, diastólica, media Rango de presión para los adultos: Sistólica: 40 a 270 mmHg. Diastólica: 10 a 215 mmHg. Media: 20 a 235 mmHg. Rango de presión de Pediatría: Sistólica: 40 - 200 mmHg. Diastólica: 10-150 mmHg. Media: 20 a 165 mmHg. Rango de presión para los neonatos: Sistólica: 40 - 135 mmHg. Diastólica: 10-100 mmHg. Media: 20 - 110 mmHg. Prueba de fugas y calibración automática de la presión: Sí Protección contra presión excesiva. Resolución: 1 mm Hg. Precisión: Error medio máximo de ± 5 mmHg. Desviación estándar de ± 8 mm Hg. Alarma: sistólica, diastólica, media. PR de NIBP: Medida 40 ~ 240 latidos por minuto Resolución: 1 bpm. Precisión: ± 3bpm o 3% el que sea mayor. EDAN SpO2: Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: $\pm 2\%$ (70-100%, Adulto / Pediátrico). $\pm 3\%$ (70-100%, Neonato). PR Medición y Rango de alarma: 30 - 300bpm. Resolución: 1 ppm. Precisión: 2bpm. Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Nellcor SpO2 (opcional): Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: $\pm 2.3\%$ (70-100%, Adulto / Pediátrico). $\pm 3\%$-3.5% (70-100%, Neonato). Medición y Rango de alarma PR: 20 - 300 lpm. resolución: 1 bpm. Precisión: 3bpm (depende de la sonda). Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Temperatura (2 canales, una sonda de forma predeterminada)				
--	--	--	--	--



COMERCIALIZADORA JI
S.A.S

2	DOPPLER FETAL	Pantalla LCD de 4.5mm x 2.5mm. Dos opciones de brillo: Activo/Desactivo. Frecuencia de trabajo: 2/3MHz (+10%). Frecuencia nominal: 2MHz/3MHz. Modo de funcionamiento: CW (onda continua). Rangode FHR: 50/210lpm. Frecuencia de muestreo de audio: 4KHz. Duración de la grabación: 240 segundos. Reducción y filtración de ruido automático. Tiempo de funcionamiento: 8 horas. Tiempo de señal de actividad. Parámetro incorporado Tipo: AAR61.2V, NI-MH recargables. Tiempo de funcionamiento: 8 horas. Tiempo de carga: 4 horas. Adaptador cargador: Entrada: 100 a 240 VAC, 50/60Hz, 0, 2A. Peso: <300 g (incluidas las pilas).	UNI DAD	1	\$ 2.8 \$ 18. \$ 600	\$ 2.81 \$ 8.60 \$ 0
3	ELECTROCARDIOGRAFO	Pantalla TFT grande de alta resolución de 5,7" a color de 640 x 480 puntos. Teclado alfanumérico. Operación de un solo toque. Adquisición simultánea de 12 derivaciones. Detección mejorada de señal débil. Filtro integrado y tecnología anti-ruido. Algoritmo avanzado SEMIP para mediciones e interpretación automática. Impresora integrada para presentación de informe de 6 canales.	UNI DAD	1	\$ 13. \$ 124 \$.00	\$ 13.1 \$ 24.0 \$ 00
4	CAMILLA DIVAN FIJO	1. Diván con tendido fijo de un plano 2. Material de tubo en acero cold rolled 2*1 calibre 18 3. Patas con sus cuatro tapones plásticos 4. Tapizado en fácil limpieza y lavable 5. Grosor de colchoneta 5cm 6. Dimensión: Largo de 1,80m x ancho de 0,55m x alto de 0,80m 7. Pintura electrostática el terminado 8. Capacidad de carga: 100 - 150Kg	UNI DAD	1	\$ 896 \$.00 \$ 0	\$ 896. \$ 000 \$ 000
5	KIT DE SUTURA	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: portaagujas, tijera de mayo, tijera de tejido, pinza mosquito curva, pinza mosquito recta, pinza kelly curva	UNI DAD	1	\$ 1.4 \$ 34. \$ 078	\$ 1.43 \$ 4.07 \$ 8
6	KIT DE PARTO	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: tijera para episiotomia, pinza kelly recta, pinza mosquito curva y demás pinzas que componen el kit	UNI DAD	1	\$ 1.3 \$ 40. \$ 094	\$ 1.34 \$ 0.09 \$ 4
7	KIT INSERC	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: pinza tenaculo, histerometro, pinza rochester recta, tijera de mayo	UNI DAD	1	\$ 1.3 \$ 1.3	\$ 1.38 \$ 1.38



ION DE DIU		80.042	0.042
8 PESA BEBE	Capacidad: 20Kg, División: 5Gr<10Kg>10Gr, Mecanismo: Electrónica, Material: Acero y Plástico, Retorno a cero automático, Gr anparental al CD del 0,0 pulgada, Bandeja extraíble, para ubicar al infante de pie, Diseño de la plataforma de la gada Extreme, Celdad e cargade alta precisión, Fácil de operar 3 teclas funcionales, Función de bloqueo para el peso del bebé en movimiento, F unción para operar el peso del pañal y obtener el peso neto del bebé, Ahorro de energía función AUTO-OFF, Kg Unidad de selección lb, función aconbaterías 9v o adaptador de corriente a 110 voltios. Báscula grado médico.	UNI DAD 1	\$ 1.676.000
9 BASCULA DIGITAL ADULTO	1. Capacidad: 180 kg / División: 100g 2. Material: Plástico y acero 3. Dimensiones: 31 x 29,8 , 3,5 cm 4. Electrónica 5. Fuente de alimentación: 2 Pilas AAA 6. Display: LCD 7. Certificado de calibración 8. Registro INVIMA 9. Grado médico	UNI DAD 1	\$ 600.000
10 TENSIO METRO PEDIAT RICO	1 - Intervalo de 0-300mmHg 2 - Precisión de presión de ± 3 mmHg. 3 - División de escala de 2 mmHg. 4 - Brazaletes pediátricos libre de látex y lavable 5 - Pera con válvula 6 - Estuche protector para transporte 7 - Certificado de calibración	UNI DAD 1	\$ 200.000



N.º de LED : 1 LED blanco. Temperatura del color : 5.500 K Intensidad de la luz a distancia de trabajo : 20.000 lux a 30 cm (12 pulg). 15.000 lux a 50 cm (20 pulg). Tamaño del punto de la luz a distancia de trabajo : 16 cm a 30 cm (12 pulg), 15cm a 50cm (50 pulg). Dimensiones Físicas Alcance de la base móvil : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte de pared : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte al techo : n/a Techo arriba/abajo : n/a Artefacto de luz (alto/ ancho/largo) : 19/9/8cm, (7,48/ 3,45/3,15 pulg). Cuadro de control (alto/ancho/largo) : 27,5/10,0/8,0cm, (10,83/3,94/3,15 pulg). Base móvil (alto/diámetro) : 61 cm/53 cm, (24,02 pulg./ 20,87 pulg). Peso total del soporte de mesa/ pared : 5,56 kg (5,65 libras). Peso total de base móvil : 5,78 kg (12,75 libras). Especificaciones eléctricas Suministro eléctrico : entrada= 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx. Cable eléctrico : Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud. Encendido/apagado sin contacto Datos variados Opciones de montaje : base móvil, mesa pared, rail Tipo de extensión : Cuello de cisne/cuello de ganso Accesorios opcionales : n/a Vida útil : 50.000 horas	UNI DAD	\$ 600 600 0	\$ 600 600 000
1 LAMPAR 2 A 1 CUELLO 1 CISNE	UNI DAD	\$ 273 273 0	\$ 273 273 700
1 PULSOX 2 IMETRO	UNI DAD	\$ 273 273 0	\$ 273 273 700



1 3	GLUCOM ETRO	Eyector de tira • No requiere CODIFICACIÓN • Detección de llenado audible • Almacena 1.000 resultados con fecha y hora • Promedia 7,14,30, y 90 días • Alarmas recordatorias • SMART LOG® (software de control) • Sistema Bluetooth	UNI DAD	1	\$ 538 .00 0	\$ 538. 000
1 4	SUCCIO NADOR	Bomba libre de aceite (pistón libre de lubricación). Alta velocidad de flujo, con filtro bactericida. Recipiente: vidrio 2500 ml x 2 und reutilizables. Máximo vacío: 0.09Mpa (680 mmHg). Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40L/min. Intervalo de vacío ajustable: 0.02 - 0.09Mpa (150-680 mmHg). Nivel de ruido: 60 dB a 1 M. Potencia de trabajo: 250 VA. Requerimiento eléctrico: 220 V, 50/60 Hz, 250 VA Sistema de trabajo: Operación continúa con carga intermitente.	UNI DAD	1	\$ 4.3 86. 000	\$ 4.38 6.00 0
TOTAL						\$ 40. 070 .51 4



La presente cotización tiene una validez de 30 días a partir de la presente fecha. Todos nuestros precios incluyen IVA.

Atentamente

Camilo Vega
Camilo Andres Vega Bautista

Representante Legal



Desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

SOLICITUD DE COTIZACION EQUIPOS BIOMEDICOS

JAM LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S. <jamlogisticayserviciossas@gmail.com> 2 de septiembre de 2026 a las 11:40
Para: desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Muchas gracias por su interés en nuestros productos/servicios y por enviarnos su solicitud de cotización. Adjunto encontrará la cotización solicitada con el detalle de los productos/servicios, precios, condiciones comerciales y tiempo estimado de entrega.

Quedamos atentos a cualquier consulta, aclaración o modificación que requiera.

Cordialmente,



COTIZACION_ JAM LOGISTICA Y SERVICIOS SAS_PUESTO DE SALUD SAN VICENTE.pdf
306K



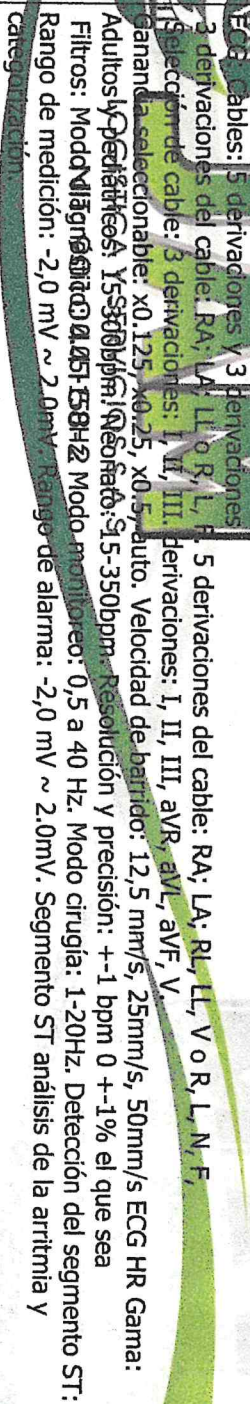
Florencia, 11 de agosto de 2026

Señores:
ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
 Departamento del Caquetá

Asunto: Respuesta a solicitud de Cotización

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de presentar la siguiente cotización:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Normas de Seguridad CE en conformidad con el Consejo Directivo 2007/47/CE relativo a los productos Médicos. IEC 60601-1 + A1 + A2, IEC 60601-1-2 + A1. Especificaciones Físicas: Dimensiones: 260 mm (L) x 140 mm (W) x 205 mm (H). Peso: Configuración Normal; 3.6 kg. Pantalla: TFT LCD a color de 8,4" (Pantalla táctil opcional). Resolución: 800 x 600 dpi. Numero de ondas: hasta 8. Visualización de formas de onda: hasta 11. Interfaz seleccionable: Pantalla estándar. Pantallas Letras grandes para cuidados intensivos. Representación de curvas, gráfico y tendencias. Visualización cama a cama en pantalla (opcional). Oxímetro de saturación de oxígeno dinámico visto en pantalla. Interfaz de cálculo de dosis para medicamentos. Velocidad de barrido: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s Ambiente de operación: Temperatura: Almacenamiento 20-55°C Trabajo 5-40°C. Humedad: Almacenamiento 25%-93% (Sin condensación). Trabajo 25%-80%(Sin condensación). Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa: AC 100-240V, 50/60HZ Pmax: 80VA Batería interna de la batería: Tipo: Batería recargable Litio. Voltaje: 14,8 V DC. Capacidad: 5000 mAh . Período de trabajo de la batería: Hasta 7 horas. Tiempo de carga <380 min Respiración: Método: La impedancia transtorácica. El modo de operación: Auto / Manual Rango de medición RR: Adultos: 0 ~ 120 rpm Neonato / pediátrico: 0 ~ 150 rpm Resolución: 1 rpm Alarma de umbral de Apnea: 10s, 15s, 20s (por defecto), 25s, 30s, 35s, 40s. Alarma: Sí, alarma acústica y visual eventos de alarma revocables. Ancho de banda: 0.2-2,5 Hz (-3 dB) Velocidad de barrido: 12,5 mm/s.	UNIDAD	1	\$ 10.263.800	\$ 10.263.800



UNIT	DA	D	1	\$	\$
				12.4	12.4
				67.8	67.8
				00	00



4	DIVAN FIJO	1. Divan con tendido fijo de un plano 2. Material de tubo en acero cold rolled 2*1 calibre 18 3. Patas con sus cuatro tapones plásticos 4. Tapizado en facil limpieza y lavable 5. Grosor de tela 1,5 mm 6. Dimensiones: 11,30m x 5,60m x 0,55m X alto de 0,80m 7. Pintura electrostática el terminado 8. Capacidad de carga: 100 - 150kg	UNI DA D	1	\$ 851. 200 851. 200
5	KIT DE SUTURA	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: portaagujas, tijera de mayo, tijera de tejido, pinza mosquito curva, pinza mosquito recta, pinza kely curva	UNI DA D	1	\$ 1.36 2.37 1.36 2.37 2.37 4 4
6	KIT DE PARTO	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: tijera para episiotomia, pinza kelly recta, pinza mosquito curva y demas pinzas que componen el kit	UNI DA D	1	\$ 1.27 3.08 1.27 3.08 3.08 9 9
7	KIT INSERCION DE DIU	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: pinza tenaculo, histerometro, pinza rochester recta, tijera de mayo	UNI DA D	1	\$ 1.31 1.04 1.31 1.04 1.04 0 0
8	PESA BEBE	Capacidad: 20Kg, División: 5Gr < 10Kg > 10Gr, Mecanismo: Electrónica, Material: Acero y Plástico, Retorno a cero automático, Gran pantalla LCD de 1,0 pulgada, Bandeja extraíble, para ubicar al infante de pie, Diseño de la plataforma delgada Extreme, Celdas de carga de alta precisión, Fácil de operar 3 teclas funcionales, Función de bloqueo para bloquear el peso del bebé en movimiento, Función de alarma de peso OFF, Kg Unidades seleccionables, Función de alarma de batería baja adaptador de corriente a 110 voltios. Báscula graduada medico.	UNI DA D	1	\$ 1.59 2.20 1.59 2.20 2.20 0 0
9	BASCU LA DIGITAL ADULTO	1. Capacidad: 180 kg / División: 100g 2. Material: Plástico y acero 3. Dimensiones: 31 x 29,8 , 3,5 cm 4. Electrónica 5. Fuente de alimentación: 2 Pilas AAA 6. Display: LCD 7. Certificado de calibración 8. Registro INVIMA 9. Grado médico	UNI DA D	1	\$ 570. 000 570. 000
10	TENSIO METRO PEDIAT RICO	1 - Intervalo de 0-300mmHg 2 - Precisión de presión de ± 3 mmHg. 3 - División de escala de 2 mmHg. 4 - Brazaletes pediátricos libre de látex y lavable 5 - Pera con válvula 6 - Estuche protector para transporte 7- Certificado de calibración	UNI DA D	1	\$ 190. 000 190. 000



1 1 CUELLO CISNE	LAMPAR A CUELLO CISNE Temperatura de LED : 1 LED blanco. Temperatura del color : 5.500 K Intensidad de la luz a distancia de trabajo : 20.000 lux a 30 cm (12 pulg). 15.000 lux a 50 cm (20 pulg). Alcance de la luz a distancia de trabajo : 16 cm a 30 cm (12 pulg), 15cm a 50cm (50 pulg). Dimensiones: 19,9/9,8cm, (7,48/ 3,45/3,15 pulg) Alcance de la base móvil : 61 cm/53 cm, (24,02 pulg./ 20,87 pulg). Alcance del soporte de pared : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte al techo : n/a Techo arriba/abajo : n/a Artefacto de luz (alto/ ancho/largo) : 19/9/8cm, (7,48/ 3,45/3,15 pulg). Cuadro de control (alto/ ancho/largo) : 27,5/10,0/8,0cm, (10,83/3,94/3,15 pulg). Base móvil (alto/diámetro) : 61 cm/53 cm, (24,02 pulg./ 20,87 pulg). Peso total del soporte de mesa/ pared : 5,56 kg (5,65 libras). Peso total de base móvil : 5,78 kg (12,75 libras). Especificaciones eléctricas Suministro eléctrico : entrada= 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx. Cable eléctrico : Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud. Encendido/apagado sin contacto Datos variados Opciones de montaje : base móvil, mesa pared, rail Tipo de extensión : Cuello de cisne/cuello de ganso Accesorios opcionales : n/a Vida útil : 50.000 horas	UNI DA D	1	\$ 570.000	\$ 570.000
1 2 PULSOX IMETRO	PULSOX IMETRO Características: • pulsoxiómetro con sensor tipo de integración para medición de saturación de oxígeno (SpO2) y frecuencia cardíaca (fc) con visualización de curva de pulso. • interfaz de pantalla con cuenta regresiva automática en 4 direcciones. • especificaciones técnicas: • alimentación: 1.5v • rango de medición: 35-100% • resolución: 1% • precisión: 2% • rango de frecuencia cardíaca: 30-250 lpm • resolución: 1 lpm • precisión: 2 lpm • dimensiones: 74mm(l) x 37mm(w) x 38mm(h) • peso: 50g (baterías incluidas) • accesorios: • banda de fijación para el cuello. • 2 pilas AAA • manual de uso	UNI DA D	1	\$ 260.015	\$ 260.015
1 3 GLUCO METRO	GLUCO METRO Eyector de tira • No requiere CODIFICACIÓN • Detección de llenado audible • Almacena 1.000 resultados con fecha y hora • Promedia 7,14,30, y 90 días • Alarmas recordatorias • SMART LOG® (software de control) • Sistema Bluetooth	UNI DA D	1	\$ 511.100	\$ 511.100



Bomba libre de aceite (pistón libre de lubricación).
Alta velocidad de flujo, con filtro bactericida.
Un recipiente: vidrio 2500 ml x 2 und reutilizables.
Máximo vacío: 0.09 Mpa (680 mmHg).
Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40 l/min.
Intervalo de vacío ajustable: 0.15 a 0.09 Mpa (150-680 mmHg).
Nivel de ruido: 60 dB a 1 M.
Potencia de trabajo: 250 VA.
Requerimiento eléctrico: 220 V, 50/60 Hz, 250 VA
Sistema de trabajo: Operación continua con carga intermitente.

1 SUCCIO
4 NADOR

UNIT
DA
D

\$ 4.16
4.16
6.70
0 0

\$ TO 38.
TA 066
L .98
8

La presente cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de la presente fecha.


ANGELA MARIA TERRANOVA TOLEDO
Representante Legal
C.C.: 1.032.438.492 de Bogotá



desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

SOLICITUD DE COTIZACION EQUIPOS BIOMEDICOS

COMERCIALIZADORA MAXIUNIVERSAL A&M

2 de septiembre de 2026 a las

<comercializadoramaxiuniversal@gmail.com>

12:16

Para: desarrollosocial desarrollosocial <desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

Buenos tardes.

De manera atenta me permito dar respuesta al correo que antecede adjunta la cotización solicitada.

Cordial saludo

El jue, 6 ago 2026 a las 17:48, desarrollosocial desarrollosocial (<desarrollosocial@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>) escribió:

Adjunto a este correo se encuentra el archivo adjunto.



COTIZACION MAXIUNIVERSAL_SUMINISTRO BOIMEDICO_SAN VICENTE DEL CAGUAN.pdf

165K



NIT. 900.672.532-4

SOLICITUD DE COTIZACION

Florencia Caquetá, 11 de agosto de 2026

Señores
ALCALDIA DE SAN VICENTE-CAQUETA
La Ciudad

Asunto: COTIZACION

I T E M	PRODU CTO	DESCRIPCIÓN	CA NTI DA D	U NI DA D	PR EC IO	PR ECI O TO TAL
1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Normas de Seguridad CE en conformidad con el Consejo Directivo 2007/47/CE relativo a los productos Médicos. IEC 60601-1 + A1 + A2, IEC 60601-1-2 + A1. Especificaciones Físicas: Dimensiones: 260 mm (L) x 140 mm (W) x 205 mm (H). Peso: Configuración Normal; 3.6 kg. Pantalla: TFT LCD a color de 8,4" (Pantalla táctil opcional). Resolución: 800 x 600 dpi. Numero de ondas: hasta 8. Visualización de formas de onda: hasta 11. Interfaz seleccionable: Pantalla estándar. Pantallas Letras grandes para cuidados intensivos. Representación de curvas, gráfico y tendencias. Visualización cama a cama en pantalla (opcional). Oxícardiorespirografía dinámico visto en pantalla. Interfaz de cálculo de dosis para medicamentos. Velocidad de barrido: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s Ambiente de operación: Temperatura: Almacenamiento 20-55°C Trabajo 5-40°C. Humedad: Almacenamiento 25%-93% (Sin condensación). Trabajo 25%-80%(Sin condensación). Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa: AC 100-240V, 50/60HZ Pmax: 80VA Batería interna de alimentación: Tipo: Batería recargable Litio. Voltaje: 14,8 V DC. Capacidad: 5000 mAh . Período de trabajo de la batería: Hasta 7 horas. Tiempo de carga<380 min Respiración: Método: La impedancia transtorácica. El modo de operación: Auto / Manual Rango de medición RR: Adultos: 0 ~ 120 rpm Neonato / pediátrico: 0 ~ 150 rpm Resolución: 1 rpm Alarma de umbral de Apnea: 10s, 15s, 20s (por defecto), 25s, 30s, 35s, 40s. Alarma: Sí, alarma acústica y visual eventos de alarma revocables. Ancho de banda: 0.2-2.5 Hz (-3 dB) Velocidad de barrido: 12,5 mm/s.	UNI DA D	1	\$ 11.132.658	\$ 11.132.658

Dirección: Calle 14 número 10 - 05 barrio Centro
Email: comercializadormaxiversal@gmail.com

NIT. 900.672.532-4

	ECG: Cables: 5 derivaciones y 3 derivaciones 3 derivaciones del cable: RA, LA, LL o R, L, F. 5 derivaciones del cable: RA, LA, RL, LL, V o R, L, N, F, Selección de cable: 3 derivaciones: I, II, III. derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. Ganancia seleccionable: x0.125, x0.25, x0.5, auto. Velocidad de barrido: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s ECG HR Gamma: Adultos y pediátricos: 15-300bpm. Neonato: 15-350bpm. Resolución y precisión: ± 1 bpm 0 $\pm 1\%$ el que sea Filtros: Modo diagnóstico: 0.05-150Hz. Modo monitoreo: 0.5 a 40 Hz. Modo cirugía: 1-20Hz. Detección del segmento ST: Rango de medición: -2,0 mV $\sim$ 2.0mV. Rango de alarma: -2,0 mV $\sim$ 2.0mV. Segmento ST análisis de la arritmia y categorización. Alarmas: Alarma Audible y visuales anormal detectables IEC 60601-2-25; AAMI CE 11/EC 13; IEC 60601-2-27 NIBP: Método: Oscilométrico automático. Modos de funcionamiento: manual / automático / Medición automática intervalo de tiempo: Ajustable 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 minutos. Unidad de medida: mm CmH2O seleccionable. Tipo de medición: sistólica, diastólica, media Rango de presión para los adultos: Sistólica: 40 a 270 mmHg. Diastólica: 10 a 215 mmHg. Media: 20 a 235 mmHg. Rango de presión de Pediatría: Sistólica: 40 - 200 mmHg. Diastólica: 10-150 mmHg. Media: 20 a 165 mmHg. Rango de presión para los neonatos: Sistólica: 40 - 135 mmHg. Diastólica: 10-100 mmHg. Media: 20 - 110 mmHg. Prueba de fugas y calibración automática de la presión: Sí Protección contra presión excesiva. Resolución: 1 mm Hg. Precisión: Error medio máximo de ± 5 mmHg. Desviación estándar de ± 8 mm Hg. Alarma: sistólica, diastólica, media. PR de NIBP: Medida 40 $\sim$ 240 latidos por minuto Resolución: 1 bpm. Precisión: ± 3bpm o 3% el que sea mayor. EDAN SpO2: Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: $\pm 2\%$ (70-100%, Adulto / Pediátrico). $\pm 3\%$ (70-100%, Neonato). PR Medición y Rango de alarma: 30 - 300bpm. Resolución: 1 ppm. Precisión: 2bpm. Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Nellcor SpO2 (opcional): Rango de medición y alarma: 0 - 100%. Resolución: 1%. Precisión: $\pm 2.3\%$ (70-100%, Adulto / Pediátrico). $\pm 3\%$-3.5% (70-100%, Neonato). Medición y Rango de alarma PR: 20 - 300 bpm. resolución: 1 bpm. Precisión: 3bpm (depende de la sonda). Frecuencia de actualización: 1s. ISO 9919 Temperatura (2 canales, una sonda de forma predeterminada)				
--	--	--	--	--	--

NIT. 900.672.532-4

2	DOPPLER FETAL	Pantalla LCD de 45mm x 25mm Dos opciones de brillo: Activado/desactivado Frecuencia de trabajo: 2/3MHz ($\pm 10\%$) Frecuencia nominal: 2MHz/3MHz Modo de funcionamiento: CW (onda continua) Rango de FHR: 50/210bpm Frecuencia de muestreo de audio: 4KHz Duración de la grabación: 240 segundos Reducción de ruido Automático tras un minuto sin señal de actividad. Parlante incorporado Tipo: AAR61.2V, NI-MH recargables Tiempo de funcionamiento: 8 horas Tiempo de carga: 4 horas Adaptador cargador: Entrada: 100 a 240 VAC, 50/60Hz, 0, 2A Peso: <300 g (incluidas las pilas)	UNI DA D	1	\$ 2.9 59.530	\$ 2.9 59.530
3	ELECTROCARDIOGRAFO	Pantalla TFT grande de alta resolución de 5,7" a color de 640 x 480 puntos. Teclado alfanumérico. Operación de un solo toque. Adquisición simultánea de 12 derivaciones. Detección mejorada de señal débil. Filtro integrados y tecnología anti-ruido. Algoritmo avanzado SEMIP para mediciones e interpretación automática. Impresora integrada para presentación de informe de 6 canales.	UNI DA D	1	\$ 13.780 20.000	\$ 13.780 20.000
4	CAMILLA DIVAN FIJO	1. Diván con tendido fijo de un plano 2. Material de tubo en acero cold rolled 2"x1 calibre 18 3. Patas con sus cuatro tapones plásticos 4. Tapizado en fácil limpieza y lavable 5. Grosor de colchoneta 5cm 6. Dimensión: Largo de 1,80m x ancho de 0,55m x alto de 0,80m 7. Pintura electrostática el terminado 8. Capacidad de carga: 100 - 150Kg	UNI DA D	1	\$ 940 80.000	\$ 940 80.000
5	KIT DE SUTURA	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: portaagujas, tijera de mayo, tijera de tejido, pinza mosquito curva, pinza mosquito recta, pinza kely curva	UNI DA D	1	\$ 1.505.782	\$ 1.505.782
6	KIT DE PARTO	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: tijera para episiotomía, pinza kelly recta, pinza mosquito curva y demás pinzas que componen el kit	UNI DA D	1	\$ 1.407.099	\$ 1.407.099
7	KIT INSERC	MATERIAL: acero inoxidable compuesto por: pinza tenaculo, histerometro, pinza rochester recta, tijera de mayo	UNI DA D	1	\$ 1.41.4	\$ 1.41.4

NIT. 900.672.532-4

ION DE DIU	Capacidad: 20Kg, División: 5Gr < 10Kg > 10Gr, Mecanismo: Electrónica, Material: Acero y Plástico, Retorno a cero automático, Gran pantalla LCD de 1,0 pulgada, Bandeja extraíble, para ubicar al infante de pie, Diseño de la plataforma delgada Extreme, Celdas de carga de alta precisión, Fácil de operar 3 teclas funcionales, Función de bloqueo para bloquear el peso del bebé en movimiento, Función de alarma para el OFF, Kg/Unidad de selección de la función de ahorro de energía función AUTO-	UNI DA D	1	\$ 1.7 59. 800	\$ 1.7 59. 800
8 PESA BEBE	1. Capacidad: 180 kg / División: 100g 2. Material: Plástico y acero 3. Dimensiones: 31 x 29,8 , 3,5 cm 4. Electrónica 5. Fuente de alimentación: 2 Pilas AAA 6. Display: LCD 7. Certificado de calibración 8. Registro INVIMA 9. Grado médico	UNI DA D	1	\$ 630 .00 0	\$ 630 .00 0
9 BASCULA DIGITAL ADULTO	1 - Intervalo de 0-300mmHg 2 - Precisión de presión de ± 3 mmHg. 3 - División de escala de 2 mmHg. 4 - Brazaletes pediátrico libre de látex y lavable 5 - Pera con válvula 6 - Estuche protector para transporte 7 - Certificado de calibración	UNI DA D	1	\$ 210 .00 0	\$ 210 .00 0
1 TENSIO METRO PEDIAT RICO					

NIT. 900.672.532-4

1 LAMPAR A CUELLO CISNE	N.º de LED : 1 LED blanco. Temperatura del color : 5.500 K Intensidad de la luz a distancia de trabajo : 20.000 lux a 30 cm (12 pulg). 15.000 lux a 50 cm (20 pulg). Tamaño del punto de la luz a distancia de trabajo : 16 cm a 30 cm (12 pulg), 15cm a 50cm (50 pulg). Dimensiones Físicas Alcance de la base móvil : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte de pared : 79 cm (30,1 pulg). Alcance del soporte al techo : n/a Techo arriba/abajo : n/a Artefacto de luz (alto/ancho/largo) : 19/9/8cm, (7,48/ 3,45/3,15 pulg). Cuadro de control (alto/ancho/largo) : 27,5/10,0/8,0cm, (10,83/3,94/3,15 pulg). Base móvil (alto/diámetro) : 61 cm/53 cm, (24,02 pulg./ 20,87 pulg). Peso total del soporte de mesa/ pared : 5,56 kg (5,65 libras). Peso total de base móvil : 5,78 kg (12,75 libras). Especificaciones eléctricas Suministro eléctrico : entrada= 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx. Cable eléctrico : Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud. Encendido/apagado sin contacto Datos variados Opciones de montaje : base móvil, mesa pared, rail Tipo de extensión : Cuello de cisne/cuello de ganso Accesorios opcionales : n/a Vida útil : 50.000 horas	UNI DA D 1	\$ 630 .00 0	\$ 630 .00 0
1 PULSOX 2 IMETRO	Características: •pulsoximetroconsortipodeointegradoparamedición desaturación de oxígeno (spo2) y frecuencia cardíaca (fc) con visualización de curvas y pletoisnografía. •es un dispositivo pequeño y portátil, cuenta con iluminación intensa de pantalla led para una adecuada visibilidad de pulso, la interfaz de la pantalla cuenta con giro automático en 4 direcciones. especificaciones técnicas: •alimentación: 2 baterías aa 1,5v •rango de medidas po2: 35-100% •resolución: 1% •precisión: 2% •rango de frecuencia cardíaca: 30-250 lpm •resolución: 1 lpm •precisión: 2 lpm •dimensiones: 74mm(l) x 37mm(w) x 38mm(h) •peso: 50g (baterías incluidas) accesorios: •banda de fijación para el cuello. •2 pilas aa •manual de uso	UNI DA D 1	\$ 287 .38 5	\$ 287 .38 5

NIT. 900.672.532-4

1 3	GLUCO METRO	Eyector de tira • No requiere CODIFICACIÓN • Detección de llenado audible • Almacena 1.000 resultados con fecha y hora • Promedia 7,14,30, y 90 días • Alarmas recordatorias • SMART LOG® (software de control) • Sistema Bluetooth	UNI DA D	1	\$ 564 .90 0	\$ 564 .90 0
1 4	SUCCIO NADOR	Bomba libre de aceite (pistón libre de lubricación). Alta velocidad de flujo, con filtro bactericida. Recipiente: vidrio 2500 ml x 2 und reutilizables. Máximo vacío: 0.09Mpa (680 mmHg). Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40L/min. Intervalo de vacío ajustable: 0.02 – 0.09Mpa (150-680 mmHg). Nivel de ruido: 60 dB a 1 M. Potencia de trabajo: 250 VA. Requerimiento eléctrico: 220 V, 50/60 Hz, 250 VA Sistema de trabajo: Operación continúa con carga intermitente.	UNI DA D	1	\$ 4.6 05. 300	\$ 4.6 05. 300
					\$ 41. TA L	\$ 41. TA L

ANGIE MONTILLA
COMERCIALIZADORA MAXIUNIVERSAL A&M S.A.S.
 NIT.900.672.532-4

Rep. Anyi Lizeth Vargas
[Email:comercializadoramaxiuniversal@gmail.com](mailto:comercializadoramaxiuniversal@gmail.com)

Dirección: Calle 14 número 10 - 05 barrio Centro
 Email: comercializadoramaxiuniversal@gmail.com