INGEODER PHARMA	INGEODER PHARMA S.A.S Nit 900,920,627-1 / Régimen Común	CODIGO: LC-FOR-05
	PROCESO LICITACION Y COTIZACIÓN	VERSION N°03
	COTIZACIÓN	FECHA: 11-01-2025

LINEA COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

FECHA: martes, 15 de septiembre de 2026
EMPRESA: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
NIT: 891.180.268
CONTACTO: DR. JUAN DIEGO FIERRO OLIVEROS
DIRECCION: CALLE 9 No. 15-25
CIUDAD: NEIVA-HUILA
TELEFONO: 8715907
CORREO: suministros.medicamentos@huhmp.gov.co

COTIZACION	
No.	2737

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION OFERTADA	MARCA	CANTIDAD	VR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VR IVA	VR UNIT + IVA	VR TOTAL CON IVA
1	TERMOHIGROMETRO	TERMOHIGROMETRO REF DC103 + CALIBRACION	DIGITAL SERIES	38	$ 169.231	19	$ 32.154	$ 201.385	$ 7.652.626
2	PHMETRO PORTATIL DE LABORATORIO	MEDIDOS DE PH Y TEMPERATURA REF:LAQUATWIN PH33 GARANTIA: 1AÑO	HORIBA	1	$ 1.630.000	19	$ 309.700	$ 1.939.700	$ 1.939.700
3	PULSOXIMETRO	PULSOXIMETRO REF:H100B GARANTIA: 1AÑO	EDAN	1	$ 1.058.182	19	$ 201.055	$ 1.259.237	$ 1.259.237

TOTAL	$ 10.851.562

Forma de Pago: SEGÚN ACUERDO
Consignar a: INGEODER PHARMA SAS CTA AHORROS 07652891025 BANCOLOMBIA
Validez Oferta: 30 DIAS
Tiempo entrega: 3-5 DIAS HABILES
Observacion:

MANUEL ENRIQUE TRIANA HERRERA
Gerente

Elaboró:
Nombre: MOHORA MOTTA
Cargo Analista de Licitaciones

www.novamedicasas.com
Este catálogo esta diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

Oximetro de Pulso
H100B



Características

Pantalla LCD **retroiluminada.**

Apto para paciente **adulto, pediátrico y neonatal.**

hasta **48 hrs** de funcionamiento continuo.

- Diseño compacto y ligero (165 g sin baterías)
- Alarmas configurables en 3 niveles (bajo, medio, alto) para mayor seguridad del paciente
- Carcasa resistente a salpicaduras (IP22) y golpes ligeros
- Memoria interna con almacenamiento de tendencias: guarda registros continuos de SpO_2 y frecuencia cardíaca por varias horas

Áreas de uso

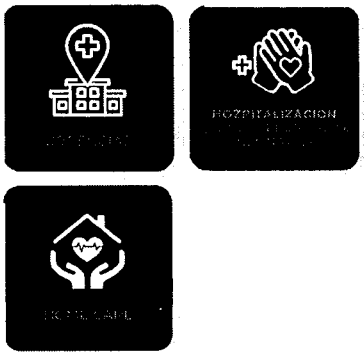

CE 0123

Especificaciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

Novamedica

www.novamedicasas.com
Este catálogo esta diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

Oximetro de Pulso
H100B

Monitoreo Seguro y Eficiente para Pacientes de Todas las Edades

El H100B es una solución confiable y portátil para **monitoreo de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso** en pacientes de todas las edades. Gracias a su diseño compacto y **autonomía de hasta 48 hrs,** es ideal para uso hospitalario y atención domiciliaria.

Su **pantalla LCD retroiluminada** de alta visibilidad permite una **lectura rápida de SpO_2 y frecuencia cardíaca** en cualquier entorno, incluso en condiciones de baja iluminación. Las alarmas audibles y configurables en tres niveles aseguran **respuesta oportuna ante eventos críticos.**

Con la **opción de baterías recargables** y base cargadora, el H100B ofrece una alternativa para instituciones que requieren monitoreo continuo, reduciendo la necesidad de baterías desechables y **optimizando recursos.**



EDAN

CE 0123

Especificaciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

Novamedica

www.novamedicasas.com
Este catálogo esta diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

Oximetro de Pulso H100B

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

Especificaciones físicas:
▸ Dimensiones: 160 mm (largo) × 70 mm (ancho) × 37.6 mm (alto)
▸ Peso: 165 g (sin batería)

▸ Pantalla: LCD de matriz de puntos de 128×64, con iluminación de fondo blanca por LED
Visualización de:
Modo numérico de caracteres grandes: SpO2, FP y gráfico de barras.
Modo de onda: SpO2, FP, gráfico de barras y pletismograma.

Especificaciones de seguridad:
▸ Conforme a las normativas:
IEC 60601-1:2005+A1:2012,
EN 60601-1: 2006+A1: 2013,
IEC 60601-1- 2: 2014,
EN 60601-1- 2: 2015,
ISO 80601-2- 56: 2017+A1:2018,
ISO 80601-2-61:2017

▸ Tipo de protección: Equipo con fuente de alimentación interna
▸Grado de protección: Pieza aplicada tipo BF
▸ Protección contra infiltración: IP22.
▸ Modo de trabajo: Funcionamiento continuo.
▸ Grado de seguridad en presencia de gases inflamables: No es apto para su uso en presencia de gases inflamables.

Especificaciones ambientales:
Funcionamiento:
▸ Temperatura: 0°C ~ + 40°C (32°F~104°F)
▸ Humedad relativa: 15% RH ~ 95% RH (sin condensación)
▸ Presión atmosférica: 70 kPa a 106 kPa.

Almacenamiento:
▸ Temperatura: -25°C~ +70°C (-13°F~158°F)
▸ Humedad relativa: 15% RH ~ 95% RH (sin condensación)
▸ Presión atmosférica: 70 kPa a 106 kPa

Especificaciones de alimentación:
Baterías Alcalinas:
▸ Tipo de batería: AA
▸ Cantidad: 4
▸ Tensión nominal: 10.8V.
▸ Capacidad nominal: 2600 mAh
▸ Tiempo de funcionamiento: 48hrs o más (a 25°C, con baterías nuevas totalmente cargadas, medición de SpO2en curso, retroiluminación apagada, volumen de pulso especificado en 3, volumen de alarma especificado en 3 (sin activación de alarma)

Paquete de baterías recargables de Ni-MH (Opcional con base cargador)
▸ Ciclos de carga/descarga: ≥500 veces
Cantidad: 1
▸ Voltaje nominal total: 4,8 V
▸ Capacidad: 1500 mAh
▸ Duración típica de las baterías: 30hrs o más (a 25°C, con baterías nuevas totalmente cargadas, medición de SpO2en curso, retroiluminación apagada, volumen de pulso especificado en 3, volumen de alarma especificado en 3 (sin activación de alarma)
▸ Tiempo de carga: No más de 2,5h al 80%No más de 4h al 100%

Especificaciones de funcionamiento:
Parámetros:
▸ Rango de medición SpO2: 0% ~ 100%
▸ Resolución de SpO2: 1%
▸ Resolución de ppm: 1 ppm
▸ PR: 25ppm a 300ppm
▸ Precisión de SpO2:
Adultos y pediátricos ±2% (70%~ 100%), Indefinido (0 %~ 69 %)
Recién nacidos ±3% (70%~ 100%), Indefinido (0 %~ 69 %)
▸ Precisión de la frecuencia del pulso: 25ppm a 300ppm±2 ppm
▸ Rango de alarma de SpO2: 0% ~ 100%PR0ppm a 300ppm
▸ Sensor SpO2 sensor:
Luz roja (660±3) nm
Luz infrarroja (905±10) nm
Energía de la luz emitida<15mW

▸ Alarmas: Tres niveles de alarmas audibles y visuales (bajo, medio alto), Ajuste de pausas para alarmas de 30, 60 , 90, 120 seg.

▸ Almacenamiento de Datos: Hasta 100 pacientes y 300 horas de datos.

Accesorios incluidos:
▸ Sensor SPO2 adulto reusable
▸ Correa
▸ Estuche.
▸ Baterías alcalinas AA
▸ Manual de usuario

Accesorios opcionales:
▸ Cobertor plástico
▸ Base cargador
▸ Baterías recargables de Ni-MH de 4,8 V
▸ Sensor SPO2 pediátrico y neonatal reusable

CE 0123

Este catalogo esta diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

Preguntas Frecuentes.

1. ¿Cuenta con alarmas configurables?

Sí, permite programar límites de SpO_2 y frecuencia cardíaca, con alarmas audibles y visuales en tres niveles de prioridad.

2. ¿Cuánto dura la batería en uso continuo?

Hasta 48 h con baterías alcalinas. También está disponible la opción de baterías recargables Ni-MH con base cargadora, que asegura energía constante y reduce costos de reemplazo.

3. ¿Es portátil para uso domiciliario?

Definitivamente. Su peso ligero, autonomía prolongada y estuche de transporte lo hacen ideal para monitoreo ambulatorio o en casa.

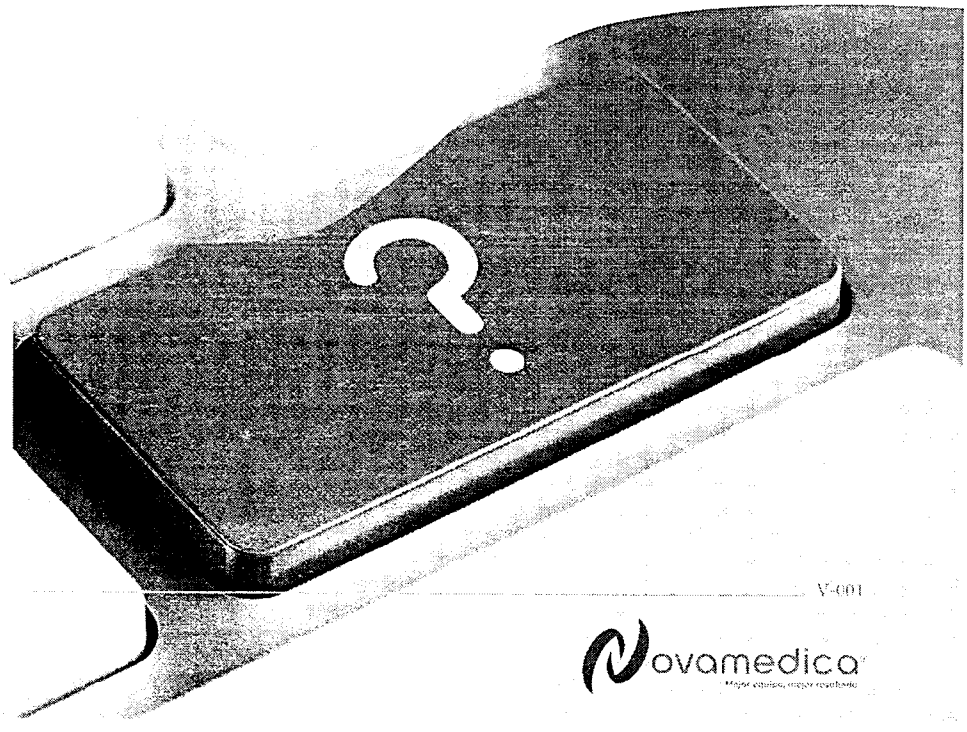

¡No te pierdas nada de lo que hacemos!

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al día con promociones exclusivas, novedades y actualizaciones sobre tecnología médica.

@novamedicasas

#somostualiado

Novamedica

HORIBA
Scientific

LAQUA

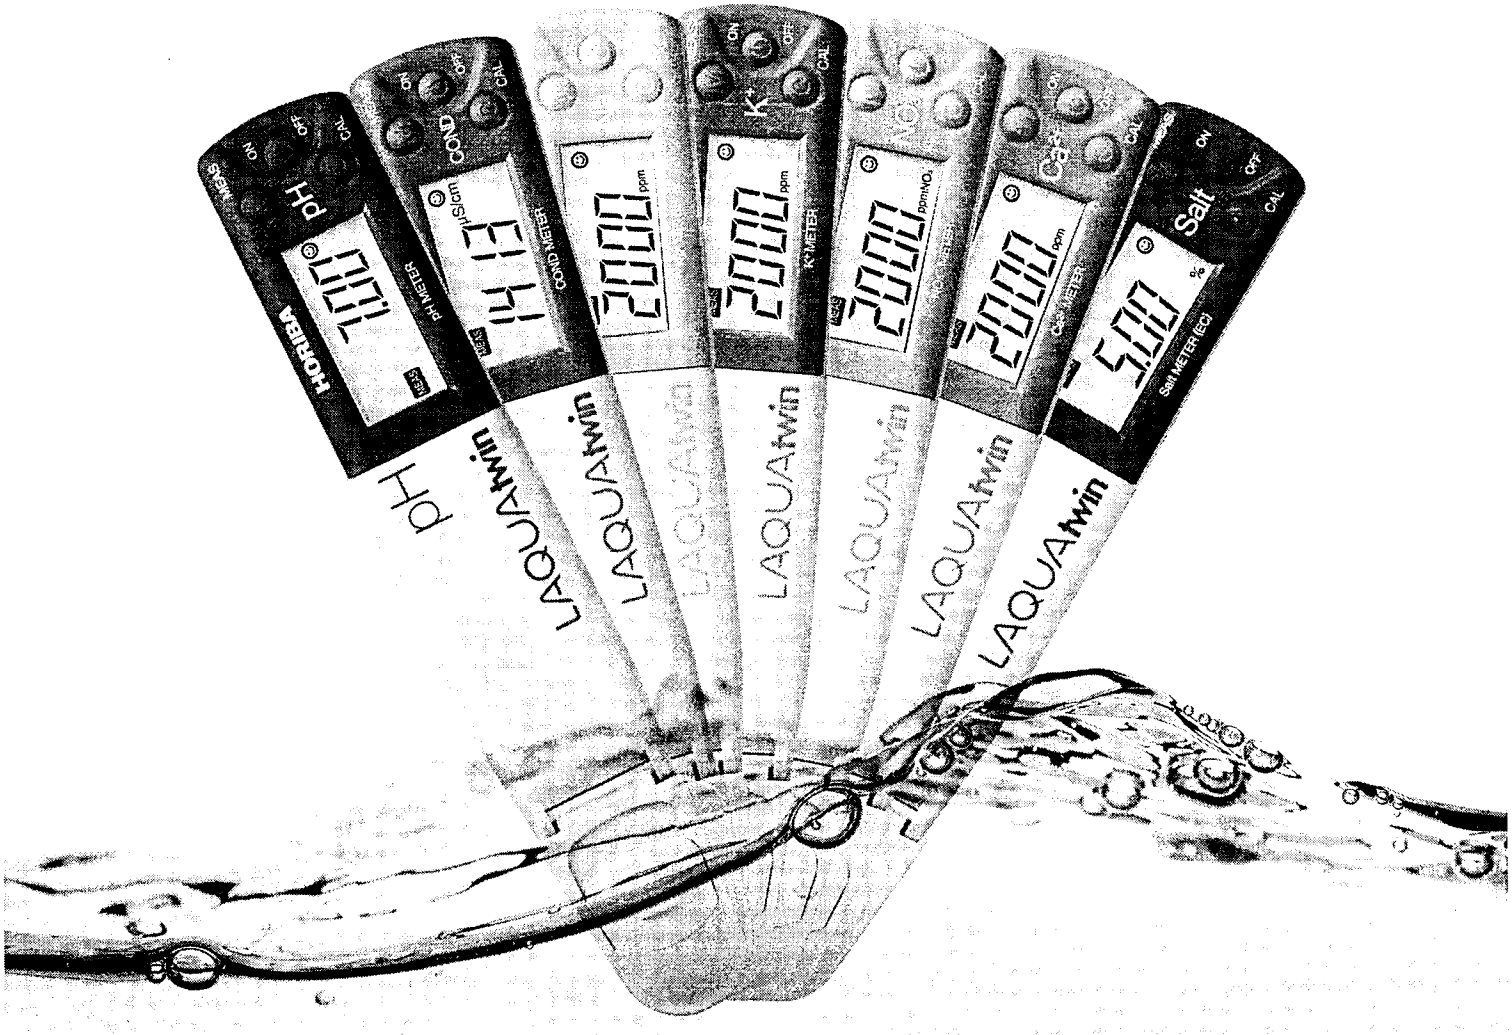

Agricultura | Acuicultura | Artes | Industria agroalimentaria | Monitoreo de la salud | Ganado | Proceso de fabricación | Aguas potables y residuales

Medidores de bolsillo de la calidad del agua

2 YEAR WARRANTY

MADE IN JAPAN

www.horiba-laqua.com

LAQUAtwin

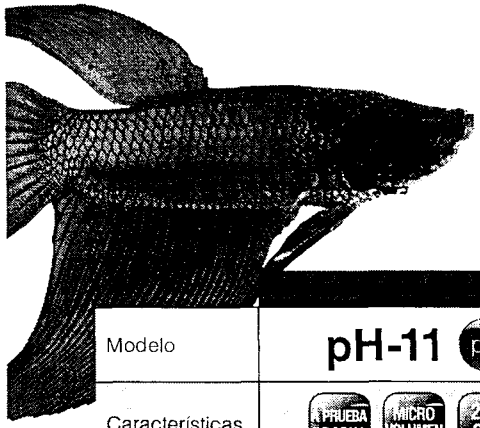

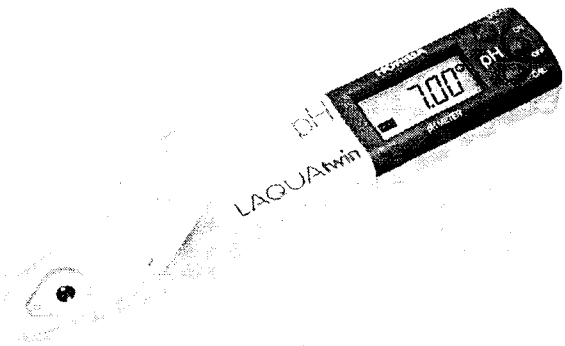

	pH		
Modelo	pH-11 (pH) (mV)	pH-22 (pH) (mV)	pH-33 (pH) (mV) (Temp)
Características	A PRUEBA DE AGUA · MICRO VOLUMEN · 2 PT CAL · 0.1 pH	A PRUEBA DE AGUA · MICRO VOLUMEN · 3 PT CAL · 0.01 pH	A PRUEBA DE AGUA · MICRO VOLUMEN · 5 PT CAL · 0.01 pH
Referencia	3999960122	3999960123	3999960124
Principio de medición	Electrodo de vidrio		
Volumen mínimo de la muestra	0.1 ml (50 µl con papel de muestreo B)		
pH: rango de medición / Resolución	0.0 a 14.0 pH / 0.1 pH	0.00 a 14.00 pH / 0.01 pH	
Precisión	± 0.1 pH	± 0.01 pH	
Puntos de calibración	2	3	5
Curvas de calibración	USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 & 12.46 NIST: 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 & 12.46		
mV: rango de medición / Resolución	± 650 mV / 1 mV		
Rango de temperatura / Resolución	—		0 a 50.0 °C / 0.1 °C
Funciones	Reconocimiento automático de buffer • Compensación automática de temperatura • Calibración de la temperatura* • Auto Hold / Auto Estable • Apagado automático (30 minutos) • Indicador de pila baja • IP67, a prueba de agua y polvos • Sensor reemplazable		
Pantalla	LCD digital personalizable (monocromática) con retroiluminación		
Temperatura/ humedad de funcionamiento	De 5 a 40°C, 85 % o menos de humedad relativa (sin condensación)		
Duración de las pilas	Aprox. 400 horas en uso continuo sin retroiluminación		
Material carcaza	Epoxi ABS / electrodo de vidrio		
Dimensiones	164 mm x 29 mm x 20 mm (sin incluir salientes)		
Peso	Aprox. 55 g (incluyendo sensor y pilas)		
Accesorios incluidos	Soluciones de calibración pH 7.00 & 4.01 (14 ml cada uno) • Pilas CR2032 (2) • Pipeta • Manual de instrucción y manual rápido • Estuche		

*Aplicable con modelos con visualización de temperatura



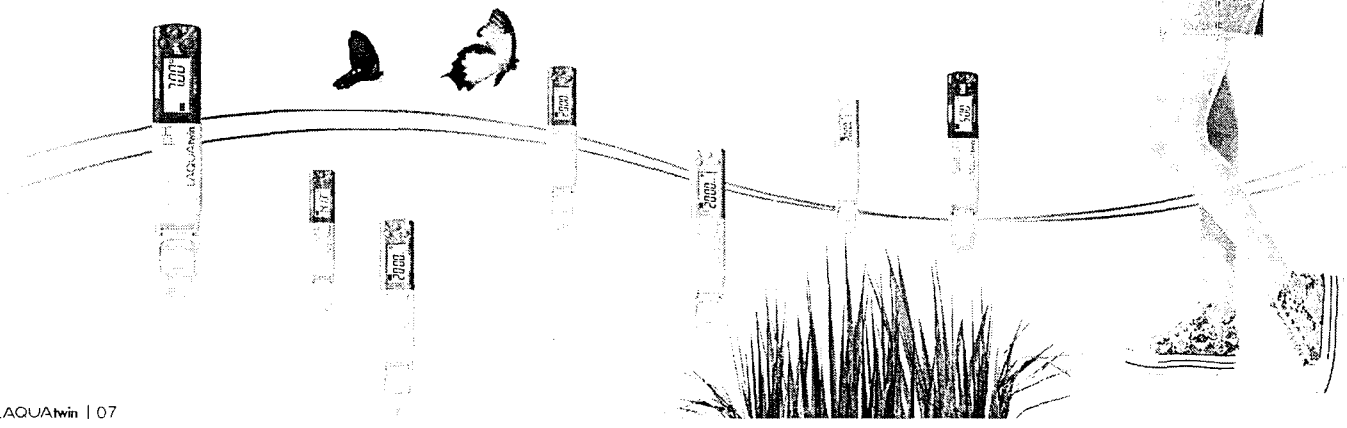

Mediciones fáciles para todos usuarios

LAQUAtwin

Sensor
A prueba de agua y polvo, clasificación IP-67. Electrodo fácilmente reemplazable.

Botón de medición
Pulse el botón MEAS, para ver el valor en mV o de temperatura (modo Auto Estable) o para bloquear/desbloquear el valor en la pantalla (modo Auto Hold). En modo de configuración, pulse para seleccionar y ajustar las configuraciones.

Medidor
A prueba de agua y polvo, clasificación IP-67.

Ojal para correa
Permite colocar una correa.

Botón ON/OFF
Pulse para encender o apagar el equipo o salir del modo de configuración.

Botón de calibración
Pulse para realizar la calibración o guardar las configuraciones en modo de configuración.

Tapa protectora
Protege el sensor de los daños y efectos de la luz. Abrir la tapa para colocar agua o muestra solida directamente sobre el sensor.



Tapa deslizante

Retroiluminación
Para una mejor visualización en lugar obscuro, parpadea cuando las pilas están bajas.

Icono de alarma de pilas
Aparece cuando las pilas están bajas.

Icono CAL
Parpadea durante la calibración y se mantiene encendido al finalizar la misma.

Icono MEAS
Deja de parpadear cuando la medicion esta completa y estable.

Valor de medición
Parpadea cuando el resultado está a fuera del rango de medición.

Icono de estabilización
Se enciende al estabilizarse el valor medido.

Icono de alarma de temperatura
Parpadea cuando la temperatura ambiente de medición está fuera del rango especificado.

Modo de medicion en voltaje
Muestra el voltaje del sensor.

Inmersión
Cuando se encuentre en un laboratorio, puede analizar la muestra en un vaso de precipitados. Asegúrese de que la tapa deslizante que protege el sensor esté abierta.





Muestreo
Utilícelo como una cuchara para analizar el agua, por ejemplo, de un río.

Gotas
Los medidores LAQUAtwin pueden medir volúmenes de muestra de tan solo 0.1ml. Coloque una gota de la muestra en el sensor con una pipeta.



Posibilidades de mediciones únicas con LAQUAtwin

Un medidor, siete métodos de medición distintos. ¡Solo la gama LAQUAtwin le proporciona una flexibilidad así! Escoja el mejor método en función de su muestra, situación y necesidades.



Transferencia
El papel de muestro permite realizar análisis de volúmenes traza. Por ejemplo, puede incluso medir el pH de la piel humana pasando el papel de muestreo empapado en agua desionizada y colocándola en el sensor.

Muestras sólidas
Los alimentos que contengan cierta humedad pueden analizarse si coloca un trozo pequeño directamente en el sensor.





Papel y tejidos
Si desea analizar hojas de papel y tejidos, corte la muestra en trozos pequeños y colóquelo directamente en el sensor. Vierta encima un volumen definido de agua desionizada.



Polvos
Los medidores LAQUAtwin también pueden analizar polvos secos. Simplemente, coloque la muestra de polvo en el sensor y vierta encima un volumen definido de agua desionizada.

Todos métodos son aplicable para medición de pH. No se puede analizar muestras sólidas ni polvos con los medidores de conductividad.

Soluciones de calibración y accesorios LAQUAtwin

Sensores de repuesto LAQUAtwin		
Referencia	Modelo	Descripción
3200459834	S010	Sensor de pH (para B-711, B-712, B-713, pH-11, pH-22 & pH-33)
3200459866	S021	Sensor de salinidad (para B-721 y Salt-22)
3200459867	S022	Sensor de ión sodio (para B-722 & Na-11)
3200459868	S030	Sensor de ión potassio (para B-731 & K-11)
3200459870	S040	Sensor de ión nitrato (para B-741, B-742, B-743, NO3-11, NO3-11C & NO3-11S)
3200459869	S050	Sensor de ión calcio (para B-751 & Ca-11)
3200459672	S070	Sensor de conductividad (para B-771, EC-11, EC-22, & EC-33)
3200597237	S071	Sensor de Salinidad (conductividad) (para Salt-11)

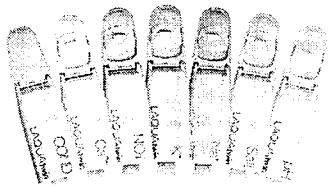

Sensores de repuesto LAQUAtwin

Soluciones de calibración (incluyendo 6 botellas de 14 ml)		
Referencia	Modelo	Descripción
5505293441	USA-2	Soluciones de calibración pH 4.01/7.00
5505293442	USA-3	Soluciones de calibración pH 4.01/7.00/10.01
5505293443	USA-5	Soluciones de calibración pH 1.68/4.01/7.00/10.01/12.46
3999960110	514-22	Soluciones de calibracion de conductividad a 1413 µS/cm
3999960111	514-23	Soluciones de calibracion de conductividad a 12.9 mS/cm
3999960112	514-05	Soluciones de calibracion de NaCl a 0.5% (Salt-11 & Salt-22)
3999960113	514-50	Soluciones de calibracion de NaCl a 5.0% (Salt-11 & Salt-22)
3999960114	514-20	Soluciones de tratamiento de electrodo (para conductividad y salinidad)
3200457723	Y022H	Soluciones de calibración de sodio a 2000ppm
3200457724	Y022L	Soluciones de calibración de sodio a 150ppm
3200457719	Y031H	Soluciones de calibración de potasio a 2000ppm
3200457720	Y031L	Soluciones de calibración de potasio a 150ppm
3200053433	Y041	Soluciones de calibración de nitrato a 5000ppm
3200053514	Y042	Soluciones de calibración de nitrato a 300ppm
3200053532	Y043	Soluciones de calibración de nitrato a 2000ppm
3200053535	Y044	Soluciones de calibración de nitrato a 30ppm
3200053536	Y045	Soluciones de calibración de nitrato a 150ppm
3200457727	Y051H	Soluciones de calibración de calcio a 2000 ppm
3200457728	Y051L	Soluciones de calibración de calcio a 150ppm



Buffers de pH | Soluciones de calibracion de conductividad | Soluciones de calibracion de NaCl

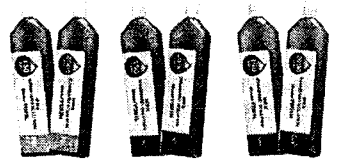

Soluciones de calibración de sodio | Soluciones de calibración de potasio | Soluciones de calibración de calcio



Soluciones de calibración de nitrato

Accesorios LAQUAtwin		
Referencia	Modelo	Descripción
3200053858	Y046	Papel de muestreo B, para micro muestras (≥ 0.05ml)
3200459736	Y048	Soporte para papel de muestro (usar con papel de muestreo B para líquido con partículas)



Papel de muestreo B

NO3-11C: kit para análisis de savia
(referencia 3200689163)

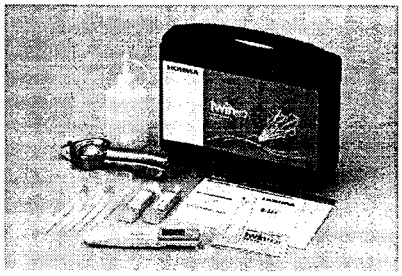

Accesorios incluidos:
Medidor de Nitrato NO3-11, soluciones de calibración de 14 ml (300 ppm y 5000 ppm), Pilas CR2032 (x 2), manual de instrucción, 5 pipetas, botella de solución de limpieza (250 ml), prensa para exprimir savia, 3 tazas, guía rápida, maletín de transporte.

NO3-11S: kit para análisis de suelo
(referencia 3200689164)

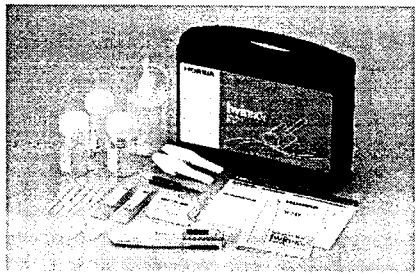

Accesorios incluidos:
Medidor de Nitrato NO3-11, soluciones de calibración de 14 ml (30 ppm y 300 ppm), Pilas CR2032 (x 2), manual de instrucción, 5 pipetas, botella de solución de limpieza (250 ml), 3 botellas de extracción (100 ml), 2 spatulas para muestreo de suelo, pincitas, papel de muestreo B, 2 soportes para papel de muestrec, guía rápida, maletín de transporte.

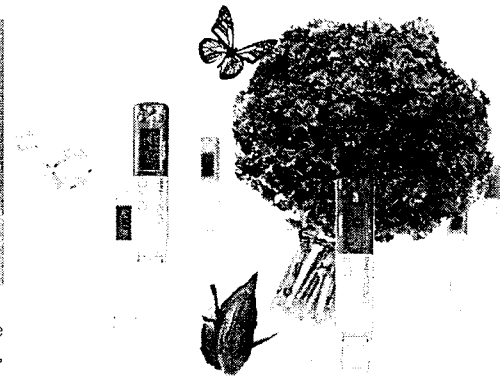

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020013858 DE 20 de Abril de 2020

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 2010012074 de 3 de mayo de 2010 el INVIMA concedió Permiso De Comercialización No. INVIMA2010EBC-0005674 para el producto OXÍMETRO DE PULSO EDAN, ACCESORIOS Y REPUESTOS a favor de NOVAMEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLÁNTICO en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito No. 20201029141 radicado el 14 de febrero de 2020, el Doctor RICHARD ANTONIO BORELLY AYCARDI, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa NOVA MEDICA LTDA, solicitó la Renovación del Permiso de Comercialización No. INVIMA 2010EBC-0005674 para el producto OXÍMETRO DE PULSO EDAN, ACCESORIOS Y REPUESTOS, a favor de NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO, en la modalidad IMPORTAR y VENDER.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Permiso de Comercialización con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías.

Es necesario señalar, que en adelante las etiquetas de importador deben contener la nomenclatura correspondiente a la Renovación así: **Permiso de Comercialización No. INVIMA2020EBC-0005674-R1**, so pena de quedar sujeto a las medidas sanitarias pertinentes, en el evento de una visita de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005 que cita:

> ***"Artículo 65. Competencia.*** *El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, ejercerá las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto, de igual forma, tomarán las medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su incumplimiento. (...)".*

En este sentido, en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de2017, se emitió concepto favorable para la Renovación de este Permiso de Comercialización y en consecuencia, LA DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Renovar PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN por el término de 10 años al

PRODUCTO:	OXÍMETRO DE PULSO EDAN, ACCESORIOS Y REPUESTOS
MARCA(S):	EDAN
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN No.:	**INVIMA2020EBC-0005674-R1**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO
FABRICANTE(S):	EDAN INSTRUMENTS INC con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES):	NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO
ACONDICIONADOR(ES):	NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	EQUIPO BIOMEDICO PARA DIAGNOSTICO IIB
SISTEMAS:	ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO
SUBSISTEMAS:	SENSOR DE OXIMETRÍA, SENSOR DE TEMPERATURA, CARGADOR DE BATERÍA, BATERÍA RECARGABLE, SOFTWARE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, CABLE AC, CABLE DE COMUNICACIÓN PC, MALETÍN, MANUAL DE USUARIO.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020013858 DE 20 de Abril de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

USOS:	MONITOREO CONTINUO O VERIFICACIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO ARTERIAL FUNCIONAL (SPO2) Y FRECUENCIA DE PULSO ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL, UTILIZADO EN HOSPITALES, AMBIENTES DE TRASPORTE Y MÓVILES, INSTALACIONES TIPO HOSPITAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DE CUIDADO EN CASA.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	EMPAQUE INDIVIDUAL
OBSERVACIONES:	ESTE PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN AMPARA LOS MODELOS H100A, H100B, H100N, ACCESORIOS Y REPUESTOS
EXPEDIENTE No.:	20018616
RADICACIÓN:	20201029141
FECHA RADICADO:	14/02/2020

ARTICULO SEGUNDO. - Se aprueban las etiquetas del fabricante y de importador con el radicado No. 20201029141.

ARTICULO TERCERO: - AUTORIZAR EL AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS marcadas con el Permiso de Comercialización Número **INVIMA 2010EBC-0005674.**

ARTICULO CUARTO. - Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la **DIRECTORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA**, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 20 de Abril de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: ldiazc Revisó: cordina_varios

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: [illegible]
Administrativo: [illegible]
[illegible]
www.invima.gov.co

invima

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2023006450 DE 21 de Febrero de 2023
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, Ley 1437 de 2011 y la Resolución No. 2023002986 del 30 de enero de 2023

EXPEDIENTE: 20018616 **RADICACIÓN:** 20221284573 **FECHA:** 30/12/2022
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN: INVIMA 2020EBC-0005674-R1 **VIGENCIA:** 20/04/2030

ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 2010012074 DE 3 de Mayo de 2010 el INVIMA concedió Permiso de Comercialización No. INVIMA 2010EBC-0005674 para el producto OXÍMETRO DE PULSO EDAN, ACCESORIOS Y REPUESTOS a favor de NOVAMEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLÁNTICO en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2018001517 de 17 de Enero de 2018, el Invima modificó la Resolución No.2010012074 del 3 de mayo de 2010, en el sentido de aprobar CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DE TITULAR, IMPORTADOR, ACONDICIONADOR, CAMBIO DE DOMICILIO DE FABRICANTE Y ACTUALIZACIÓN DE ETIQUETAS.

Que mediante Resolución No. 2020013858 DE 20 de Abril de 2020, el Invima concedió la Renovación del Permiso de comercialización No. INVIMA2020EBC-0005674-R1 para el producto OXÍMETRO DE PULSO EDAN, ACCESORIOS Y REPUESTOS a favor de NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO, en la modalidad de Importar y Vender.

Que mediante escrito número 20221284573 radicado el 30/12/2022, el Señor JOHN BORELLY RAMIRES, actuando en calidad de representante legal de la sociedad NOVA MEDICA S.A.S., presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de obtener aprobación para CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR, IMPORTADOR, ACONDICIONADOR Y CAMBIO DE ETIQUETAS

CONSIDERACIONES

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico y en consecuencia este Instituto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 2020013858 DE 20 de Abril de 2020 que concedió Permiso de Comercialización número INVIMA 2020EBC-0005674-R1 a favor de NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO para el producto OXÍMETRO DE PULSO EDAN, ACCESORIOS Y REPUESTOS, en la modalidad IMPORTAR Y VENDER , en el sentido de **APROBAR:**

CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR, IMPORTADOR Y ACONDICIONADOR, QUEDANDO: NOVA MEDICA S.A.S.

CAMBIO DE ETIQUETAS: SE ACTUALIZA EL STICKER DE REGISTRO SANITARIO PARA INCLUIE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA SOPORTE TECNICO.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2023006450 DE 21 de Febrero de 2023
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, Ley 1437 de 2011 y la Resolución No. 2023002986 del 30 de enero de 2023

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el DIRECTOR(E) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO:- Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017 .

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 21 de Febrero de 2023

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



MABEL BARBOSA ROMERO
DIRECTOR(E) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: anaranjoa, Técnico: ysanchezo

Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos
Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

SOLUSERVINT
COLOMBIA S.A.S

SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA S.A.S
NIT 901.161.442-0
315 297 2973
soluservintcolombiasas@gmail.com
CRA 13 # 14 - 82 BRR SANTA LIBRADA

COTIZACION DE VENTA

INFORMACION CLIENTE

NOMBRE:	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	**COTIZACION NUMERO:**	0270 - 2026
NIT:	891.180.268	**FECHA:**	10/09/2026
CONTACTO:	DR. JUAN DIEGO FIERRO OLIVEROS	**FORMA DE PAGO:**	Según Acuerdo
TELEFONO:	8715907	**VALIDEZ:**	2026
CORREO :	suministros.medicamentos@huhmp.gov.co		
CIUDAD:	NEIVA-HUILA		

Cordial saludo, en nombre de la organización SOLUCIONES Y SERVICIONS INTEGRALES COLOMBIA SAS, ponemos a su disposicion la siguiente propuesta para su consideracion.

ITEM	DESCRIPCION	INVIMA Y CUM	LABOTAORIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO IVA UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA
1	TERMOHIGROMETRO REF DC103 + CALIBRACION	NO REQUIERE	DIGITAL SERIES	38	$ 181.969	$ 34.574	$ 8.228.638
2	MEDIDOS DE PH Y TEMPERATURA REF:LAQUATWIN PH33	NO REQUIERE	HORIBA	1	$ 2.251.256	$ 427.739	$ 2.678.995
3	PULSOXIMETRO REF:H100B	NO REQUIERE	EDAN	1	$ 1.137.830	$ 216.188	$ 1.354.018
						TOTAL	$ 12.261.651

Quedando atento a sus comentarios.

Atentamente,

YAMIL AUGUSTO DIAZA VILLEGAS
Representante Legal

INNOVAMEDIC S.A.S.	
NIT.	900.338.342-0
CARRERA 10 No 13-63	
Neiva - Huila	

INNOVAMEDIC S.A.S

CLIENTE	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
NIT.	891.180.268
CIUDAD	Neiva - Huila

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

COT 03/09/25

Atn, Dr. JUAN DIEGO FIERRO OLIVEROS
Gerente.
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

COMPRA DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS Y/O SERVICIOS DE LA INSTITUCION

DC103	DIGITAL SERIES	38	TERMOHIGROMETRO REF DC103 + CALIBRACION	$	188,035	19%	$ 7,145,330
LAQUATWIN	HORIBA	1	MEDIDOS DE PH Y TEMPERATURA REF:LAQUATWIN PH33 GARANTIA: 1AÑO	$	2,326,298	19%	$ 2,326,298
H100B	EDAN	1	PULSOXIMETRO REF:H100B GARANTIA: 1AÑO	$	1,175,758	19%	$ 1,175,758
	total	40			Subtotal		$ 10,647,386
SON:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE				IVA		$ 2,023,003
					Total		$ 12,670,389

CONDICIONES

	10 Dias despues de recibida la orden de compra.
	Un (1) año por defectos de fabricación.
	CREDITO 60 DIAS
	Descuento comercial de 5% por pago a 30 dias
	30 dias habiles/Siempre y cuando el dólar nos supere los 3600 COP
	No se aceptan cambios una vez aprobados los instrumentos por parte del cliente

Cordialmente,

JOSETH FABIAN POLANIA CARDOZO
Representante Legal