Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

ESTUDIO DE MERCADO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA ADAPTACIÓN NEONATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

		COTIZACION 1 JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES				COTIZACION 2 DRAGER				COTIZACION 3 TECNICA ELECTROMEDICA				COTIZACION 4 ALLERS			
ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT TOTAL	EQUIPO COTIZADO	Vr Unitario antes de iva	IVA	VALOR TOTAL	EQUIPO COTIZADO	Vr Unitario antes de iva	IVA	VALOR TOTAL	EQUIPO COTIZADO	Vr Unitario antes de iva	IVA	VALOR TOTAL	EQUIPO COTIZADO	Vr Unitario antes de iva	IVA	VALOR TOTAL
Servocuna	1	COMEN BQ-80	$ 43.400.000	$ 8.246.000	$ 51.646.000	DRAGER BABYROO TN300 BASICA	$ 63.884.500	$ 12.138.055	$ 76.022.555	COMEN BQ80+WS	$ 44.268.000	$ 8.410.920	$ 52.678.920	NO COTIZO			
						DRAGER BABYROO TN300 + SPO2	$ 72.244.000	$ 13.726.360	$ 85.970.360								
Neopuff	1	FISHER & PAYKELRD900 0 completo	$ 12.523.280	$ 2.379.423	$ 14.902.703	NO COTIZO				FISHER & PAYKELRD9000 completo	$ 12.773.746	$ 2.427.012	$ 15.200.758	NO COTIZO			
		SECA354M	$ 1.316.000	$ 250.040	$ 1.566.040	NO COTIZO				SECA354M	$ 1.342.320	$ 255.041	$ 1.597.361	SECA 354	$ 1.585.753	$ 301.293	$ 1.887.046
Bascula pesa bebe	1	SECA 834	$ 2.128.000	$ 404.320	$ 2.532.320	NO COTIZO				SECA 834	$ 2.170.560	$ 412.406	$ 2.582.966	SECA 834	$ 2.130.115	$ 404.722	$ 2.534.837
Infantometro	1	SECA417	$ 938.000	$ 178.220	$ 1.116.220					SECA417	$ 956.760	$ 181.784	$ 1.138.544	SECA417	$ 702.488	$ 133.473	$ 835.961
Cinta metrica	1	SECA 201	$ 50.400	$ 9.576	$ 59.976	NO COTIZO				SECA 201	$ 51.408	$ 9.768	$ 61.176	SECA 201	$ 38.089	$ 7.237	$ 45.326
Pulsioximetro	1	MINDRAY PM-60	$ 1.610.000	$ 305.900	$ 1.915.900	NO COTIZO				MINDRAY PM-60	$ 1.642.200	$ 312.018	$ 1.954.218	H100B EDAN	$ 972.810	$ 184.834	$ 1.157.644
Fonendoscopio	1	WELCH ALLYNPROFESSIONAL	$ 574.000	$ 109.060	$ 683.060	NO COTIZO				WELCH ALLYNPROFESSIONAL	$585.000	$ 111.150	$ 696.150	WELCH ALLYN TYCOS	$485.774	$ 92.297	$ 578.071
TOTAL		$ 71.889.899		$ 72.856.179		$ 76.022.555		$ 85.970.360	$ 85.970.360	$ 73.327.126		$ 74.312.732		$ 7.038.885			

Proyecto: Karen Tatiana Cardenas M
Lider de GTB
Hospital Regional de Sogamoso ESE




JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

REGIMEN COMÚN - Nit. 901048992-7

Kr 30 # 10-34 - Tel. 7601818 -Cel. 3228950608

COTIZACION No. 1055092026

Señores:	**Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.**	Vendedor:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Nit:	**891855039-9**	Forma de Pago:	A CONVENIR
Dirección:	**CL 8 11 A 43**	Fecha :	viernes, 11 de septiembre de 2026
Telefonos:	**3133937630**	Validez de la Cotización:	30 DIAS

ITEM	PRODUCTO	IMAGEN	MARCA DEL ESTUDIO	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL IVA INCLUIDO
1	INCUBADORA ABIERTA CON AJUSTE ALTURA,BASCULA Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA		COMEN BQ-80	1	43.400.000	19%	51.646.000	51.646.000
2	OPCIÓN 1 KIT COMPLETO KIT NEOPUFF INCLUYE : - ATRIL RODABLE CON BANDEJA - BLENDER MEZCLADOR GMX30U - MANGUERA DE AIRE 3M DISS POR CHEMETRON - MANGUERA DE OXIGENO 3M DISS POR CHEMETRON - REANIMADOR INFANTIL NEOPUFF RD900 PERMITE GRADUACION DE PIP Y PEEP (SOLO EQUIPO) - SOPORTE PARA ATRIL CON CUATRO PUNTOS DE FIJACION NACIONAL - SOPORTE PARA NEOPUFF 900RD301 PARA SUJECION DE NEOPUFF CON 900MR030 A ATRIL		FISHER & PAYKEL RD9000	1	12.523.280	19%	14.902.703	14.902.703
3	BALANZA DIGITAL UNIVERSAL NEONATAL PEDIATRICA - 20 KG , TARA, BMIF, AUTOHOLD + ADAPTADOR DE CORRIENTE + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN		SECA 354M	1	1.316.000	19%	1.566.040	1.566.040
4	INFANTOMETRO 417 -RANGO : 10 – 100 CM,DIV : 1 MM		SECA 417	1	938.000	19%	1.116.220	1.116.220
5	CINTA ERGONOMICA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIAS ALCANCE DE : 0 – 205 CM, DIV: 1 MM		SECA 201	1	50.400	19%	59.976	59.976
6	PULSOXIMETRO PANTALLA 2. 4 TFT COLOR, PLETISMOGRAFIA Y FR INCLUYE SENSOR ADULTO + SENSOR SPO2 NEONATAL 3 M 7 PINES TIPO NELLCOR + BASE DE CARGA		MINDRAY PM-60	1	1.610.000	19%	1.915.900	1.915.900
7	FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS PROFESSIONAL - COLOR NEGRO - USO: PEDIATRICO		WELCH ALLYN PROFESSIONAL	1	574.000	19%	683.060	683.060
							TOTAL	71.889.895

Condiciones Comerciales:

Moneda:	Pesos Colombianos
Forma de pago:	A convenir
Tiempo de Entrega	Los productos serán entregados dentro de los (10) días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra o firma del contrato, o inmediato según disponibilidad del producto. En caso de requerirse fabricación y/o importación el tiempo de entrega se extiende de 45 a 60 días
Lugar de entrega	En las instalaciones de la institución - Boyacá

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

REGIMEN COMÚN - Nit. 901048992-7

Kr 30 # 10-34 - Tel. 7601818 -Cel. 3228950608

JEZA
Soluciones Empresariales s.a.s

COTIZACION No. 1055092026

Señores:	**Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.**	Vendedor:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Nit:	**891855039-9**	Forma de Pago:	A CONVENIR
Dirección:	**CL 8 11 A 43**	Fecha :	viernes, 11 de septiembre de 2026
Telefonos:	**3133937630**	Validez de la Cotización:	30 DIAS

ITEM	PRODUCTO	IMAGEN	MARCA DEL ESTUDIO	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL IVA INCLUIDO
GARANTIA TÉRMINOS Y CONDICIONES	Los equipos ofertados cuentan con garantia por defectos de fabricacion de 1 año La garantía solo será cubierta si se cumplen los siguientes criterios: a. Instalación adecuada y correcta de la tecnología por parte de personal de JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. b. Suministros dentro de valores exigidos, de acuerdo, a las instrucciones de instalación previamente entregadas por la compañía. Según aplique de acuerdo a la tecnología adquirida. c. Manejo adecuado de la tecnología según las condiciones de fabricante. d. Realización de actividades de mantenimiento propias del usuario limpieza y ejecución permanente de revisión de suministros, pruebas de estanqueidad y demás rutinas propias del usuario. e. Cuando el dispositivo médico, se encuentre dentro de su periodo de garantía el cual va desde la fecha de entrega hasta el vencimiento de la misma según el contrato de compraventa. f. Que el defecto o daño del equipo corresponda a un defecto de fabricación o calidad de alguno de los elementos que hacen parte de su conjunto siempre y cuando estas sean originales propias de la marca. g. Este documento hace parte integral del contrato de compraventa. h. La prestación de un servicio de mantenimiento durante la garantía, no alarga el período de la misma.							

Cordialmente

MARIA ZORAIDA RINCON
REPRESENTANTE LEGAL
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS


Lorena Hernández
Elaboro.

RESUMEN OFERTA

Dräger
900.194.910-4

ASUNTO: **OFERTA EQUIPO MÉDICO**

CLIENTE: **Hospital Regional de Sogamoso**
HOSPITAL:
ATENCIÓN: Ing. Karen Tatiana Cardenas
COTIZACIÓN SP4: QUO-VLozano-10612-001
FECHA: Septiembre 11 de 2026
COMENTARIOS:

ITEM	CANTIDAD	TIPO DE EQUIPO	MODELO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	1	**LÁMPARA DE CALOR RADIANTE BÁSICA** 	**BABYROO TN300**	* Babyroo TN300 Calentador abierto radiante para bebés y neonatos de hasta 10 kg (22 lib.). Rango de funcionamiento del dispositivo Babyroo: * Calentador radiante con compensación incluida cuando la cama está inclinada. * Modos de terapia: Manual, piel y canguro. * Termocontrol de pacientes con medición de temperatura de piel central y periférica. * Cuatro vistas diferentes: Vista principal, de parto, de termocontrol y de familia. * Carro de altura fija o regulable, con dos ruedas. * Pantalla táctil a color. * Paredes laterales plegables y varias arandelas para mangueras. * Mecanismo de inclinación de cama e indicación de ángulo de inclinación. * Luz de trabajo de 3 intensidades. * Gestión de alarmas (aumento de volumen de alarma, supresión de alarmas previsibles, silenciado). * Bandeja de rayos X. **Accesorios incluidos:** * Ref. MX11000 ThermoTrace central, sensores de temperatura de la piel. * Ref. MX11001 ThermoTrace periférica, para la medición de la temperatura periférica. * Colchon Softbed.	$ 63.884.500	$ 63.884.500
2	1	**LÁMPARA DE CALOR RADIANTE CON SPO2**	**BABYROO TN300**	* Babyroo TN300 Calentador abierto radiante para bebés y neonatos de hasta 10 kg (22 lib.). Rango de funcionamiento del dispositivo Babyroo: * Calentador radiante con compensación incluida cuando la cama está inclinada. * Modos de terapia: Manual, piel y canguro. * Termocontrol de pacientes con medición de temperatura de piel central y periférica. * Cuatro vistas diferentes: Vista principal, de parto, de termocontrol y de familia. * Carro de altura fija o regulable, con dos ruedas. * Pantalla táctil a color. * Paredes laterales plegables y varias arandelas para mangueras. * Mecanismo de inclinación de cama e indicación de ángulo de inclinación. * Luz de trabajo de 3 intensidades. * Gestión de alarmas (aumento de volumen de alarma, supresión de alarmas previsibles, silenciado). * Bandeja de rayos X. * Pulsioximetría (SpO2) (Masimo SET.) **Accesorios incluidos:** * Ref. MX11000 ThermoTrace central, sensores de temperatura de la piel. * Ref. MX11001 ThermoTrace periférica, para la medición de la temperatura periférica. * Sensores de SPO2 Masimo. * Colchon Softbed.	$ 72.244.000	$ 72.244.000
3	1	**LÁMPARA DE CALOR RADIANTE CON MÓDULO DE REANIMACIÓN**	**BABYROO TN300**	* Babyroo TN300 Calentador abierto radiante para bebés y neonatos de hasta 10 kg (22 lib.). Rango de funcionamiento del dispositivo Babyroo: * Calentador radiante con compensación incluida cuando la cama está inclinada. * Modos de terapia: Manual, piel y canguro. * Termocontrol de pacientes con medición de temperatura de piel central y periférica. * Cuatro vistas diferentes: Vista principal, de parto, de termocontrol y de familia. * Carro de altura fija o regulable, con dos ruedas. * Pantalla táctil a color. * Paredes laterales plegables y varias arandelas para mangueras. * Mecanismo de inclinación de cama e indicación de ángulo de inclinación. * Luz de trabajo de 3 intensidades. * Gestión de alarmas (aumento de volumen de alarma, supresión de alarmas previsibles, silenciado). * Bandeja de rayos X. * Módulo de reanimación. **Accesorios incluidos:** * Ref. MX11000 ThermoTrace central, sensores de temperatura de la piel. * Ref. MX11001 ThermoTrace periférica, para la medición de la temperatura periférica. * Colchon Softbed.	$ 86.400.000	$ 86.400.000
					TOTAL ANTES DE IVA	222.528.500
			IVA	19%	IVA	42.280.415
					TOTAL IVA INCLUIDO	264.808.915

CONDICIONES COMERCIALES ESPECIFICAS

MONEDA	COP
INCOTERM	DDP
FORMA DE PAGO	60 días fecha factura
TIEMPO DE ENTREGA	12 semanas despues de la orden de compra
VALIDEZ DE LA OFERTA	30 días
TIEMPO DE GARANTÍA	24 meses fecha factura
VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2 visitas por año

Cordialmente,

Vivian Lozano Q.

Vivian Lozano
Cargo Sales Representative MD
Tel. 310 2213868
Correo vivian.lozano@draeger.com

RESUMEN OFERTA

Dräger
900.194.910-4

ASUNTO: OFERTA EQUIPO MÉDICO

CLIENTE: **Hospital Regional de Sogamoso**
HOSPITAL:
ATENCIÓN: Ing. Karen Tatiana Cardenas
COTIZACIÓN SP4: QUO-VLozano-10612-001
FECHA: Septiembre 11 de 2026
COMENTARIOS:

ITEM	CANTIDAD	TIPO DE EQUIPO	MODELO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA

Esta cotización fue generada electronicamente por lo que es valida sin firma.

NOTA IMPORTANTE:

LAS CONDICIONES COMERCIALES ESPECIFICAS AQUÍ MENCIONADAS APLICAN PARA LA OFERTA SYSTEM PRICE CUYO NUMERO SE RELACIONA EN LA PARTE SUPERIOR. LA GENERACION DE UNA ORDEN DE COMPRA CON BASE EN LA OFERTA GENERADA EN SYSTEM PRICE IMPLICA LA ACEPTACION DE LAS CONDICIONES COMERCIALES ESPECIFICAS LISTADAS EN ESTE DOCUMENTO.

Tipo	Estado	Edición	Número	Organización
Formato	Effective	2020-02-03	DCS OG1140 A93	Draeger Colombia S.A

allers Group

"Ayudamos a salvar vidas"

icontec ISO 9001 SC-4585-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OFERTA ECONÓMICA

Cali: Cra. 67 N° 1B-35 | PBX: (602)489 3000 3167684444
Bogotá: Cll 128B N° 49 - 57
allers@allers.com.co

Instagram LinkedIn Facebook

allers Group
"Ayudamos a salvar vidas"

icontec ISO 9001 SC-4585-1 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Santiago de Cali, 16 de Septiembre de 2026.

Señores:
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Atn. Ingeniera Karen Tatiana Cárdenas
Sogamoso, Boyacá.

Ref: COTIZACION EQUIPOS MÉDICOS ADAPTACION NEONATAL.

En atención a su amable solicitud, es para Allers S.A.S, un gusto ofrecer los productos de nuestro portafolio los cuales cuentan con un respaldo de más de 70 años de experiencia en el mercado médico en Colombia, ofreciendo una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Si tiene alguna inquietud por favor no dude en contactarnos, para nosotros sería un placer poder atender sus inquietudes.

Cordialmente,

LEIDY MAYERLY CASTIBLANCO CHAPARRO
AREA DE CONTRATACION COMERCIAL.
ALLERS GROUP S.A.S
Cel: 3115901220
E mail: lcastiblanco@allers.com.co; contratacioncomercial@allers.com.co

allers Group
"Ayudamos a salvar vidas"

icontec ISO 9001 SC-4585-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM	COD. SAP	EQUIPO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	32485	834 PESA BEBE DIGITAL GRAD MEDICO CLASE IIII 20KG Div:10g<10kg>20g TARA/BMIF/HOLD/ BATT SECA	1	1.585.753	301.293	1.887.046	1.887.046
2	31474	334 BALANZA PESA BEBE DIGITAL ELECTRONICA KG/LB CAP 20 KG BATERIA BMIF ADAPTADOR RED ELECTRICA-SECA	1	2.130.115	404.722	2.534.837	2.534.837
3	29902	417 INFANTOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 CM GRADUACION 1MM - SECA.	1	702.488	133.473	835.961	835.961
4	19783	201 CINTA METRICA MECANICA MEDICION CIRCUNFERENCIAS CON ENROLLAJE (DIV:1MM RANGO MED 205 CM) SECA	1	38.089	7.237	45.326	45.326
5	NO TIENE	OXIMETRO DE PULSO H100B EDAN	1	972.810	184.834	1.157.644	1.157.644
	NO TIENE	SENSOR SPO2 NEONATAL 7 PINES H100B	1				
6	2276	5079-145 FONENDOSCOPIO PEDIATRICO TYCOS NEGRO WELCH ALLYN BAXTER	1	485.774	92.297	578.071	578.071

CONDICIONES DE LA OFERTA:

- Oferta válida hasta el 15 de octubre de 2026, las cantidades cotizadas están sujetas a disponibilidad de inventario.
- Monto mínimo de despacho a la ciudad de Sogamoso $ 2.000.000, en caso de no cumplirse el monto mínimo de despacho el cliente asume los costos del envío.
- Se entregan equipos originales, nuevos de fábrica, de primera calidad de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en la ficha técnica.

TÉCNICA ELECTROMÉDICA

NIT: 830004892-2
Calle 47 No. 5 - 26
Bogotá
Colombia
https://www.tecnicaelectromedica.com/

Cliente	No cotización	No cotización SAP	Identificación	Teléfono para facturación	FECHA DE EMISION
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE	28943	293656	NIT : 891855039		13/9/2026

Dirección

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
CL 8 11 A 43
SOGAMOSOS BOYACA
Colombia
15759

FECHA DE VENCIMIENTO

13/10/2026

CODIGO DE CLIENTE

C891855039

MODALIDAD DE VENTA

VENTA CONVENCIONAL

#	REF.	DESCRIPCION	CANT.	%IVA	PRECIO	TOTAL
	BQ80+WS	INCUBADORA ABIERTA CON AJUSTE ALTURA,BASCULA Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA	1	19 %	$44.268.000	$44.268.000
1	KIT NEOPUFF	KIT NEOPUFF INCLUYE (RD900+900RD301 +900MR030-G+KIT BLENDER	1	19 %	$12.773.746	$12.773.746
	IVS-9008-20	ATRIL RODABLE CON BANDEJA	1			
	GMX30U	BLENDER MEZCLADOR GMX30U	1			
	02430117-00	MANGUERA DE AIRE 3M DISS POR CHEMETRON	1			
	02430116-00	MANGUERA DE OXIGENO 3M DISS POR CHEMETRON	1			
	RD900ASU	REANIMADOR INFANTIL NEOPUFF RD900 PERMITE GRADUACION DE PIP Y PEEP (SOLO EQUIPO)	1			
	900MR030-G	SOPORTE PARA ATRIL CON CUATRO PUNTOS DE FIJACION NACIONAL	1			
	900RD301	SOPORTE PARA NEOPUFF 900RD301 PARA SUJECION DE NEOPUFF CON 900MR030 A ATRIL	1			
2	3541317614	BALANZA DIGITAL UNIVERSAL NEONATAL - PEDIATRICA 354M - 20 KG , TARA, BMIF, AUTO-HOLD	1	19 %	$1.342.320	$1.342.320
3	8347017094	PESA BEBE GRADO MÉDICO SECA 834	1	19 %	$2.170.560	$2.170.560
4	4171721009	INFANTOMETRO 417 -RANGO : 10 – 100 CM,DIV : 1 MM,	1	19 %	$956.760	$956.760
5	2011717009	CINTA ERGONOMICA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIAS 201 -ALCANCE DE : 0 – 205 CM, DIV: 1 MM,	1	19 %	$51.408	$51.408
6	PM60	PULSOXIMETRO PANTALLA 2. 4 TFT COLOR, PLETISMOGRAFIA (CURVA) Y FR (INCLUYE SENSOR ADULTO)	1	19 %	$1.642.200	$1.642.200
7	5079-145	FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS PROFESSIONAL - COLOR NEGRO - USO: PEDIATRICO	1	19 %	$585.480	$585.480

Observaciones

Subtotal	$63.790.474,00
Impuesto (%)	$12.120.190,06

Para confirmar la veracidad de este documento comuníquese al PBX: 601 756 8787

Este documento es confidencial y ha sido elaborado exclusivamente para el destinatario indicado. Su contenido no puede ser divulgado, reproducido ni utilizado para fines distintos a los acordados con TECNICA ELECTROMEDICA S.A.

Representante	Cargo	Email	Télefono
OFICINA PRINCIPAL		ventas1@tecnicaelectromedica.com	+576017568787

Total	$75.910.664,06

Documento- No Controlado

Para ...firmar la veracidad de este documento comun... ese al PBX: 601 756 8787

Este documento es confidencial y ha sido elaborado exclusivamente para el destinatario indicado. Su contenido no puede ser divulgado, reproducido ni utilizado para fines distintos a los acordados con TECNICA ELECTROMEDICA S.A.

CONDICIONES COMERCIALES

Moneda de la negociación

* Pesos colombianos (COP)

* Si está ofertado en moneda extranjera (dólares americanos), el valor será liquidado al valor de la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de pago

Garantia

* Para equipos: garantía de doce (12) meses por defectos de fabricación.

* Para dispositivos médicos y accesorios: garantía de tres (3) meses por defectos de fabricación.

* La garantía no cubre: Fallas causadas por mal uso o abuso de los equipos, redes\eléctricas inadecuadas.

Tiempo de entrega

* Los productos serán entregados dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra o firma del contrato, según disponibilidad del producto.

* Para productos que deben ser importados, la entrega será dentro de los noventa (90) días calendario posteriores a la recepción de la orden de compra o firma de contrato, según condiciones del fabricante y transporte internacional.

Forma de Pago

* Anticipado, salvo condiciones de crédito ya acordadas y condiciones especiales pactadas en la negociación.

Orden de compra

* En caso de aprobar la oferta económica, solicitamos el favor de enviar una orden de compra relacionando el número de cotización.

Nota: Al momento de enviar su orden de compra verificar el estado de su cartera.

Facturación

* Responsable de IVA. Gran Contribuyente ICA Bogotá, resolución DDI-023769 de 2021-11-29, La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción, si no reclama en contra de su contenido. Ley 1231 de 2017-07-08.

Envío y Flete

* Para Bogotá D.C, el envío y distribución de los productos se hará por transporte propio.

* Para fuera de Bogotá D.C, el envío se hará por transportadora nacional.

* Si el valor de la factura NO supera un millón de pesos ($1.000.000) y según las condiciones pactadas en la negociación, el valor del envió deberá ser asumido por el cliente,los pedidos parciales deben ser autorizados y asumidos por el cliente.

Cuentas Bancarias

* Cuenta corriente banco Davivienda Nº 474169999981 a nombre de Técnica Electromédica S.A.

* Cuenta corriente banco Popular Nº 01716083-9 a nombre de Técnica Electromédica S.A.

* Cuenta corriente banco Bogotá Nº 000-40087-9 a nombre de Técnica Electromédica S.A.

Davivienda Internacional

Código SWIFT: CAFEUS3M ABA: 066011389

Nombre: Técnica Electromédica s.a. Cuenta del beneficiario: 910304010

Devoluciones

* Técnica Electromédica S.A. se rige bajo la política de devoluciones adjunta. De no haber cumplimiento, la devolución no será aceptada.

Solicitud de devolución:

Documento No Controlado

Para confirmar la veracidad de este documento comuníquese al PBX: 601 756 8787

Este documento es confidencial y ha sido elaborado exclusivamente para el destinatario indicado. Su contenido no puede ser divulgado, reproducido ni utilizado para fines distintos a los acordados con TECNICA ELECTROMEDICA S.A.

El cliente envía una carta especificando; número de factura, lotes, series, y razón de la falla o de la devolución. Al correo viviana.grisales@tecnicaelectromedica.com, desde un correo institucional o un correo reconocido de la identidad la solicitud debe estar en hoja membrete y firmada. Si los productos llegan a Técnica, de igual forma al correo viviana.grisales@tecnicaelectromedica.com o para tramitar la garantía.

Documento No Controlado

Para ...firmar la veracidad de este documento comun... ese al PBX: 601 756 8787

Este documento es confidencial y ha sido elaborado exclusivamente para el destinatario indicado. Su contenido no puede ser divulgado, reproducido ni utilizado para fines distintos a los acordados con TECNICA ELECTROMEDICA S.A.

ANEXO 1. POLITICA DE DEVOLUCIONES

Error de Facturación:

* Cuando por error involuntario de TECNICA ELECTROMEDICA se factura equívocamente productos, precios, referencias o cantidades que difieran de la orden de compra del cliente. El cliente tendrá máximo diez (1O) días calendario a partir de la fecha de recepción para solicitar la generación de la nueva factura. La factura se considera irrevocable aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (1O) días calendarios siguientes a su recepción. (Tomado del código de comercio Art. 773)

Error en el Despacho:

* Cuando por error involuntario de TECNICA ELECTROMEDICA se envía mercancía equivocada (producto, en cantidades o referencias) la relacionada en la orden de compra y/o factura. En este caso, el producto debe venir en su empaque original, completo y sin daño en la etiqueta; el cliente tendrá máximo diez (1O) días calendario a partir de la fecha de recepción para solicitar el nuevo despacho. La factura se considera irrevocable aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (1O) días calendarios siguientes a su recepción. (Tomado del código de comercio Art. 773)

Error de Pedido por el Cliente:

* Cuando por error del cliente se factura mercancía equivocada. El cliente debe enviar un correo o carta describiendo el error de la orden de compra. El cliente tendrá máximo diez (1O) días calendario a partir de la fecha de recepción para solicitar la generación de la nueva factura. La factura se considera irrevocable aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (1O) días calendarios siguientes a su recepción. (Tomado del código de comercio Art. 773). Los productos deben venir en su empaque original, completo y sin daño en la etiqueta. En este caso, se realizará únicamente para cambio con otro producto. Los fletes por devolución y reenvío corren por cuenta del cliente.

Productos en mal estado o no esta en su empaque original:

* Si el producto ha tenido un uso indebido por parte del consumidor, o no cuenta con el empaque original y estas óptimas o iguales condiciones como se entregó. No se puede hacer devolución. La aprobación de la devolución está sujeta a las condiciones físicas del producto cuando llegue a las instalaciones de Técnica Electro Médica S.A.

No cumple con el tiempo:

* Se ha superado el tiempo estimado de los diez (1O) días calendario. La factura se considera irrevocable aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (1O) días calendarios siguientes a su recepción. (Tomado del código de comercio Art. 773)

No se realiza devoluciones:

* Para accesorios como: celdas, brazaletes,dispositivos electrónicos, papel, bombillos, Sensores, cables, tarjetas, debido a que Técnica Electromédica, no realiza verificación conexiones eléctricas.

Solicitud de devolución:

* El cliente envía una carta y/o oficio especificando; Número de factura, lotes, series, y razón de la falla o de la devolución, al correo sandra.rivero@tecnicaelectromedica.com y al Key Account mánager que lo está atendiendo, desde un correo institucional o un correo reconocido de la identidad.

Documento No Controlado

Para confirmar la veracidad de este documento comuníquese al PBX: 601 756 8787

Este documento es confidencial y ha sido elaborado exclusivamente para el destinatario indicado. Su contenido no puede ser divulgado, reproducido ni utilizado para fines distintos a los acordados con TECNICA ELECTROMEDICA S.A.

ANEXO 2. POLITICA DE GARANTIAS

Garantía del producto:

* La garantía para los equipos médicos es de 12 meses y para los accesorios es de 3 meses, a menos de que el producto tenga una garantía diferente. Los consumibles que son entregados con el equipo no tienen garantía.

Exoneración de responsabilidad de la garantía:

* El uso indebido del bien por parte del consumidor, la no atención de las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. (Tomado del estatuto del consumidor Art. 22). Deberes de los consumidores: Los consumidores debe informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación con su adecuado uso o consumo, conservación e instalación. (Tomado del estatuto del consumidor Art. 3). La aprobación de la garantía está sujeto a las condiciones físicas del producto cuando llegue a las instalaciones de Técnica Electro Médica S.A. Suspensión y ampliación de la garantía.

* Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia. (Tomado del estatuto consumidor Art. 9).

Disponibilidad de los Repuestos

* Se garantiza a los clientes el suministro de repuestos, insumo, partes y servicio de mantenimiento al menos por los 5 años posteriores a la venta.

Por avería del transportador:

* En el caso que los productos sean averiados por causa de la transportadora, el cliente deberá dejar evidencia en la guía y en la orden de entrega de TECNICA ELECTROMEDICA y debe informar a la transportadora sobre esta inconformidad en el momento de recibo de la mercancía. En este caso, el cliente tendrá máximo diez (1O) días calendario a partir de la fecha de recepción y debe presentar pruebas físicas (fotos). La factura se considera irrevocable aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (1O) días calendarios siguientes a su recepción. (Tomado del código de comercio Art. 773) Toda devolución genera una nota crédito a favor del cliente. No se devuelve dinero.

Documento- No Controlado

Para ...firmar la veracidad de este documento comun... ese al PBX: 601 756 8787

Este documento es confidencial y ha sido elaborado exclusivamente para el destinatario indicado. Su contenido no puede ser divulgado, reproducido ni utilizado para fines distintos a los acordados con TECNICA ELECTROMEDICA S.A.


Gastos administrativos:	
VALOR DE LA VENTA	GASTOS ADMINISTRATIVOS
Compras inferiores 500.000	10% de neto de la factura
Compras superiores $500.001 a $20.000.000	$50.000
Compras superiores $20.000.001 a $50.000.000	$65.000
Compras $50.000.001 o más	$72.000

Documento- No Controlado

Para confirmar la veracidad de este documento comuníquese al PBX: 601 756 8787

Este documento es confidencial y ha sido elaborado exclusivamente para el destinatario indicado. Su contenido no puede ser divulgado, reproducido ni utilizado para fines distintos a los acordados con TECNICA ELECTROMEDICA S.A.

Especificaciones: BQ 80

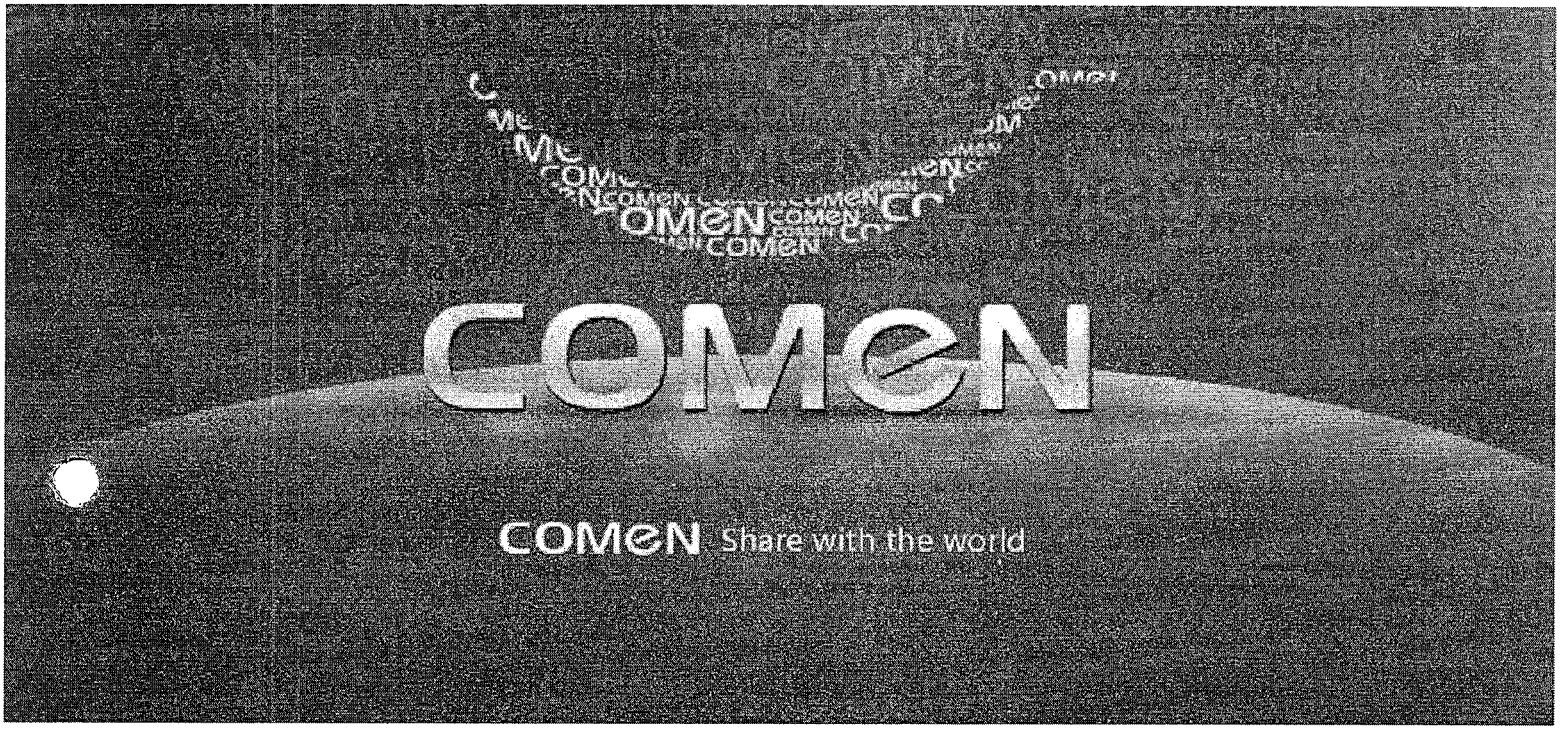

INSTRUMENTOS MÉDICOS CO., LTD DE SHENZHEN COMEN Piso 10, Piso 11 y Sección C del Piso 12 del Edificio 1A y Piso 1 al Piso 5 del Edificio 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, PR China

Teléfono: +86-755-26408879

Fax: +86-755-26431232

Correo electrónico:info@szcomen.com


Web: www.comen.com

2022V 1,7

COMEN
Share With The World.

Calentador Neonatal

BQ 80

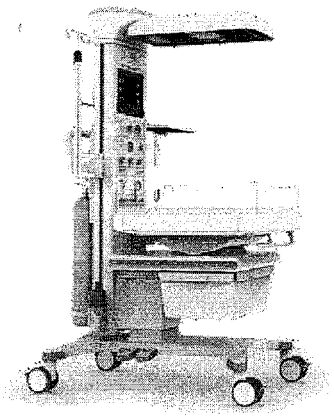

Configuración estándar:
Calentamiento radiante (calefacción por radiación infrarroja lejana), inclinación del moisés, casete de película de rayos X, rotación de la capota de ± 45°, cajón extraíble endos direcciones, protección contra sobrecalentamiento de tres capas, temporizador APGAR, lámpara de examen, puerta de amortiguación, mano -Silencio libre, monitor de temperatura, registrador de datos

Configuración opcional:
Fototerapia, ECG, RESP, SPO2, NIBP, EtCO2, Báscula, Elevación electrónica, Despertador de apnea, Bandeja, Soporte, Reanimación (mezcla de aire y oxígeno, Succión de esputo con presión negativa, PEEP, Monitoreo de la presión de las vías respiratorias, Control de la presión inspiratoria máxima, Monitoreo de presión negativa, Alarma mecánica)

Estándares de seguridad
ISO 13485:2016 aprobado, MDD 93/42/EEC modificado por MDD 2007/47/EC

Características físicas

Tamaño:	119cm×64cm×180cm
Peso:	115kg
Tamaño de pantalla:	Pantalla táctil LCD de 10,4"800 × 600
Resolución:	
Altura:	Piso a colchón (cama bajada): 850 mm Suelo a colchón (cama elevada):1050 mm
	Piso a dosel (cama bajada): 1700 mm
Tamaño del colchón	Colchón a dosel: 850 mm693*563*30 mm
Tamaño del cajón	467*368*222mm
Tamaño de la rueda	5 pulgadas (125 mm)
Cojinete de carga de plataforma:	≤150kg
Cojinete de carga de bandeja y soporte:	≤6Kg

Temperatura de	18~30°
Humedad:	15~80%
Flujo de aire:	≤0,3 m/s
Fuente de alimentación:	100-240V~, 50/60Hz±1Hz
Tipo de Batería:	Batería recargable de iones de litio de 4400 mAh
Capacidad de la batería:	Menos de 12 horas para cargar
Recarga de batería Tiempo:	(Encendido) 1 hora
Batería de reserva:	para trabajo continuo (se excluyenfunciones como calefacción, tratamiento con aparatos de fototerapia, lámpara de punción, inclinación y elevación del moisés)
Rango de presión en entrada:	280~600 kPa
Indicador:	Indicador de alarma Indicación de alarma visible en 360° Alerta de extracción horizontal del portalámparas
Ángulo de visualización de alarma	360°
Alarma de lámpara:	Alarma de desplazamiento horizontal
Suspensión de Alarma:	Silencio sin manos
Interfaz:	Interfaz de cable de parámetros Entrada de alimentación de CA Tres salidas de alimentación auxiliar Ranura de conexión
Almacenamiento de datos:	Puerto USB
Revisión de olas:	≥24 minutos
Gráfico de tendencia:	120 horas
Gráfico de tendencia:	120 horas

COMEN
Share With The World.

	Sí
Alarma:	Límites de 3 niveles alto, medio y bajo ajustables por el usuario;
Presentado Funciones	Alarma sonora y visual prioritaria
Grabadora:	
Escribe:	Incorporado; formas de
Canal:	onda de2 canales de matriz
Velocida d:	térmica
	25 mm/s, 50 mm/s
Ancho de registro:	50 mm
Escala de peso	
Medición Rango:	
Resolución:	300g~8000g
Precisión:	1g
	±10g
moisés	
Cojinete de carga de	≤10kg
moisés:	
Rango de elevación de	
plataforma:	0~200mm
ruido de elevación:	<60dB(A)
	±12°
Ángulo de inclinación del moisés:	<60dB(A)
Ruido de inclinación:	
Radiación infrarroja lejana	
Máximo irradiancia (en cualquier	60 mW/cm22
o en elcolchón)	
Máximo irradiancia (cerca	10 mW/cm22, (760 nm a 1 400 nm)
espectro infrarrojo)	
lámpara de pinchazo	
Alto: Medio:	4500 lux±500 lux
Bajo:	2500 lux±500 lux
Tamaño del punto:	1500 lux±500 lux
	250mm±10%
La temperatura	
Rango de ajuste:	32,0~38,0°C
Precisión:	≤±0,5°C
Medición rango:	
Resolución:	25,0~45,0°C
Características	0,1°C

	Manual/ Infantil
Modo de trabajo:	< 35min (Desde 25°C ("temperatura
Tiempo de precalentamiento	interior") al 50% de humedad relativa hasta 36°C) Duración total de la pantalla: 10000 horasDuración única de la pantalla: 100 horas
Tiempo de exposición:	
Ángulo de rotación de	
Lámpara:	Desplazamiento vertical: ±45° Rotación horizontal: ±90°
Calentamiento excesivo	
Protección:	Software, hardware e ingenieríamecánica
Fototerapia	
irradiación uniformidad:	
	> 0,4
irradiación	
Área de distribución: Alto	50 cm × 30 cm
Máximo:	400nm-550nm: (3000±25%) μW/cm2 430nm-490nm: (45±25%) μW/cm2/nm
Promedio:	400nm-550nm: >2000 μW/cm2
Medio	430nm-490nm: >30 μW/cm2/Nuevo Méjico
Máximo:	400nm-550nm: (2000±25%) μW/cm2
Promedio:	430nm-490nm: (30±25%) μW/cm2/nm400nm-550nm: >1200 μW/cm2
Bajo	430nm-490nm: >20 μW/cm2/Nuevo Méjico
Máximo:	400nm-550nm: (1000±25%) μW/cm2
	430nm-490nm: (15±25%) μW/cm2/nm
Promedio:	400nm-550nm: >700 μW/cm2
	430nm-490nm: >10 μW/cm2/Nuevo Méjico
pieza en T Resucitación	
Oxígeno y aire presión de suministro:	280kPa~600kPa 0
Sonó de cilindro manómetro:	Pa~250x100 Pa; Precisión: ±2,5% escala completa
Succión de esputo presión:	- 150mmHg~0mmHg; Precisión: ±5%
Succión de esputo caudal:	

presión de succión)	<20 l/min
Sonó de negativo manómetro	- 180 mmHg~0 mmHg; Precisión: ±5%
Oxígeno concentración rango: Terapia de oxigenorango:	21%~100%; Precisión: ± 3%
Precisión:	0 l/min~15 l/min ±0,5 l/min (0 l/min~5 l/min) ±1,5 l/min (5 l/min~10 l/min) ±2 l/min (10 l/min~15 l/min)
positivo continuo flujo de presión rango:	0 l/min~15 l/min
Precisión:	±0,5 l/min (0 l/min~5 l/min) ±1,5 l/min (5 l/min~10 l/min) ±2 l/min (10 l/min~15 l/min)
Rango de vía aérea manómetro	- 20cmH20~100cmH20
Medición precisión:	±5% escala completa
PIP máximo:	45cmH2O±5cmH2O
Valores de PIP contra mal funcionamiento:	> 30±4 cmH2O
Alarma mecánica:	Cuando la diferencia de presión entre el oxígeno y el aire supera los 140 kPa ± 20kPa o si uno de los dos gases falla, se activará la alarma.
MIRAR FURTIVAMENTE	
PIP≤30cmH2O	5 L/min: (0~10) cmH2O 8 L/min: (0~21) cmH2O 10 L/min: (0~22) cmH2O 15 L/min: (0~24) cmH2O
30 cmH2O<	
PIP≤45cmH2O	5 L/min: (0~10) cmH2O 8 L/min: (0~24) cmH2O 10 L/min: (0~34) cmH2O 15 L/min: (0~35) cmH2O
APGAR	
Rango de temporizador:	00:00~59:59
Modo:	Contando y cuenta regresiva
Resolución:	(Se pueden configurar 10 nodos de tiempo de alarma) 1s
Hora de alarma:	3s

Vigilancia

electrocardiograma:	
Tipo de cliente potencial : selección de plomo	cardiotecTMAnálisis de ECG de 3 derivaciones
Selección de ganancia	3 derivaciones: yo; II; tercero X0.125, X0.25, X0.5, X1, X2, X4, Automático6.25,
Velocidad de barrido	12.5, 25, 50 mm/s
: Rango de frecuencia cardíaca	15~350 lpm para neonatos / Pediatría
: Resolución:	1 lpm
Proteccion:	Soportar voltaje de 4000 V CA/50 Hz de forma aislada;
Precisión:	±1% o ±1bpm (lo que sea mayor) Modo
Banda ancha:	MON: 0,5 Hz~Modo DIA de 40 Hz:0,05 Hz~ Modo OPE de 150 Hz: 1 Hz~Modo LUN de 20
CMRR:	Hz:>Modo DIA 105dB: >Modo OPE de 90dB:>105dB
entrada diferencial impedancia	≥5MΩ
Rango de señal de entrada	±8 mV
Respiración:	
Método:	Método de impedancia RA-LL
medición de FR y rango de alarma:	0~150 rpm (ped/neo) 7rpm~150rpm:
Precisión:	±2% o ±2bpm,lo que sea mayor 0rpm~6rpm: sin especificar
Resolución:	1 rpm
RESP Apnea	10s-40s
Precisión:	±5 s
Velocidad de barrido:	6,5, 12,5 mm/s
Selección de ganancia:	X0.25, X0.5, X1, X2, X4
PNI:	
Método	Automático Oscilométrico
Modo de trabajo:	Manual / Automático
Medición automática tiempo:	Ajustable (1-480min)
Máximo tiempo de medición:Unidad de medida:	Ped: 120 s; Neo: 85s mmHg/kPa seleccionable
Medición rango	0 mmHg~300 mmHg
Resolución :	1mmHg
Precisión:	±3 mmHg

Presión de inflación rango de ajuste：	Pediatría: 80 mmHg～200 mmHg Neonatos: 60 mmHg～120 mm Hg
Medición tipos: Rango de sistólica	Sistólica, Diastólica, Media
presión:	Modo pediátrico: 40-200 mmHg Modo neonato 40-135 mmHg
Rango de diastólica presión:	Modo pediátrico: 10-150 mmHg Modo neonato 10-100 mmHg
Rango de media presión:	Modo pediátrico: 20-165 mmHg Modo neonato 20-110 mmHg
Presión demasiada proteccion:	Tanto el hardware como el software protegen contra la presión sistólica, diastólica, media
Alarma： relaciones públicas ilBP y alarma:	40-240 lpm
Resolución:	1bpm
Precisión:	±3% o ±3bpm, lo que sea mayor

Masimo SpO2:

Medición y rango de alarma	1~100%
Resolución:	1%
Precisión:	±2 % (70-100 %, Ped, sin movimiento) ±3 % (70-100 %, Neo) 1-69% sin especificar
Medición de relaciones públicas y Rango de alarma:	25~240bpm
Resolución	1bpm
Precisión:	±3bpm (estático) ±5bpm (dinámico)
r IP:	0,02~20%
lución:	0,01% (0,02%～9,99%) 0,1% (10,0%～20,0%) sin
Precisión:	especificar
SIQ:	Disponible

Nellcor SpO2:

Medición rango	0-100%
Resolución:	1%
Precisión:	±2 % (70-100 %, Ped, sin movimiento) ±3 % (70-100 %, Neo, sin movimiento) 1-69 % sin especificar
Rango de alarma:	20-100%
Medición de relaciones públicas y rango de alarma:	20-300 lpm 1bpm
Resolución:Precisión:	±3 lpm (20-250 lpm); Sin especificar (251-300bpm)

EtCO de Respironics2(Corriente lateral)

Medición & rango de alarma:	0-150 mmHg, 0– 20 kPa (a 760 mmHg) ± 2mmHg (0 – 40 mmHg)
Precisión:	± 5 % de lectura (41 – 70 mmHg) ± 8 % de lectura (71 – 100 mmHg) ± 10 % de lectura (101 – 150 mmHg) 2-150rpm
rango de awRR:	
precisión awRR:	±1rpm
Tiempo de respuesta:	< 240mseg (10% a 90%) < 2s
Tiempo de retardo:	

EtCO de Respironics2(convencional)

Medición & rango de alarma:	0-150 mmHg, 0 –20 kPa (a 760 mmHg) ±2 mmHg (0 – 40 mmHg)
Precisión:	±5 % de lectura (41 – 70 mmHg) ±8 % de lectura (71 –100 mmHg) ±10 %de lectura (101 –150 mmHg) 2-150 rpm
rango de awRR:	±1rpm
precisión awRR:	< 240mseg (10% a 90%)
Tiempo de respuesta:	< 2s
Tiempo de retardo:	

Masimo EtCO2(Corriente lateral)

Medición & rango de alarma: Precisión:	0 -190 mmHg, 0– 25 % (a 760 mmHg) ± (2,25 mmHg + 4 % de lectura) 0-150 rpm
Rango AwRR:	
Precisión AwRR:	±1rpm
Tiempo de respuesta:	< 240mseg (10% a 90%) < 2s
Tiempo de retardo:	

Masimo EtCO2(convencional)


Medición & rango de alarma:Precisión:	0-190 mmHg, 0-25 % (a 760 mmHg) ± (2,25 mmHg + 4 % de lectura) 0-150rpm
Rango AwRR:	±1rpm
Precisión AwRR	< 240mseg (10% a 90%)
Tiempo de respuesta:	< 2s
Tiempo de retardo:	

* Aviso: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados por Comen


Neopuff™ Resucitador de pieza en T | Serie 900

Las guías internacionales de reanimación neonatal recomiendan el uso de un resucitador de pieza en T cuando haya una fuente de gas disponible. En comparación con bolsas de inflado automático y de inflado por flujo, resucitadores de pieza en T, como el Neopuff, proporcionan una presión inspiratoria pico (PIP) y una presión positiva al final de la espiración (PEEP) más controladas y consistentes, lo que ayuda a proteger los pulmones del recién nacido y a mantener la capacidad residual funcional (CRF).

Presión vs. tiempo

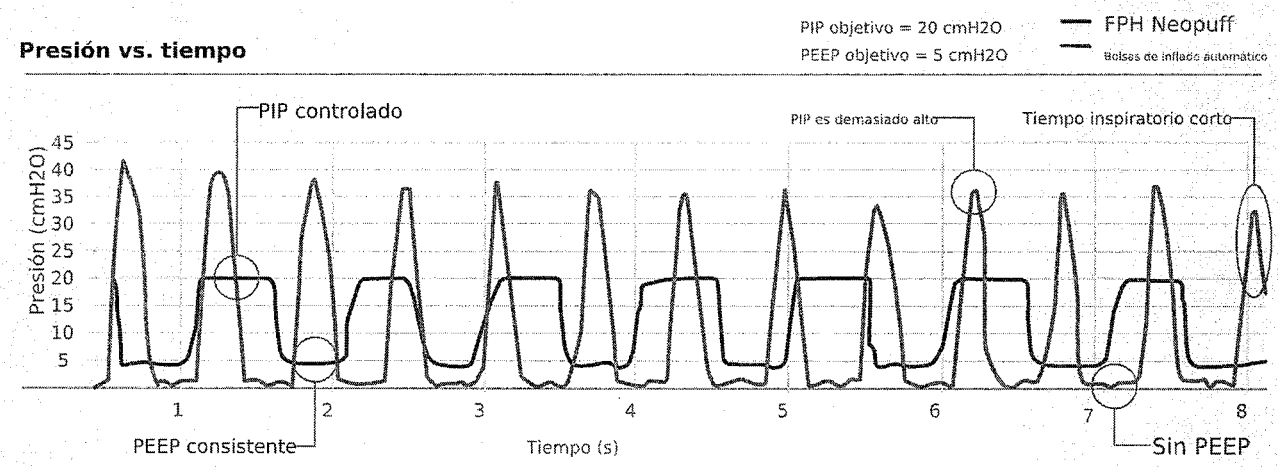


El Neopuff de F&P presenta un manómetro preciso y fácil de leer, control de PIP y válvula de alivio de presión máxima. Puede suministrar niveles de oxígeno del 21% al 100% desde medidores de caudal o una mezcladora de gas.

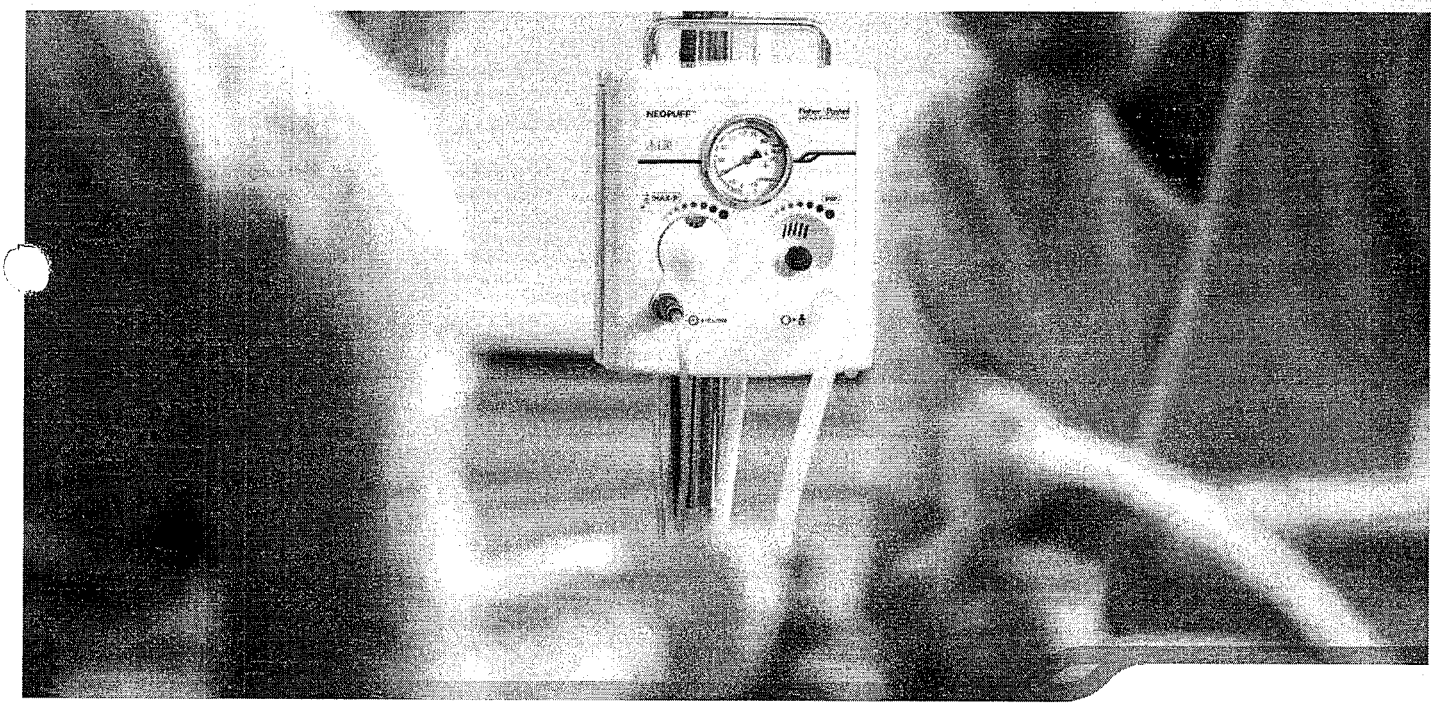

F&P Neopuff

Reanimador de Piezas en T para Recién Nacidos | Serie 900 | Especificaciones

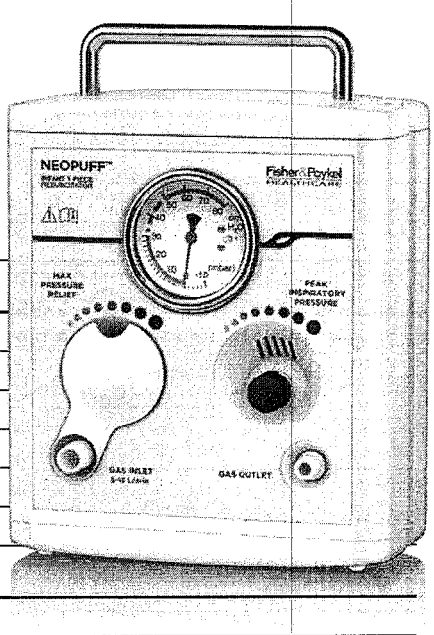

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Códigos de producto	RD900*** (ver códigos específicos de idioma a continuación)
Altura	250 mm (9.8 ")
Ancho	200 mm (7.9 ")
Profundidad	104 mm (4.1 ")
Peso	1.9 kg (4.2 lb)
Rango del manómetro	-10 a 80 cmH2O [mbar]

RENDIMIENTO

Precisión del manómetro	+/-2.0% de la deflexión de escala completa
Rango de caudal de gas de entrada	5 L/min a 15 L/min
Alivio máximo de presión*	A 8 L/min: 5 a 70 cmH2O [mbar]; configuración de fábrica en 40 cmH2O [mbar]
Inspiración pico Presión (PIP)*	A 5 L/min: 2 a 70 cmH2O [mbar]
	A 8 L/min: 3 a 72 cmH2O [mbar]
	A 10 L/min: 4 a 73 cmH2O [mbar]
	A 15 L/min: 8 a 75 cmH2O [mbar]
Fase espiratoria positiva al final (PEEP) Presión (PEEP)*	A 5 L/min: 1 a 6 cmH2O [mbar]
	A 8 L/min: 1 a 10 cmH2O [mbar]
	A 10 L/min: 2 a 15 cmH2O [mbar]
	A 15 L/min: 4 a 17 cmH2O [mbar]
Fuente de gas recomendada	Aire mezclado de grado médico y oxígeno de un mezclador de aire/oxígeno
Rango de concentración de oxígeno	21-100 % (dependiente de la fuente de gas)
Tiempo de operación* (cilindro de 400 L)	50 minutos @ 8 L/min

* Todos los rangos de rendimiento mencionados arriba son representativos solamente.

Los valores de PEEP indicados se basan en ajustes típicos de PIP clínicos. Se pueden lograr valores de PEEP más altos si se establecen valores de PIP más altos. Ver manuales especializados del usuario.

COMPONENTES Y COMPOSICIONES

Componentes de la caja	Unidad Neopuff™; línea de suministro de gas; adaptador de entrada de gas; pulmón de prueba; tapa de alivio de presión máxima de repuesto; instrucciones para el usuario

REGULATORIO

Clasificación	Clase IIb (UE y Australia), Clase III (Canadá), Clase II (EE. UU.)
País de origen	Nueva Zelanda
OrganismoNotificado	TÜV SÜD Product Service GmbH, 0123

CÓDIGOS DE PRODUCTO ESPECÍFICOS DEL IDIOMA

Inglés	RD900AEU	Finlandés	RD900AMU	Noruego	RD900AVU
Danés	RD900ADU	Holandés	RD900ANU	Sueco	RD900AWU
Francés	RD900AFU	Español	RD900ASU	Chino	RD900AZU
Italiano	RD900ALU	Portugués	RD900ATU	Alemán	RD900AGU (Perivent™)

Tenga en cuenta que la información de este catálogo de especificaciones (incluida la información del producto e imágenes) está resumida y se proporciona solo con fines ilustrativos. Por favor, consulte las instrucciones de uso relevantes para obtener más información y confirme los detalles con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare antes de realizar un pedido. La información puede cambiar sin previo aviso.

F&P y Neopuff son marcas registradas de Fisher & Paykel Healthcare Limited. Para información de patentes, ver www.fphcare.com/ip


617631 REV B © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited

www.fphcare.com

Fisher & Paykel
CUIDADO DE SALUD

seca 354

Pesabebés electrónico con función de Ingesta de Leche Materna.

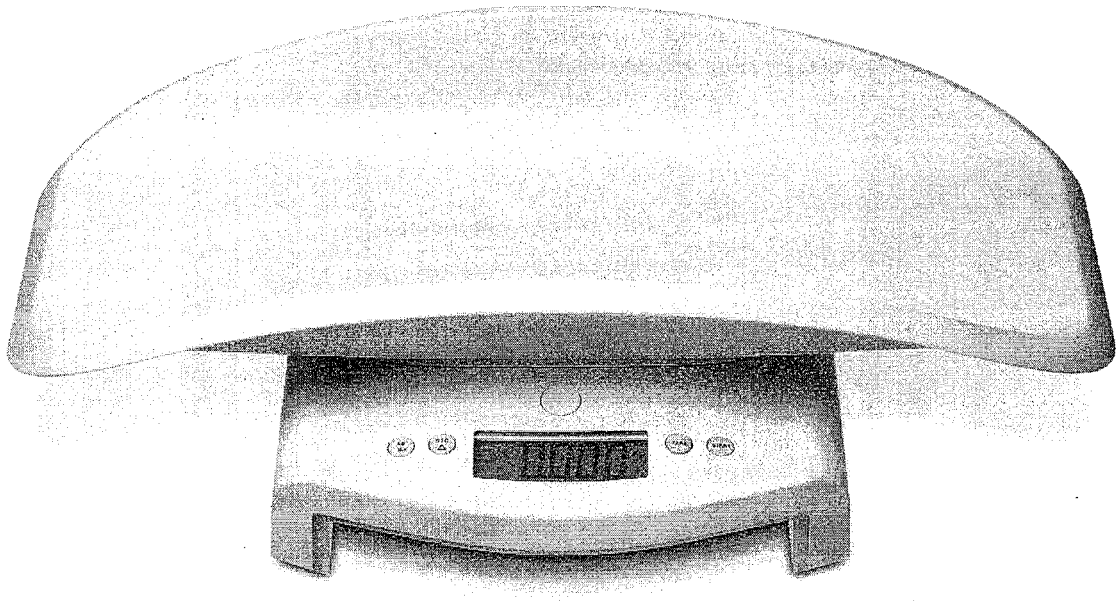

- Función de Ingesta de Leche Materna (Breast-Milk-Intake).
- Fácil separación de la artesa de pesaje de la base.
- Pesabebés y báscula para niños pequeños en uno.
- Móvil y robusto para el transporte.

seca

seca 354:

La protección fiable para un crecimiento sano.




La alimentación juega un papel fundamental en el desarrollo sano del recién nacido. Con el nuevo pesabebés seca 354 puede controlarse a diario con sólo pulsar un botón cuanta leche ha ingerido el bebé durante la última toma. La empresa seca ofrece con este producto el instrumento más fiable para el control de la alimentación de lactantes. Por ello, la báscula seca 354 no sólo es una herramienta ideal para salas de lactancia, consultas pediátricas y puericultoras, sino también para que los propios padres puedan controlar en casa el peso y la ingesta de leche de su recién nacido.


Recogimiento y protección.

En la artesa de pesaje del pesabebés seca 354 pueden pesarse bebés de un modo cómodo y seguro. La forma redondeada de la artesa con paredes laterales ligeramente elevadas dan una sensación de recogimiento. Soltando la artesa de la base se obtiene una báscula electrónica plana plenamente operativa con una capacidad de 20 kg. Mediante la función de ingesta de leche materna (BMIF) puede determinarse la cantidad de leche ingerida por el bebé durante la toma. Pulsando un botón se memoriza el peso del bebé antes de la toma y se resta del peso actual al volver a pesar el bebé tras la toma.


Pesabebés y báscula para niños en uno

Para transformar el pesabebés en una báscula plana sólo tiene que pulsar una tecla, y la unión entre la artesa de pesaje y la base se desbloquea. La unión fija entre la artesa y la base en estado de bloqueo permite levantar sin problemas y transportar de forma segura el pesabebés.

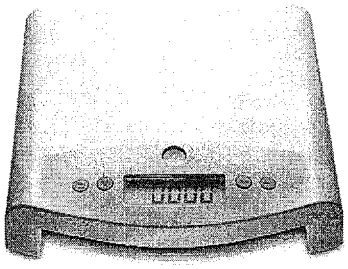

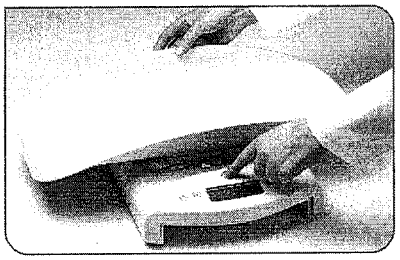

La bandeja de pesaje se puede desmontar rápida y fácilmente, simplemente pulsando una tecla.

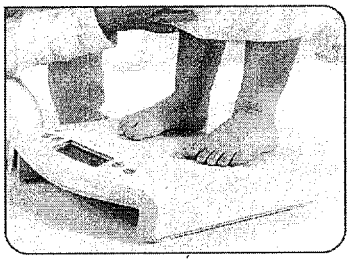

Gracias a la bandeja desmontable, también puede pesar a niños pequeños de hasta 20 kilogramos.

Manejo intuitivo mediante funciones de teclas

Un concepto de manejo intuitivo con teclas autoexplicativas garantiza un fácil manejo del pesabebés seca 354. La función HOLD permite alimentar primero al bebé tras el pesaje antes de proceder a la lectura del peso. Con la función TARA se taran pañales o bases blandas.

Móvil y robusta para el transporte

Su construcción compacta y robusta convierte el pesabebés seca 354 en un utensilio predestinado para todos aquellos que tengan que ocuparse de un modo móvil de la salud de su bebé. Sus pilas de bajo consumo de energía – hasta 20.000 pesajes con un único juego de pilas – permiten transportar la báscula con total facilidad. La práctica maleta seca 414 opcional con correa de transporte facilita el uso móvil y protege el pesabebés.

seca 354

Datos técnicos

- Capacidad: 20 kg / 44 lbs
- División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0,2 oz < 22 lbs > 0,5 oz
- Dimensiones (BxHxA): 550 x 165 x 330 mm
- Peso: 2,5 kg
- Alimentación: Pilas
- Funciones: TARA, Auto-HOLD, BMIF, conmutación kg/lbs

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

seca alemania
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25 T +49 40 20 00 00 0